

政府采购合同

(参考文本, 具体细则条款双方合同签订时具体约定)

合同编号: _____


采购项目名称: 铜川市第二老年服务中心设施设备(康复医疗等)采购项目

采购人(甲方): 铜川市民政局

成交供应商(乙方): 铜川市兴尚源建筑工程有限公司

签署地点: 铜川市民政局

签署日期: 2024年12月19日



合同条款

合同编号：_____

签订地点：铜川市民政局_____

签订时间：2024年12月19日_____

采购人（买方）：铜川市民政局_____

中标人（卖方）：铜川市兴尚源建筑工程有限公司_____

一、供货合同格式

铜川市第二老年服务中心设施设备（康复医疗等）采购项目（项目名称）（采购编号：HGMHCG-2024-83），在铜川市财政局的监督管理下，由陕西恒广茂禾项目管理有限公司（代理公司）招标。采购人（以下简称“买方”）确定（中标单位名称）（以下简称“卖方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过公开招标采购（货物名称），并接受了卖方以价格壹佰捌拾叁万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分（中标金额大写）（以下简称“合同价”）提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

- 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
- 2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
 - 1) 合同条款
 - 2) 合同条款附件
附件1—设备清单
 - 3) 中标通知书

4) 招标文件

5) 投标文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和与货物有关的服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和与货物有关的服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：

完成供货验收合格后，卖方向买方提供发票，达到付款条件起 15 日内，买方向卖方支付总金额的 100%。因卖方逾期提供发票，造成买方延迟付款的，买方不承担逾期付款的违约责任。

6、交货期：自合同签订后 45 个日历日。 交货地点：采购人指定地点。

7、本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，财政局备案壹份。

8、本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。

采购人： 铜川市民政局 (盖章)

供应商： 铜川市兴尚源建筑工程有限公司 (盖章)

地址： 铜川市新区正阳路 9 号

地址： 陕西省铜川市新区裕丰园社区
服务楼三楼

邮政编码： 7270731

邮政编码： 7270731

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人： 郭宁 (签字)

的代理人： 郭飞 (签字)

开户银行： 建行陕西省铜川市新区支行

开户银行： 工行铜川长虹路支行

账号： 61001616308052503098-171001

账号： 2602 0124 0920 0133 548

电话: _____ / _____

电话: _____ 15276917009 _____

传真: _____ / _____

传真: _____ / _____

电子邮箱: _____ / _____

电子邮箱: _____ / _____



二、合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物的单位即（采购单位）。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物的法人或其他组织即中标人。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第 3-1 条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第 3-1 条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6、检验和测试

6-1、买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7、包装及运输

7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12、变更指令

12-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- （1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
- （2）运输或包装的方法；
- （3）交货地点；
- （4）卖方提供的服务。

12-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13、合同修改

除了合同条款第12条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15、卖方履约延误

15-1、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3、除合同条款第20条规定的情况外，除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔

偿费。

16、验收

16-1、项目验收分初验和终验：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品种、规格、产地、数量进行检查。

终验：所有货物交货完毕，由采购人进行终验（最终验收）。

16-2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

16-3、验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）；
- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标人的投标文件；
- (5) 货物清单。

17、误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18、违约终止合同

18-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18-2、如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19、不可抗力

19-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21、因买方的便利而终止合同

21-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和与货物有关的服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下22-2种方式解决：

22-1、双方达成仲裁协议，向铜川市仲裁委员会申请仲裁。

22-2、向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。

23、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24、通知

24-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25、税款

25-1、按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25-2、按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26、合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。

分项报价表

投标人名称：铜川市兴尚源建筑工程有限公司（投标人单位公章） 采购编号：HGMHCG-2024-83

序号	名称	规格	技术参数	制造厂家	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
一、康复医疗设备									
1	PT 床	外形尺寸(长×宽×高): 190 cm×123 cm×48 cm 床面高度: 48 cm	型号: FJ-PTC-01 尺寸(长×宽×高): 190 cm×123 cm×48 cm 床面高度: 48 cm床面额定承载: 2000N 产品用途: 用作 PT 受训者在床上进行各类康复训练活动。 特点和功能: 床脚配有高度微调支脚, 着地稳固。	峰璟康复科技(常州)有限公司	张	3	600	1800	
2	PT 凳	外形尺寸(直径×高): Φ 600mm×	型号: FJ-PTC-01 尺寸(直径×高): Φ 600mm× (420~560) mm	峰璟康复科技(常州)有	张	3	160	480	

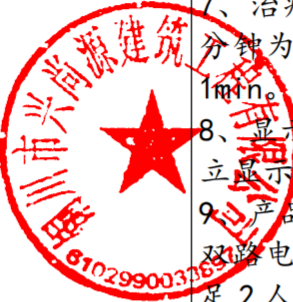
		(420~560) mm 2) 带液压油缸, 360° 旋转 360° 旋转 3) 额定承载: 2000N	带液压油缸, 360° 旋转 额 定 承 载 : 2000N 产品用途: 康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 凳面高度可调, 方便康复师使用。 凳体底部设计有万向滑轮, 可以自由移动。 凳面可以 360° 旋转。	限公司					
3	评估室 软硬件	1 套	1、体征测量: 身高体重 (含体脂) 测量仪器、视力灯箱、音叉、轮椅体重秤、握力器; 2、运动尘 : 步行台阶、轮椅 1 个; 3、起居评估: 坐式马桶 1 个、独立衣柜 1 个双开门; 4、洗漱评估区: 洗手台 (含镜柜) 1 个、洗浴喷淋 (墙	握力器: 安踏	套	1	30000	30000	

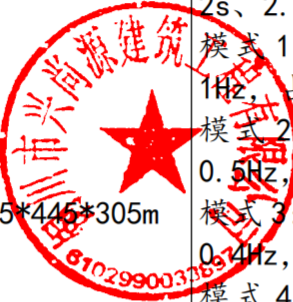
			面安装) 1 套; 5、骨密度测量: 骨密度测量仪 1 台; 6、软件系统: 评估软件、手机和电脑端通用						
4	治疗床	 尺寸/cm: 203 ×65× (50~ 94) 床面高度调节 范围/cm: (50~ 94)	型号: FJ-DZC-01 外形床面 高度调节范围/cm: (50~94) 床板翻转角度: 头板: -30° ~25° 座板: 0° ~25° 腿板: 0° ~75° 床板额定承载: 头板: 400N 座板: 900N 腿板: 700N 床板总尺寸/cm: 198×62 头板尺寸/cm: 36×62 座板尺寸/cm: 53×62	峰璟康复科 技(常州)有 限公司	张	3	2900	8700	

			腿板尺寸/cm: 105×62 可根据需要调节床面高度和角度, 作为全身多体位按摩或训练的卧具。						
5	检查床	尺寸: 180*60*65cm	型号: FJ-JCC-02 尺寸: 180*60*65cm 床面额定承载: 2000N 产品材质: 钢材+皮革+回弹海绵 重量: 25kg	峰璟康复科技(常州)有限公司	张	2	300	600	
6	中医定向透药	25V	一、组成: 电热磁综合治疗仪由主机、电极线、电极片、热疗垫组成。 二、技术参数 1、治疗模式与治疗手法: 1.1 电热磁综合治疗仪治疗模式分为: 按摩、导入。 1.2 治疗手法为: 揉捏、捶打、按压、组合。 2、电疗的技术参数: 2.1、中频载波频率: 2000Hz, 允差±3%。 2.2、低频调制频率: 0——440Hz。 2.3、电疗输出电压: ≤AC50V。 2.4、脉冲宽度: 250us±5%。 3、直流分量:	深圳市艾利特医疗科技有限公司	张	1	13000	13000	

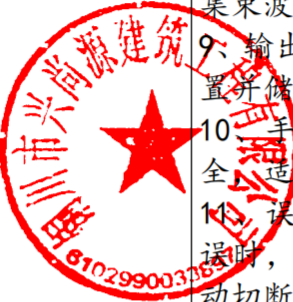


		3.1、非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于 1V。 3.2、导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于 20V。 3.3、波形：按摩模式为对称波形，导入模式为非对称波形。 4、热疗的技术参数： 4.1、25V 特低安全电压。 4.2、5 种强度可选择。 4.3、60 摄氏度过温保护。 5、磁疗的技术参数： 5.1、磁场强度为 200mT~300mT； 磁场强度低于 0.5mT 的距离应不大于 10cm。 5.2、磁类型：强永磁磁体 6、输出强度： 6.1、仪器各路独立输出，在 500Ω 负载时，最大输出电流不超过 100mA (r.m.s) 。 6.2、治疗仪输出强度调节，电疗范围为 0~248 级；热疗范围为 0~5 级；电疗调节时，输出强度随级数增加而增加，连续可调且每级增量不超过 1mA 或 1V。 6.3、最大输出时，在开路条件下测量其输出电压峰值 ≤500V。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 6.4、治疗仪在 500Ω 负载电阻下，每个脉冲能量≤300mJ。 7、治疗时间：0min~100min，5分钟为单位连续步进。误差≤±1min。 8、显示方式：8 英寸触控屏，独立显示及独立操作键盘。 9、产品结构及输出通道：台式，双路电疗，双路磁热疗，同时满足 2 人单部位或多部位治疗。 电热磁综合治疗仪具有电疗、热疗、磁疗和药物离子导入功能，低频调制的中频电流兼有低、中频电流的特点，能够促进皮肤电阻下降，扩张小动脉和毛细血管，改善血液循环，比低频作用深度更深，具有镇痛、消炎、疏经通络、松解粘连、调节和改善局部循环的作用。加速药物透入，对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、膝关节骨性关节炎具有镇痛和消炎的作用。						
7	磁 振 热 治	1、单通道台式机型，标配颈肩温热导子； 2、3.5 英寸彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0~38mT；	苏州好博医疗器械股份	台	1	14500	14500	

	疗仪	 515*445*305m	4、振动频率：50Hz±1Hz； 5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%， 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%； 6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过	有限公司					
--	----	---	---	------	--	--	--	--	--

			60℃; 8、时间选择: 1~60 分钟可调, 步距增量为 1 分钟, 误差为 ±10%; 9、连续工作时间: >8h; 10、电源参数: AC 220V±10%; 电源频率: 50Hz±2%; 11、磁体数量及物理尺寸: 热磁振子数量: 8 个; 尺寸: (长 × 宽 × 高) 88mm*63mm*19mm; 12、设备净重: 9.7kg; 尺寸: 515*445*305mm。						
8	微波治疗仪	530×535×850 mm	1、单微波源, 微波工作频率: 2450MHz±30MHz; 2、输出功率: 手术模式: 0-150W, 理疗模式 0-50W; 3、外形尺寸: 530×535×850 mm; 4、整机重量: 26Kg; 5、预置工作时间范围: 0~30min 或 0~99s, 预置为 30min 时, 其时间精度应为 30min±1min; 6、采用微电脑控制, PID 调节及锁相, 输出功率稳定; 7、产品配置 2 枚玻璃管式熔断器, 规格为 F2AL250V, 外形尺寸为 Ø5	苏州好博 医疗器械 股份有限 公司	台	1	10500	10500	

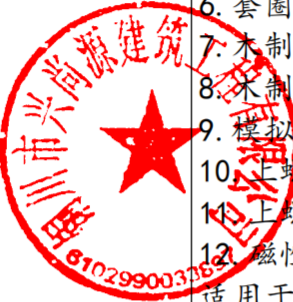
		 ×20mm; 8、输出模式：连续波、脉冲波、集束波； 9、输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆； 10、手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要； 11、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出； 12、过载保护：输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号； 13、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出； 14、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警； 15、安全等级：符合国家医用电器3类标准； 16、支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况。 17、临床适应症：丹毒、蜂窝织						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			 炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2: 高热疗法与放疗、化疗综合治疗适用于皮肤癌、甲状腺癌、颈淋巴结转移癌、食管癌、乳癌、宫颈癌、直肠癌。3: 组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。						
9	全胸振动排痰机	800VA	1、工作条件: a) 环境温度: 5℃~40℃; b) 相对湿度: ≤85%; c) 大气压力: 860hPa~1060hPa; d) 电源要求: AC 220V±10%, 50Hz±2%; e) 输入功率: 800VA; 2、柜式一体机型, 推车设计带锁止万向轮, 各种角度灵活转动; 3、一键飞梭的操作模式, 所有调节均可通过一个键的旋转按压实现; 4、成人、儿童一体型;	南京华伟医疗设备有限公司	台	1	13000	13000	

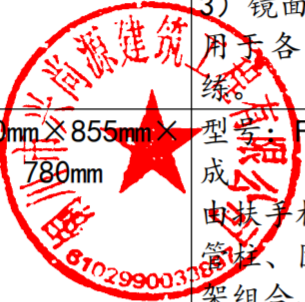


		5、配备手动触发器； 6、特殊设计脉冲式压缩空气泵，解决了传统背心式排痰机在使用过程中噪音大、震动强烈、漏气等问题，保证治疗稳定有效； 7、充气背心采用 TPU 高强度复合面料；充气背心分标准全胸充气背心（成人）、标准全胸充气背心（儿童）、简易半胸充气胸带，共三种类型，7 种尺寸型号； 8、充气背心的尺寸： 标准全胸充气背心（成人）：胸围 80cm～130cm；标准全胸充气背心（儿童）：胸围 50cm～80cm；简易半胸充气胸带：胸围 60cm～135cm； 9、压力范围：0.5～3.2kPa，分 10 档可调，步距增量 1 (0.3kPa)，误差±15%或±0.2 kPa； 10、振动频率：5～30Hz 连续可调，步距增量 1Hz，误差±20%； 11、工作模式：手动模式、五种自动程序模式、用户自定义模式； 12、时间设定： 手动模式 1min～99min，误差±10%； 自动模式、自定义模式四档						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			调节5min、10min、15min和20min，误差±10%；						
10	红外线灯	250VA	 1、电磁波额定功率：250VA 2、额定电压：220V 3、光谱波长：2-25 微米 4、辐射板直径：166mm 5、频率：50Hz 6、发热盘寿命：约 2000 小时 7、辐射板寿命：约 1000 小时 8、发热温度：290-350 小时 TDP 属于远红外线，特定电磁波治疗器通过发射富含微量元素的电磁波对肩周炎、关节炎、风湿病、颈椎病、腰椎病、小儿腹泻均有显著的辅助理疗效果。	重庆华升医疗器械有限公司	台	6	190	1140	
11	OT 综合训练台	120 cm×72 cm×91 cm	型号：FJ-OTT 1. 侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：184 cm×104 cm×91 cm 2. 侧板闭合时外形尺寸（长×宽×高）：120 cm×72 cm×91 cm 3. 侧板高度调节范围：35 cm～73 cm 4. 侧板角度调节范围：0°～90° 1. 上肢协调功能练习器 2. 分指板 3. 分指板	峰璟康复科技（常州）有限公司	台	1	2100	2100	

			4. 铁棍插板 5. 木插板 6. 套圈 7. 木制图形插板 8. 木制图形插板 9. 模拟作业工具 10. 上螺丝 11. 上螺母 12. 磁性钮 产品用途： 适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 特点和功能： 1. 侧板高度可调，适合不同身高人群使用。 2. 侧板可折叠，节省存放空间。 3. 配有带刹脚轮，方便移动。 4. 12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。 5. 训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。						
12	电动起立床	189cm×80cm×105cm（平放）； 189cm×80cm×	型号：FJ-ZLC-02 尺寸（长×宽×高）： 189cm×80cm×105cm（平放）	峰璟康复科技（常州）有	台	1	2800	2800	

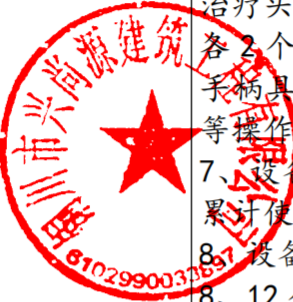
		196cm (直立)	189cm×80cm×196cm (直立) 床面宽度: 61 cm 床面高度: 52 cm 床面角度转动范围: 0° ~85° 床面及脚踏板额定承载: 2000N 承受额定承载时床板从水平到直立位置时的运行时间: ≥30s 用途: 适用于偏瘫、截瘫及脑外伤等重症者进行恢复性站立训练。 特点和功能: 通过手持操作器控制电动推杆进行床面的直立操作, 方便快捷。床面可在 0° ~85° 范围内连续可调, 且直立角度直观可视。配有机械式升降脚轮, 方便近距离移动。腿部、腰部、胸部配有防护带, 防止直立过程中人员滑落、倾斜。顶端配有拉手方便移动时推拉。摆台可支撑肘部及方便游戏娱乐等活动。由脚踏板稳固承载受训者的质量。	限公司					
13	姿势矫正镜	850mm×670mm×1900mm	型号: FJ-JZJ-01 一、产品组成 由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数	峰璟康复科技(常州)有限公司	台	1	500	500	

			1) 尺寸: 850mm×670mm×1900mm 2) 镜面玻璃厚度: 5mm 3) 镜面带线格 产品用途 用于各种姿势或表情的矫正训练。						
14	平衡杠	3350mm×855mm×780mm	 型号: FJ-PXG 一、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底座组合、矫正板组成。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 3350mm×855mm×780mm 2) 扶手杆高度: 最低780mm, 最高1200mm, 分15档可调, 每档调节尺寸为30mm; 3) 两扶手杆中心调节范围: 310mm~650mm 4) 扶手杆直径: φ38mm 5) 脚踏板安全工作载荷: 100 kg 6) 矫正板踩踏面相对于水平面的夹角: 15° 一、产品特性 1) 扶手杆高度可调, 适合不同身高人群进行训练。 2) 扶手杆宽度可调, 适用于不同	峰璟康复科技(常州)有限公司	台	1	1500	1500	

			体型人群进行训练。 3) 底座两端设计有斜坡, 方便受训者上下。						
15	训练用扶梯	3320mm×800mm×1360mm	型号: FJ-FT1-01 一、产品组成 由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 二、主要技术指标和参数 1) 尺寸(长×宽×高): 3320mm×800mm×1360mm 2) 梯面高度: 100mm、120mm 3) 扶手高度调节范围: 0~310mm 4) 阶梯踏板安全工作载荷: 100kg 一、产品特性 1) 扶手高度可调, 适合不同身高人群进行训练。 2) 配合矫正镜, 可进行步态矫正训练。 二、产品用途: 适用于提高患者日常上下楼梯的功能训练。	峰璟康复科技(常州)有限公司	张	1	1500	1500	
16	轮椅	轮椅尺寸(CM): 103*68*88	1. 产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准; 2. 车架: 由Φ22mm 优质钢管焊接组合成型, 采用固定式扶手, 固	天津利康医疗器械科技	面	2	300	600	

		 定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理；各管孔都有封头； 3. 前轮:360度万向7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 4. 后轮: 24 寸铝合金轮毂实心胎，配置高强度手轮圈，采用防滑性设计。 5. 刹车：前后双刹车，采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 6. 座靠垫：采用牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用优质 abs 扶手垫。 7. 护板：选用金属护板。 8. 脚踏板：配置高强度电镀金属脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合。 9. 安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 10. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 11. 规格：折叠宽度 27cm，座位	有限公司					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

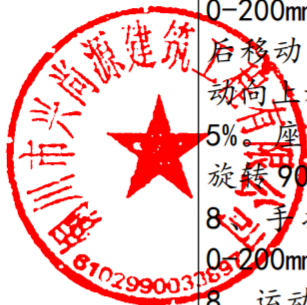
			深度 42cm, 座位宽度 45cm, 座位离地面高度 45cm; 轮椅尺寸 (CM): 103*68*88。 12. 承重: 100KG。						
17	空气压力波治疗仪	177*65*43mm	便携机型, 可同时使用两个气囊 压强调节: 气囊压强调节范围 0-200mmHg, 设定调整步长为 5mmHg; 工作噪声: 治疗仪正常工作时的噪声应不大于 45dB (A)。	苏州好博医疗器械股份有限公司	台	1	2700	2700	
18	冲击波	280W	1、设备要求电磁式冲击波, 提高患者的体验感; 2、能量: 60-185mJ 范围内分级可调。 3、频率: 1-22HZ 范围内分级/连续可调, 步进为 1HZ。 4、设备具有肌腱炎, 跟腱炎, 筋膜炎等 23 种治疗模式, 根据患者情况针对性选择治疗模式, 可升级自定义治疗模式。 5、设备操作屏为触屏操作, 通过触屏点击屏幕图标进行选择所需功能, 包括部位、手柄、频率、强度、治疗头、击打次数、开始	深圳德技医疗器械有限公司	台	1	22000	22000	

		 治疗的操作； 6、AB 双手柄配置，3 种规格 6 个治疗头可供选择，9mm, 15mm, 25mm 各 2 个，适应不同部位的操作。手柄具有开始、暂停、能量调整等操作功能。 7、设备需具有可查询 AB 双手柄累计使用次数的功能。 8、设备可选节拍模式：连拍、4、8、12 个脉冲等模式可选。 9、具有可设置仪器的音量、亮度、语言、模式的功能； 10、单手柄使用寿命：不小于 200 万次。 11、设备需要具有风冷技术，可延长仪器使用寿命。 12、治疗头温度：治疗头外部温度$\leq 48^{\circ}\text{C}$。 13、电源及功率：AC 100-240V；50/60HZ，200VA。 14、最大功率：300VA；额定功率：200VA。 15、屏幕要求 12 寸超大触摸屏，国产系统，完成物联网链接，可实现远程升级功能。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

19	电针	输入功率: <50VA 型号: XS-998B06  01. 使用电源: AC220V±22V、50Hz ±1Hz; 02. 输入功率: <50VA; 03. 脉冲宽度: 0.008ms~0.6ms; 04. 电针工作频率: 2Hz、10Hz、 50Hz、100Hz、循环频率; 05. 电针脉冲幅度: ≤150V (负载 250Ω/500Ω); 06. 定时时间: 15、30、45 分钟; 07. 输出波形: 双向对称窄方波, 脉冲宽度自动变化; 08. 有模式 1 和模式 2 两种治疗模 式可适用于不同应用情况; 09. 电针输出通道数: 6 通道输出, 每通道可单独控制; 10. 显示方式: LED 指示灯; 11. 样式: 便携台式。 一机两用, 低频理疗和电针治 疗双重模式 1. 临床机理: 电针仪是在针刺人体经穴得气 后, 将针上通以电生理效应范围 内的微量脉冲电流, 代替手捻针 刺激, 它能提高针刺的治疗效果, 达到治病或止痛的一种电子针灸 器械, 电针仪可随意准确地调节	南京小松医 疗仪器研究 所	个	2	500	1000	
----	----	---	---------------------	---	---	-----	------	--

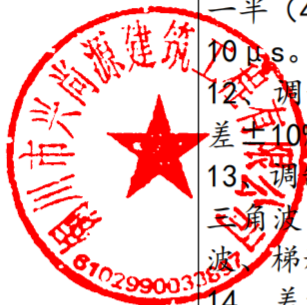
			刺激量，适应各种病症，被广泛应用于临床。 2. 工作原理： 1) 针刺效应。 2) 电针效应。 3. 产品适用范围： 适用于神经性和退行性病变（如偏头痛、关节痛、坐骨神经痛、牙痛）等病症的辅助治疗。						
20	电子生物反馈治疗仪	308mm*260*130	技术参数： 1. 双通道便携机型，双通道可同时使用，互不干扰； 2. 8 寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示； 3. 具有处方治疗、自由刺激、反馈治疗等多种功能； 4. 阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择； 5. 反馈阈值：10uV~999uV； 6. 最高分辨率（测量灵敏度）：$\leq 2\mu V$； 7. 输入噪声：$\leq 1\mu V$； 8. 共模抑制比：大于 100dB； 9. 通频带：不窄于 20Hz~500Hz（-3dB）； 10. 输出电参数：	苏州好博医疗器械股份有限公司	台	1	14000	14000	

			a) 电流强度 0~50mA 可调 b) 输出频率为 1~120Hz c) 脉宽为 50~500 μ s d) 开路输出电压 <500V; 11. 具有定时功能, 可在 1 分钟~60 分钟范围内设定所需时间; 12. 连续工作时间大于 8h; 13. 净重: 4.4kg 尺寸: 308mm*260*130。						
21	四肢联动康复训练器	尺寸: 长 1170mm, 宽 480mm, 高 950mm	1、工作环境: 环境温度范围: 5℃-40℃; 环境湿度范围: 5%-90%; 2、电源 电源: 90 到 240 伏交流电 (标准电源) 3、尺寸: 长 1170mm, 宽 480mm, 高 950mm。允许±5%, 无线遥控 4、重量: 35Kg。 5、最大承重: 150Kg。 6、显示内容: 时间、转数、功率、总距离、阻力、卡路里。 显示屏可以预先设置总距离数, 卡路里和锻炼时间。按模式键选择设置项, 按设置键进行设置, 按复位键进行清零。如果进行设置后, 到达设置数值会发出提示	JTH750	台	1	3500	3500	



		音。 7、座椅前后调节：可调范围0-200mm，允差±5%，当向前和向后移动 200mm 时，座椅高度会自动向上和向下调节 50mm，允差±5%。座椅可以分别向左或者向右旋转 90°，允差±2%，然后锁定。 8、手把长短调节：调节范围0-200mm 允差±5%。 8、运动角度：运动角度为 30°，允差±5%。 10、阻力系统：阻力是永久性的磁控系统，有 6 个等级的运动强度（阻力等级）可调，步进为 1 档；简介：全身运动康复训练系统是借鉴了国内外同类产品的先进技术而自行研制开发的产品，该产品在机械结构设计和原材料使用上做了改进，进一步提高了产品结构的合理性、使用的方便性和产品质量的可靠性。 该产品是利用有目的的运动训练达到促进患者康复的目的，通过将坐姿与踏位有机地结合达到锻炼全身肌肉的效果。患者可使用健侧肢体带动患侧，健侧肢体做						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			主动训练，患侧肢体被动训练，患侧的驱动力来自于患者自己的健侧运动，有很高的安全性。						
22	温热中 低频治 疗仪	7寸真彩触摸屏	1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷； 2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3、操控方式：7寸真彩触摸屏； 4、内置多达102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； 5、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； 6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 7、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)，分99档连续可调； 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 9、载波频率：载波频率1kHz~12kHz，允差±10%；	苏州好博 医疗器械 股份有限 公司	台	1	3500	3500	



		10、载波波形：脉冲波 11、载波脉宽：载波频率倒数的一半（42 μs~500 μs），允差±10 μs。 12、调制波频率：0~150Hz，允差±10%； 13、调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波 14、差频频率：0~200Hz，允差在±10%或±1Hz。 15、差频变化周期：15s~30s，允差±10%； 16、动态节律：4s~10s，允差±10%； 17、调幅度：0~100%，调幅度允差±5%； 18、治疗时间：1min~99min 可调，步长 1min，允差±5%。 19、连续工作时间：不少于 4h； 20、噪声不大于 45dB（A）； 21、具有电极加热功能：电极片温度 38℃~42℃，分 10 档可调，允差±3℃； 22、具有四大保护功能： 1) 超温保护：电极片温度超过 45						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 ℃，热保护器动作，且有报警提示。 2) 开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3) 短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4) 过流保护：输出电流有效值大于2.3要求时，发出声音和显示错误提示。 23、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 24、可选配 Wi-Fi 模块，进行相关数据互联（量产机器暂不配置，如有需要走特殊订单评审流程） 25、本产品使用期限为 5 年； 26、配置多类别电极片，满足临床多样化需求 27、产品尺寸：（长）307.8mm *（宽）253.8mm *（高）127.8mm 28、电源线长度：1.8m 29、连接线长度：1.55m 30、转换线长度：0.29m 31、工作环境： 1) 环境温度：5℃~40℃； 2) 相对湿度：≤80%；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			3) 大气压力: 700hpa~1060hpa; 4) 电源电压: ~220V±10%; 5) 电源频率: 50Hz±1Hz。 6) 输入功率: 120VA 32、产品分类: 1) 防电击类型: II 类; 2) 防电击程度: BF 型; 3) 对进液的防护程度: IPX0; 4) 运行模式: 连续运行; 5) 在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度: 非 AP 型、APG 型设备; 6) 电磁发射: 1 组 A 类 33、安全要求: 符合 GB 9706.1-2007、YY 0951-2015 和 YY 0607-2007 中适用的要求 34、电磁兼容性: 符合 YY 0505-2012 和 YY 0607-2007 中底 36 章的要求						
23	悬吊床	2200mm×1150mm ×2100mm	型号: FJ-QYJ-02 一、组成 由网架、绳索、吊带、拉手、绑带、床面、可调床脚、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1) 尺寸(长×宽×高): 2200mm ×1150mm×2100mm	峰璟康复科技(常州)有限公司	台	1	5500	5500	

			2) 网架额定载荷: 800N 3) 床面额定载荷: 2000N 4) 床面高度: 470mm 5) 床面宽度: 1120mm 二、产品特性 1) 可借助牵引装置进行肢体牵引训练。 2) 配备 PT 训练床, 可以平躺姿势进行训练。 3) 配有沙袋可进行肌力训练。 4) 配有脚轮, 方便移动。 三、用途 适用于肌力、关节活动度和放松调整训练, 也可进行牵引训练。						
24	电动牵引床	1900*600*600 (mm)	1. 电源: 220V±22V、50Hz±1Hz 2. 额定输入功率: 80WA 3. 腰椎牵引行程: 0-200mm, 4. 腰椎牵引力: 0-990N 手控可调 5. 卧位颈椎牵引 6. 规格: 1900*600*600 (mm) 技术优势 电动控制颈椎、腰椎牵引 患者可通过控制器调节牵引力度、牵引时间、间歇时间, 可以通过手控开关实现整过牵引过程 配有卧位颈椎牵引	安慰鑫诺医疗设备有限公司	套	1	6000	6000	

			适用范围 适用于颈椎、腰椎牵引 禁忌症: 脊椎结核、肿瘤, 严重心脏病、严重糖尿病、骨折疏松、牵引区皮损或骨折、孕妇等。						
25	腕关节屈伸训练器	520mm×200mm×980mm	型号: FJ-WQS-01 一、产品组成 由固定座、导向管、升降装置、升降手柄、把手、阻尼装置、阻尼调节手柄组成。 二、主要技术指标和参数 1) 尺寸 (长×宽×高) 520mm×200mm×980mm 2) 升降装置调节距离: 535mm 3) 阻尼力矩/N·cm: ≥980 三、产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。	峰璟康复科技(常州)有限公司	台	1	620	620	
26	肘关节牵引椅	1010mm×1200mm×1160mm	型号: FJ-ZGJ 主要技术指标和参数 1) 尺寸: 1010mm×1200mm×1160mm 2) 升降支架调节距离: 85mm 3) 前臂垫调节距离: 230mm 4) 角度调节支架调节角度: 20° 5) 靠背垫调节角度: 10°	峰璟康复科技(常州)有限公司	台	1	1250	1250	

			6) 前臂支架调节角度: 145° 7) 哑铃片质量及数量: 4 磅/块, 共 6 块 8) 座垫额定承载: 2000N 产品用途: 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。						
27	助浴间设备		机械浴缸 1 个, 步入坐式, 侧开门, 带按摩。 淋雨系统 3 套, 护理洗澡床 3 个	北京科勒有限公司	套	1	33500	33500	
28	跑步机	1380*685*1085MM	输出功率: 2.0HP 尺寸: 1380*685*1085MM 输入电压: 220V (50HZ) 尺寸: 1460*725*255MM 有效跑步面积: 1200*400MM 速度范围: 1.0-18.0KM/H 频屏显示: 5 寸蓝屏 额定载重: 120KG 毛重: 55KG 净重: 48KG 主要适用于室内步行或跑步训练, 通过设置扬升按键、调节步行速度, 从而提高步行活动强度。适用于各类受训者的耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围练习。	麦瑞克	台	1	3600	3600	

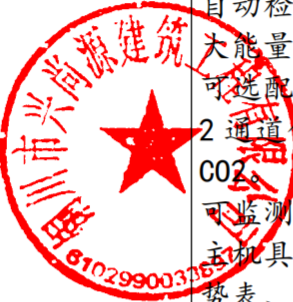
29	椭圆机	1160*1520*650MM	产品飞轮:双向磁控~飞轮5公斤 阻力系统:旋转式8档阻力调节 心率测试:手感心率传感器 阻力控制:磁控式 产品尺寸:1160*1520*650MM 产品净重:29.3KG/33KG 产品承重:110KG 显示类型:LED显示屏 显示内容:速度、时间、距离、卡路里、里程数、脉搏 采用椭圆机锻炼,不仅能预防、降低、缓解颈椎痛、肩周炎及上背部的疼痛,而且避免了跑步时所产生的冲击力,更好地保护了关节,从而具备更好的安全系数。椭圆机能锻炼和刺激坐骨神经的调节,增强腰部肌肉的耐力和力量,针对臀部、大腿、侧腰及小腹部的刺激,达到塑身的效果。	麦瑞克	台	1	4300	4300	
30	跑步机	1390*650*1160mm	输出功率:1.5.0HP 尺寸:1390*650*1160mm 折叠尺寸:995*650*1160mm 输入电压:110V (50HZ) 包装尺寸:1340*700*260mm 有效跑步面积:1100*400mm 速度范围:0.8—12km/h	麦瑞克	台	1	3500	3500	

			频幕显示: LED MP3 额定载重: 100kg 毛 重: 38kg 净重: 33k1 主要适用于室内步行或跑步训练, 通过设置扬升按键、调节步行速度, 从而提高步行活动强度。适用于各类受训者的耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围练习。						
31	划船机	1300mm×565mm×800mm	型号: FJ-HCQ-01 主要技术指标和参数 1) 尺寸(长×宽×高): 1300mm×565mm×800mm 2) 油缸力值调节档数: 12 档 3) 座垫中心至脚踏板轴线距离: 700mm~1050mm 4) 把手至油缸力点距离: 410mm、460mm、510mm 5) 后横杆处座垫至地面距离: 210mm、250mm、290mm、330mm 6) 额定承载: 2000N 产品用途 适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练。	麦瑞克	台	1	3500	3500	
32	动感单车	长 1010*宽 510*高 1165MM	电子表显示: 时间, 距离, 卡路里	麦瑞克	台	1	1200	1200	

			展开尺寸：长 1010*宽 510*高 1165MM 最大承重量：150KG 净重：40kg 毛重：41KG 飞轮重量：15KG 内磁双向运动 产品配置：皮带 铝合金脚踏						
33	腹肌板	140*48*589cm	型号：FJ-FJB 加粗主架 运动皮革	麦瑞克	台	1	130	130	
34	上肢锻炼器	1135×740×1185mm	型号：FJ-TJQ-01 外形尺寸：1135×740×1185mm 阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮 10 档阻力可调 主架采用 50×100×2/2.5mm 平椭圆管和 40×80×3mm 平椭圆管 承重 150 公斤以上 主要训练上肢、肩背部肌群，改善肩、周关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能。	峰璟康复科技（常州）有限公司	台	1	2500	2500	
35	哑铃	80×52×77cm	型号：FJ-YAL 外形尺寸/cm：80×52×77（不含哑铃） 哑铃质量及数量：1 磅×4 个 2 磅×4 个 3 磅×4 个 4 磅×4 个 5 磅×2 个 适用于肌力和医疗体	峰璟康复科技（常州）有限公司	套	1	600	600	

36	单杠架	承重 1200 斤	操训练。 型号: FJ-DG-01 高度调节 143-220CM+双边脚架 +防滑手带 承重 1200 斤	峰璟康复科 技(常州)有 限公司	套	1	250	250	
37	台球桌	长 2.83 米/宽 1.54 米/高 0.84	长 2.83 米/宽 1.54 米/高 0.84 米 中式黑八 石板: 天然大理石 4.0CM 胶边: 高弹美林胶边 赠送配件: TV 水晶球 1 盒, 毛台 呢 1 张, 手工球杆 4 根, 架杆 1 根, 十字架头 1 个, 巧克粉 1 盒, 枪头 1 盒, 三脚架 1 个, 壁式杆 架 1 套	都格	套	1	2600	2600	
38	室内乒 乓球桌	2740*1525*760mm	网架、乒拍、乓球	猎钢狼	套	1	1500	1500	
39	室内沙 壶球桌 (3.6m 长)	365*61*81cm	实木沙壶球桌, 产品尺寸 365*61*81cm	沙壶	套	1	2800	2800	
40	除颤仪	2~250Ω	体外除颤仪配置≥8 英寸彩色 TFT 显示屏, 界面可显示≥4 道监护参 数波形。 显示模式具有高对比度显示界 面, 可通过 VGA 外接显示器。	迈瑞	台	1	29500	29500	

		 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。 体外除颤仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。 体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为 25 种，最小为 1J，最大为 360J。 病人阻抗范围：体外除颤：20~250 欧；体内除颤：15-250 欧。 体外除颤仪支持 CPR 心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行 CPR 操作，过程符合 AHA2010 急救指南中 CPR 指南要求。 体外除颤仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为 14 种，最小为 1J，最大为 50J。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 体外除颤仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。 可选配升级实现 12 导 ECG、SP02、2 通道体温、NIBP、旁流呼气末 CO2。 可监测心律失常种类≥ 26 种。 主机具有≥ 160 小时趋势图和趋势表、$\geq 240\text{min}$ 录音存储。 体外除颤仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 体外除颤仪最大可配置 2 块锂离子电池，其中 1 块至少可支持 360J 除颤 210 次，单 ECG 检测≥ 6 小时。 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。 体外除颤仪配置 80mm 记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和 12 导报告。 实时记录时间有 3 秒、5 秒、8 秒、16 秒、32 秒、连续可供选择。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			体外除颤仪 IP 防护等级满足 IP44 等级要求。						
41	心电图机	252*202*50mm	型号：iMAC 100s 液晶大屏内 置存储高达 250 份报告 实时记录节律波形学 高分辨率热点阵打印	武汉中旗生物医疗电子邮箱公司	台	1	8500	8500	
42	B 超机	全数字彩色多普勒超声诊断系统	型号：ViV 20 一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统 二、设备用途：腹部、妇产科、心脏、小器官、浅表血管、肌骨及眼科、麻醉科、泌尿外科、神经外科等专科诊室的临床诊断需求。 三、特点 1. 领先的超声平台及架构采用新一代带“数字解调器”的超声前端芯片和 8 核 DSP 处理器，提供强大的运算能力且集成度更高、功耗更小、并可无缝升级支持弹性成像。 2. 多波束并行处理技术 （16 波束并行接收技术：B+C 模式时，腹部探头深度 $\geq 170\text{mm}$ 、全角度，ROI 框和 B 图	武汉中旗生物医疗电子有限公司	台	1	114000	114000	

		重合时，成像帧率$\geq 10.0\text{Hz}$) 3. 脉冲反向谐波成像技术 (PIHI) (所有探头支持脉冲反相谐波技术 (PIHI)：高频浅表探头谐波工作频率 10、11、12、13MHz 四档可调) 4. 合成孔径波束合成技术 (SA) 彻底突破传统 DAS 波束合成算法对物理通道数的限制，以较小的硬件规模和较低的发射功率获得从近场到远场优异的图像质量。 5. 发射逐点聚焦技术 (全域聚焦)：无焦点位置显示、无需手动调节焦点 6. 斑点噪声抑制技术 “mclear”，四档可调，有效去除了超声图像中的斑点噪声，获得更加清晰细腻的二维图像。 7 自由臂 3D+4D 成像技术用于胎儿检查，可大幅度提高畸形胎儿的超声检出率。 8. 四探头接口，自由切换，支持热拔插 9. DICOM3.0 接口，具备网络远						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			程协助工具软件，可由技术人员通过网络远程维护系统 10. 支持无线WiFi智能图像传输。						
43	心电监护仪	≤50VA	型号：PM-7000D 医用多参数监护仪，24H持续心电图、脉率、体温、呼吸、血压、血氧检测器，标配+电池	武汉中旗生物医疗电子有限公司	台	3	3500	10500	
44	氧瓶及吸氧设备	165W	整机保修1年，压缩机3年 主要原料：UOP分子筛 氧气浓度：1L-2L/min时，氧浓度94%-90% 应急保障：为就医争取时间 康复辅助：适当吸氧有助于身体尽快恢复 关爱老人：作为日常保健设备	宽城升华压力容器制造有限责任公司	台	10	900	9000	
45	吸痰装置及吸痰设备	360*320*480mm	1,采用单向型无油自润滑真空泵作负压源，无油雾污染，压力系统不会产生正压； 2,负压调节系统可根据痰及粘液的粘稠度作无级调压。 3,设有溢流保护装置可以防止吸入的液体进入中间管道； 4,配置的过滤器可以防止负压泵受到污染。	yuwell	台	5	4800	24000	

46	电动吸引器	480*165*285mm	1,采用单向型无油自润滑真空泵作负压源,无油雾污染,压力系统不会产生正压; 2,负压调节系统可根据痰及粘液的粘稠度作无级调压。 3,设有溢流保护装置可以防止吸入的液体进入中间管道; 5,配置的过滤器可以防止负压泵受到污染;	yuwell	台	1	4600	4600	
47	呼吸机	244*184*115mm	(1)能提供输送气体的动力,代替人体呼吸肌的工作; (2)能产生一定的呼吸节律,包括呼吸频率和吸呼比,以代替人体呼吸中枢神经支配呼吸节律的功能; (3)能提供合适的潮气量 (VT) 或分钟通气量 (MV), 以满足呼吸代谢的需要; (4)供给的气体最好经过加温和湿化,代替人体鼻腔功能,并能供给高于大气中所含的 O2 量,以提高吸入 O2 浓度,改善氧合。	晨伟 T50	台	1	9500	9500	
48	体温枪	电子体温计	类别: 电子体温计 特点: 高温提醒 测量部位: 额温, 记忆功能: 支持记忆功能	深圳市坪山 科仪科技有	个	10	42	420	

				限公司					
49	血糖仪	智能免调码	类别：指尖血检测，调码方式： 全自动免调码	可孚	个	3	180	540	
50	输液泵	24*12*18, 20CM	微量输液泵医用静脉注射泵， 高精度语音报警，数字键盘	上海蓝德 医疗器械 有限公司	台	3	2200	6600	
51	注射泵	306L*126W*141h	注射泵由步进电机及其驱动器、 丝杆和支架等构成，具有往复移 动的丝杆、螺母，因此也称为丝 杆泵。螺母与注射器的活塞相连， 注射器里盛放药液，实现高精度， 平稳无脉动的液体传输。	深圳市科 曼医疗设 备有限公 司	台	3	1600	4800	
52	抢救车	60x40x86cm	304 不锈钢，尺寸：60x40x86cm	粤博	台	1	480	480	
53	气管插 管			益心达	套	1	800	800	
54	治疗车	60x40x86cm	304 不锈钢，尺寸：60x40x86cm	粤博	台	2	480	960	
55	紫外线 车	100-240V	操控方式：遥控器控制，类别： 家用杀菌灯， 最大瓦数：60W 以上，电压： 100-240V， 适用面积：20 m²及以下，电源方 式：交流电，	QSDC-11 常州市威 墅堰医疗	台	4	250	1000	

			带臭氧、紫外线光源，固定方式： 底座	器械有限 公司					
56	平车	1900mm*600mm*720mm	名称：不锈钢担架车 材质：202 不锈钢/304 不锈钢 床垫材质：加厚 PU 皮革 车轮特点：万向防滑可刹车脚轮 产品颜色：黑色/蓝色 尺寸：1900mm*600mm*720mm 产品类别：A 类(一体)R 米(分体)D	粤博	台	1	1450	1450	
57	晨晚间 护理车	60x40x86cm	304 不锈钢，尺寸：60x40x86cm	粤博	台	1	350	350	
58	病历车	25 格	不锈钢病历夹推车， 【单排不锈钢】病历车 25 格	粤博	台	1	330	330	
59	无线呼 叫系统		无线医院呼叫器护士站病房床头 呼叫器 40 路普通主机+40 个手柄分机	山东亚华电 子股份有限 公司	组	2	1100	2200	
60	便携式 雾化吸 入器	3.6 μm	压缩机寿命：5 年 噪音：≤55dB 适用范围：将液态药液雾化供患 者吸入	鱼跃	个	2	350	700	
61	医用气 垫床	条纹式 22 管	22 管专业双气管交替波动能显著 预防褥疮，为患者提供舒适的使用 体验，产品通过生物相容性测	迈德斯特	张	20	650	13000	

			试、内配备智能降噪设计。软硬件双管齐下，给你舒适的躺卧体验。						
62	体征监测仪	病人多参数监护仪	型号：PM-7000D 心电、体温、呼吸、无创血压、血氧、脉率	武汉中旗生物医疗电子有限公司	台	30	900	27000	
63	压疮垫	条纹22管	22管专业双气管交替波动能显著预防褥疮，为患者提供舒适的使用体验，产品通过生物相容性测试、内配备智能降噪设计。软硬件双管齐下，给你舒适的躺卧体验。	迈德斯特	套	60	600	36000	
64	药瓶阴凉柜	220V	功能：制冷门数：单门额定电压：220V	淄博雨嘉商用厨具有限公司	台	2	1200	2400	
65	不锈钢器械柜	1800*900*400	304 不锈钢，尺寸：1800*900*400	粤博	台	2	1200	2400	
66	可移动输液架	304 不锈钢	304 不锈钢、移动式、落地式、点滴架五角梅花 4 钩	粤博	台	15	45	675	
67	体重秤	91*54*29cm	产品名称：标准身高体重秤 产品规格：外形尺 91*54*29cm， 承重板面积：37*27cm	花潮科技	台	1	230	230	

			长度计量：量度范围 70-190cm 重量计量：称量 120 千克 净 重：9 千克 使用场合：医院、家用、学校、其他等 功能：动物称功能、峰值保留功能、上下限报警功能						
68	药品货架	长 90*宽 40*高 190cm	金属五层主架单面【长 90*宽 40*高 190cm】	粤博	组	4	450	1800	
69	冷藏柜	电压：220V	功能：制冷门数：单门额定电压：220V	淄博雨嘉商用厨具有限公司	台	2	1200	2400	
70	阴凉柜	功率：101-200W	制冷方式：风冷，功率：101-200W 功能：制冷门数：单门额定电压：220V	淄博雨嘉商用厨具有限公司	台	2	1200	2400	
71	实验室（检验科）设备	1 批	实验室设备需满足以下检验项目：血细胞分析+五分类；尿常规；粪常规+粪隐血；凝血五项；D-二聚体；B 型前脑尿肽检测（Pro-BNP）；全程 C 反应蛋白；血脂五项；肝功十三项；肾功五项；电解质三项；传染病五项；	深圳市康立生物医疗有限公司	批	1	146000	146000	

			心肌酶五项；甲/乙型流感病毒检测；心损三项；血气分析；红细胞沉降率；肺炎支原体 IgG IgM 检测。						
72	煎药设备	全自动煎药设备	全自动中药煎药机熬药机包装一体机	长沙市卓成医疗器械有限公司	套	1	8200	8200	
73	妇科检查椅	多功能折叠升降椅	多功能折叠升降椅，一拖一背部腿部手动	尚康利	张	1	2900	2900	
74	紫外线消毒机	1.2m*1.2m*2m	医用级医院用消毒净化器，移动紫外线、臭氧、等离子除菌杀菌病毒	宁波汇凝科技有限公司	个	10	500	5000	
75	紫外线消毒机		医用级医院用消毒净化器，移动紫外线、臭氧、等离子除菌杀菌病毒	宁波汇凝科技有限公司	个	10	500	5000	
76	导视系统（如下）				套	1			
77	背景墙底板（需拼接）	3200*900	5mm 亚克力+广告钉	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	1	1200	1200	主 1F
78	背景墙 LOGO	2200*500	5mm 亚克力烤漆+高精 UV	铜川市兴尚	套	1	1000	1000	主 1F

				源建筑工程 有限公司					
79	服务台	200*200	不锈钢精工字	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	1	900	900	主 1F
80	大门腰线（高 15cm）	1170*12+1050*6+ 770*4+800*4	磨砂贴 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	m	26.6 2	22	585.64	主 1F
81	南侧门 腰线（高 15cm）	600*4	磨砂贴 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	m	2.4	22	52.8	主 1F
82	办公区 腰线（高 15cm）	1720+190+710+71 0+190+3430+870+ 2700+2700+870+2 080+2080+870+71 0+710+750+750+7 20+720+600+600+ 580+580	磨砂贴 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	m	25.8 4	22	568.48	主 1F
83	护理团	2400*1500	雪弗板+亚克力高清 UV+亚克力插	铜川市兴尚	个	1	1850	1850	主 1F

	队介绍		槽	源建筑工程 有限公司					
84	楼层编 号牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	11	42	462	主 1F
85	入住流 程图	800*2000	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	450	450	主 1F
86	1F 区域 消防公 示牌(负 责人)	210*297	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	42	42	主 1F
87	卫生间 门牌 竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	42	126	主 1F
88	节约用 水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程	个	2	30	60	主 1F

				有限公司					
89	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	2	9	18	主 1F
90	办公室门牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	8	42	336	主 1F
91	管道井标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	3	30	90	主 1F
92	推拉	100*100	3mm 亚克力高清 UV, 1 套两个	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	7	22	154	主 1F
93	电梯间楼层索引	1400*600	不锈钢烤漆+丝网印+亚克力 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	1	1550	1550	主 1F

94	消防栓 贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	80	240	主 1F
95	休息区 腰线	1500*10个	磨砂贴 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	m	15	22	330	主 2F
96	卫生间 门牌 竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	42	126	主 2F
97	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	42	42	主 2F
98	节约用 水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	30	30	主 2F
99	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚	个	2	9	18	主 2F

				源建筑工程 有限公司					
100	门牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	11	42	462	主 2F
101	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	30	90	主 2F
102	推拉	100*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	8	22	176	主 2F
103	电梯间 楼层索 引	1400*600	不锈钢烤漆+丝网印 +亚克力 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	1	1550	1550	主 2F
104	消防栓 贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程	块	4	80	320	主 2F

				有限公司					
105	包间门牌	350*200	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	3	42	126	主 3F
106	厨房重地	300*200	不锈钢 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	4	25	100	主 3F
107	厨房	250*160	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	9	36	324	主 3F
108		160*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	17	22	374	主 3F
109		80*80	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	6	10	60	主 3F

110		100*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	35	12	420	主 3F
111		400*200	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	2	54	108	主 3F
112		350*200	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	5	42	210	主 3F
113	卫生间门牌竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	3	30	90	主 3F
114	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	1	42	42	主 3F
115	节约用水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚	个	1	30	30	主 3F

				源建筑工程 有限公司					
116	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	9	18	主 3F
117	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	30	90	主 3F
118	电梯间 楼层索 引	1400*600	不锈钢烤漆+丝网印 +亚克力 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	1	1550	1550	主 3F
119	消防栓 贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	5	80	400	主 3F
120	卫生间 门牌竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程	个	3	42	126	主 4F

				有限公司					
121	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	1	42	42	主 4F
122	节约用水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	1	30	30	主 4F
123	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	2	9	18	主 4F
124	门牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	13	42	546	主 4F
125	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	3	30	90	主 4F

126	推拉	100*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	7	22	154	主 4F
127	电梯间楼层索引	400*600	不锈钢烤漆+丝网印+亚克力 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	1	1550	1550	主 4F
128	消防栓贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	4	80	320	主 4F
129	卫生间禁止吸烟标识	100*100	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	11	6.8	74.8	主 1F-11F
130	监控区域	100*100	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	22	6.8	149.6	主 1F-11F
131	房号指引牌	400*200	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚	个	14	54	756	主

				源建筑工程 有限公司					5F-11F
132	护理站	1200*700	水晶字	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	7	550	3850	主 5F-11F
133	开水间	250*150	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	7	36	252	主 5F-11F
134	卫生间 门牌 竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	21	42	882	主 5F-11F
135	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	7	42	294	主 5F-11F
136	节约用 水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程	个	14	30	420	主 5F-11F

				有限公司					
137	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	14	9	126	主 5F-11F
138	双层门牌	330*200	3mm 亚克力高清 UV+立体数字	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	119	60	7140	主 5F-11F
139	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	63	30	1890	主 5F-11F
140	电梯间楼层索引	1400*600	不锈钢烤漆+丝网印+亚克力 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	11	1550	17050	主 5F-11F
141	消防栓贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	35	80	2800	主 5F-11F

142	大门腰线（高15cm）	890*4+860+900*2+740+780*2+740+880+860+910+890*4+870+710*2+710*4+710*2		铜川市兴尚源建筑工程有限公司	m	22.3	26	579.8	副 1F
143	服务台	200*200	不锈钢精工字	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	1	900	900	副 1F
144	门牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	6	42	252	副 1F
145	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	4	30	120	副 1F
146	消防栓贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	2	80	160	副 1F
147	卫生间门牌	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚	个	3	42	126	副 1F

	竖			源建筑工程 有限公司					
148	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	42	42	副 1F
149	节约用 水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	30	60	副 1F
150	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	9	18	副 1F
151	护理站	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	42	84	副 2F-3F
152	开水房、 洗衣房	250*150	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程	个	2	36	72	副 2F-3F

				有限公司					
153	卫生间 门牌 竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	42	126	副 2F-3F
154	服务台	200*200	不锈钢精工	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	2	900	1800	副 2F-3F
155	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	42	84	副 2F-3F
156	节约用 水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	30	60	副 2F-3F
157	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	4	9	36	副 2F-3F

158	双层门牌	330*200	3mm 亚克力高清 UV+立体数字	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	18	60	1080	副 2F-3F
159	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	8	30	240	副 2F-3F
160	值班室	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	1	30	30	副 2F-3F
161	消防栓贴图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	2	80	160	副 2F-3F
162	门牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	6	42	252	B1
163	管道井	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚	个	2	30	60	B1

				源建筑工程 有限公司					
164	卫生间 门牌 竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	42	126	B1
165	无障碍	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	42	84	B1
166	节约用 水标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	30	60	B1
167	冷热水	30*30	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	4	9	36	B1
168	电梯间 楼层索 引	1400*600	不锈钢烤漆+丝网印	铜川市兴尚 源建筑工程	块	1	1320	1320	B1

				有限公司					
169	消防栓 警示贴 图	700*1800	车贴+高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	5	80	400	B1
170	地下车 库入口 提示牌	800*500	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	1	120	120	B1
171	电梯按 钮指引	200*150	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	39	12	468	新增标 识
172	房间内 紧急疏 散图	700*3000	KT 板覆哑膜	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	123	14	1722	新增标 识
173	走廊内 紧急疏 散图	700*3000	KT 板覆哑膜	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	27	14	378	新增标 识

174	房门内 开关贴	1000*500	透明车贴	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	批	1	600	600	新增标 识
175	房间内 沐浴冷 热水	250*250	3mm 亚克力高清 UV, 1 套两个	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	123	15	1845	新增标 识
176	房间内 小心地 滑	620	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	123	34	4182	新增标 识
177	车库口 立牌	1500*1500/个	镀锌板烤漆+立体字	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	4500	4500	户外
178	康养楼 接待大 厅	1500*1500/个	镀锌板烤漆+立体字	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	4500	4500	户外
179	车库出 入口	3800*3800/个	铝板+3M7 年反光膜	铜川市兴尚	个	2	500	1000	户外

				源建筑工程 有限公司					
180	保安室 门牌	2600*3050	3mm亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	1	42	42	户外
181	保安室 腰线	5000*16000	磨砂贴 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	m	0.62	22	13.64	户外
182	康养楼		不锈钢精工+背架	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	1150	3450	户外
183	医养楼	4100*1850	不锈钢精工+背架	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	3	1150	3450	户外
184	楼顶字 (LOGO) 装相近	3450*750	铝板外露发光字背架子	铜川市兴尚 源建筑工程	个	1	7800	7800	户外

	色灯光			有限公司					
185	楼顶字 (中文) 烤漆	1200*5000	铝板外露发光字背架子	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	7	4800	33600	户外
186	楼顶字 架子		国标 50 角铁花架 腿 30*30	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	组	1	15000	15000	户外
187	电源、时 控开关	电源开关	额定电压：220V 额定电流 3A 时控范围：1min-168h 安装方式：导轨式、墙挂式、装 置式	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	15	160	2400	户外
188	大门口 石材金 属字		拆除、打磨、抛光	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	项	1	1200	1200	户外
189	大门口 石材字	定制款	不锈钢精工烤漆	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	1	2500	2500	户外

190	路边导引（梯形三面）	定制款	镀锌板烤漆+发光字，加预埋	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	1	8000	8000	户外
191	电梯内乘梯须知与创文	500*700	钢化玻璃+高清相纸	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	9	140	1260	1F
192	易拉宝展架	800-2000	支撑式	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	5	63	315	1F
193	电梯门安全警告、电梯门紧急呼救	80*30*2mm	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	6	18	108	1F
194	电梯内环境标识	10*35CM	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	3	18	54	1F
195	文化墙、制度牌	800*600	型材边框+超卡	铜川市兴尚	块	18	130	2340	2F

				源建筑工程 有限公司					
196	健康膳食展示牌、食堂工作规范牌	2400*1200	雪弗板+亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程 有限公司	块	4	1180	4720	3F
197	食堂海报	800*600	型材边框+超卡	铜川市兴尚源建筑工程 有限公司	块	18	130	2340	3F
198	操作规范牌	800*600	小银边+哑光写真覆超卡	铜川市兴尚源建筑工程 有限公司	块	8	42	336	3F
199	文化墙、制度牌	900*600	型材边框+超卡	铜川市兴尚源建筑工程 有限公司	块	135	130	17550	1-4F
200	玻璃墙进行防火板、腻子	2F、4F 玻璃墙区域	龙骨支架、阻燃基层、防火石膏板、腻子	铜川市兴尚源建筑工程	批	1	25000	25000	2F 、4F

	子处理			有限公司					
201	会议室 党建文 化墙	2400*1200	雪弗板+亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	2	1180	2360	4F
202	入住人 员信息 卡(双 人)	A4	3mm 亚克力高清 UV+卡盒	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	105	60	6300	5F-1 1F
203	入住须 知	A4	雪弗板+亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	105	42	4410	5F-1 1F
204	护士站 在岗人 员信息 牌	600*900	雪弗板+亚克力高清 UV	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	10	180	1800	5F-1 1F
205	房间内 紧急救 护信息 贴纸(数 量待确	100*100	夜光反光条	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	105	24	2520	5F-1 1F

	认)								
206	小心开水提示图标贴纸	100*100	车贴+高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	10	6.8	68	5F-1 1F
207	房间温馨提示牌	150*80	3mm 亚克力高清 UV 背即时贴	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	220	22	4840	5F-1 1F
208	制度、操作规范	800*600	型材边框+超卡	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	21	130	2730	5F-1 1F
209	各室门牌	250*250	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	11	42	462	B1
210	制度、操作规范	800*600	型材边框+超卡、7 间各 3 块	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	21	130	2730	

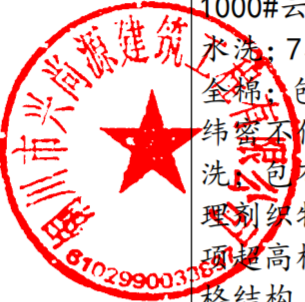
211	管道井标识	200*100	3mm 亚克力高清 UV 背即时贴	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	3	24	72
212	卫生间门牌竖	200*350	3mm 亚克力高清 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	3	42	126
213	卫生间温馨提示牌	150*80	3mm 亚克力高清 UV 背即时贴	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	30	22	660
214	电梯间楼层索引	1400*600	不锈钢烤漆+丝网印+亚克力 UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	1	1550	1550
215	消防疏散图	400*250	KT 板覆哑膜	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	11	14	154
216	消防疏散图	900*600	KT 板覆哑膜	铜川市兴尚	块	2	36	72

				源建筑工程 有限公司					
217	负 2F 层 顶部指 引指示 牌	2600*300	铁艺镂空灯箱	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	套	1	1500	1500	
218	车库左 右两侧 行驶指 示	30000*1000	喷漆	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	项	1	4800	4800	
219	柱子行 驶（箭 头）指示	600*600	反光膜	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	20	72	1440	
220	车库凸 面镜	600*600	玻璃和水晶	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	个	2	50	100	
221	安全通 道标识	120*330	夜光牌	铜川市兴尚 源建筑工程	个	10	20	200	

				有限公司					
227	禁止通行标识牌	600*600	铝板+反光膜	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	1	95	95	
228	花草牌	450*350	镀锌板烤漆	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	10	130	1300	户外
229	住宿区房间内装饰画	60*60 艺术无框画	风景类、艺术画、淡雅为主	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	21	165	3465	60*60 艺术无框画
230	住宿区房间内装饰画	120*50 艺术无框画	风景类、艺术画、淡雅为主	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	21	360	7560	120*50 艺术无框画
231	5-11 层活动房装饰画	120*50 艺术无框画	风景类、艺术画、淡雅为主	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	7	360	2520	120*50 艺术无框画

232	配电箱 装饰画	外框尺寸 50× 40cm 覆盖厚度 3cm	外框尺寸 50×40cm 覆盖厚度 3cm 风景类、艺术画、淡雅为主	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司		121	85	10285	
233	不锈钢 垃圾箱	(黄、绿、兰)	不锈钢，尺寸：108*90*36	猎雅	组	5	1200	6000	户外 3、 主副楼 一层各 1
234	室外垃 圾台	长 6 米*宽 2.5 米* 高 2.8 米	外墙：金属雕花板保温板 外漆工艺：结构胶密封 基础配置：配电箱、开关、灯 插座、换气扇 内顶：PVC 吊顶 顶部：沥青瓦 门窗：铝合金卷帘门 底部：防滑花纹钢板	三傲	项	1	17500	17500	定制 款
235	室内垃 圾篓	10L	10L 双层垃圾桶，直径 23cm，高 27cm	妙立	个	200	12	2400	
236	公共区 域垃圾 筒	不锈钢垃圾桶 38*73cm	不锈钢垃圾桶 38*73cm 圆形垃圾箱翻盖港式桶立	欣越	个	48	210	10080	不锈钢 垃圾桶 38*73c m
小计									1022996.76 元
二、餐厨及其他									

1	床上用品	四件套	 1、定型双面枕芯：45*75、每个1.1 公斤；填充：1100g, 一面 200 克水洗苦荞麦皮，一面 900 克羽绒。2、枕套：55*85、长绒全棉精梳 60s*80s, 全工艺防过敏处理，喷气双纬贡缎免费加机构织标。100 生态环保标准，四周韭叶双针，背开口三分之一处插入 15 厘米。3、床单：160*240 长绒全棉精梳 60s*80s, 全工艺防过敏处理，喷气双纬贡缎免费加机构织标。100 生态环保标准，宽度边卷边 2 厘米，长度边卷边 1 厘米。4、被套：160*215、长绒全棉精梳 60s*80s, 全工艺防过敏处理，喷气双纬贡缎免费加机构织标。100 生态环保标准，底开折入 5 厘米，两边封口，2 个绑带；底部封口处防撕裂工艺。5、秋冬季被芯：150*200、3000#全棉仿羽绒布：包布面料纱支为 40*40S 经纬密不低于 133/100 全棉白色防羽布，可水洗；包布采用预缩冷堆、柔软处理剂织物前处理；工艺：25cm*25cm 切穿方格结构经过防	西安万印商贸有限公司	套	240	890	213600	含被褥枕头等
---	------	-----	--	------------	---	-----	-----	--------	--------

			 虫蛀、防菌、防过敏处理, 四周双针捆绳, 加水洗标; 6、夏凉被: 1000#云丝棉填充物; 不套被套可水洗; 7、保护垫: 100*200、2400#全棉; 包布面料纱支为 40*40S 经纬密不低于 110/76 桃皮绒, 可水洗。包布采用预缩冷堆、柔软处理剂织物前处理等室内纺织品 21 项起高标准; 工艺: 整张绗缝方格结构, 带床加宽加密松紧带固定。						
2	洗手间—毛巾架等	太空铝浴巾架、毛巾杆、铝挂钩、厕纸盒、三角篮、马桶刷	六件套 (太空铝浴巾架、毛巾杆、铝挂钩、厕纸盒、三角篮、马桶刷)	德力西	套	127	250	31750	
3	镜子	1 面	一、产品组成 由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸: 850mm×670mm×1900mm 2) 镜面玻璃厚度: 5mm 产品用途 用于各种姿势或表情的矫正训练。	other	面	1	500	500	

4	花木修剪机	汽油机	家用剪枝机二冲程单刃双刃绿篱机两冲程 电压：21V 冲程速度：2400spm 刀片切割宽度：540mm 减速比：15 修减直径：18mm	德力西 DLX-DCPS185 9	台	1	800	800	手提式汽油
5	绿植（如下）				批	1			
6	非洲茉莉塔	1.8*2.0米	带瓷盆	/	盆	4	350	1400	
7	发财树	1.1米	带瓷盆	/	盆	10	160	1600	
8	幸福树	1.1-1.3米	带瓷盆	/	盆	10	160	1600	
9	也门铁	1.4*1.5米	带瓷盆	/	盆	8	160	1280	
10	夏威夷	1.6*1.8米	带瓷盆	/	盆	7	260	1820	
11	天堂鸟	1.3-1.4米	带瓷盆	/	盆	10	220	2200	
12	金钱树	1米	带瓷盆	/	盆	10	200	2000	
13	桌面盆栽		不要绿萝，带瓷盆	/	盆	50	40	2000	
14	餐具（如下）				套	1			
15	炒锅	尺8	60cm 铁	稷山县翟店	口	2	110	220	

				镇鑫兴铸造厂					
16	小台秤	30KG	30KG 电器	武义大河电子有限公司	台	1	200	200	
17	不锈钢蒸米饭盘	40*60*4.8	304 不锈钢 40*60*4.8	揭阳空港经济 济区兴烨厨五金制品厂	个	30	28	840	
18	不锈钢蒸馍盘	40*60*4.8	304 不锈钢 40*60*4.8	揭阳空港经济 济区兴烨厨五金制品厂	个	30	28	840	
19	电子称	100KG	100KG 电器	武义大河电子有限公司	台	1	330	330	
20	不锈钢桶	60CM	304 不锈钢 60*60	潮州市潮安区金石镇钢龙五金制品厂	个	2	425	850	

21	不锈钢桶	50CM	304 不锈钢 50*50	潮州市潮安区金石镇钢龙五金制品厂	个	4	235	940	
22	不锈钢桶	40CM	304 不锈钢 40*40	潮州市潮安区金石镇钢龙五金制品厂	个	5	170	850	
23	不锈钢盆	60CM	304 不锈钢 60CM	揭阳空港经济区兴烨厨五金制品厂	个	10	95	950	
24	不锈钢盆	50CM	304 不锈钢 50CM	揭阳空港经济区兴烨厨五金制品厂	个	10	48	480	
25	不锈钢盘	40CM	304 不锈钢 40CM	揭阳空港经济区兴烨厨	个	10	28	280	

				五金制品厂					
26	菜筐	40*60	塑料	四川省恒丰 塑胶有限公司	个	35	35	1225	
27	不锈钢餐盘员工使用	长 35cm 宽 26cm 高 2cm	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	70	15	1050	
28	不锈钢双层碗员工使用	304 材质 18CM	304 不锈钢	潮州市潮安 区龙江不锈 钢制 品有限公司	个	70	17	1190	
29	不锈钢双层汤碗员工使用	304 材质 13CM	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	70	12	840	
30	筷子不锈钢 304 材质	23.5cm	304 不锈钢	揭阳市揭东 区曲溪双好 五金塑胶制 品厂	双	70	4.5	315	

31	不锈钢 304 材质 饭勺	15.8cm	304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	个	70	3.8	266	
32	保温桶	60L	304 不锈钢	潮州市潮安 区金石镇钢 龙五金制品 厂	个	2	280	560	
33	铁锅	特厚 1000CM	铁	稷山县翟店 镇鑫兴铸造 厂	个	3	680	2040	
34	菜刀	2 号片刀	不锈钢 李氏家	阳江市阳东 区李氏家铁 匠铺	把	10	110	1100	
35	砍刀	2 号	不锈钢 李氏家	阳江市阳东 区李氏家铁 匠铺	把	2	210	420	

36	菜墩	PE 六色 50cm	树脂	临沂市高新区金雨露加工有限公司	个	6	320	1920	
37	油漏	10寸	304 不锈钢	揭阳空港经济兴烨厨五金制品厂	个	5	38	190	
38	大炒菜铲	不锈钢	304 不锈钢	揭阳空港经济兴烨厨五金制品厂	套	5	75	375	
39	垃圾桶	50CM 高	塑料	四川省恒丰塑胶有限公司	个	4	210	840	
40	带盖留样盒	食品级塑料容量 300 克	塑料	四川省恒丰塑胶有限公司	个	30	4	120	
41	保鲜盒	30*20	塑料	四川省恒丰塑胶有限公司	个	50	18	900	

42	食品箱	570*420*31	塑料	四川省恒丰 塑胶有限公司	个	35	80	2800	
43	周转箱	595*465	塑料	四川省恒丰 塑胶有限公司	个	20	60	1200	
44	擀面杖	900MM	木头	临沂市高新 区金雨露加 工有限公司	个	2	25	50	
45	擀面杖	400MM	木头	临沂市高新 区金雨露加 工有限公司	个	2	10	20	
46	食品夹		不锈钢	揭阳空港经 济区兴辉厨 五金制品厂	个	20	10	200	
47	锅刷		塑料皮木头	四川省恒丰	个	20	10	200	

				塑胶有限公司					
48	调料罐	18CM	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	40	15	600	
49	调料罐	22CM	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	30	20	600	
50	密漏	10 寸	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	5	45	225	
51	油古子	10 寸	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	5	50	250	
52	手打勺	十两	304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨	个	10	40	400	

				五金制品厂					
53	打菜勺	九两	304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	个	10	25	250	
54	打饭勺		304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	个	10	16	160	
55	箴篱	大号	304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	个	4	45	180	
56	油石	大号	石头	临沂市高新 区金雨露加 工有限公司	块	2	14	28	
57	水瓢		304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	个	4	25	100	

58	马瓢		304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	4	25	100	
59	肉勾		304 不锈钢	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	2	20	40	
60	高压锅	直径 50cm	304 不锈钢	永康市安玖 工贸有限公司	个	1	460	460	
61	绞蒜器		电器	中山市隆粤 电器有限公司	个	1	160	160	
62	温度计		不锈钢玻璃	衡水市博德 福仪器仪表 有限公司	个	10	30	300	
63	刀箱		304 不锈钢	揭阳空港经	台	4	70	280	

				济区兴烨厨 五金制品厂					
64	大锅盖	直径 1000cm	304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	个	3	110	330	
65	剪刀		304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	把	4	20	80	
66	油刷	6 寸	304 不锈钢	揭阳空港经 济区兴烨厨 五金制品厂	把	4	6.5	26	
67	地刮	橡胶刮片，把长 150cm	橡胶	临沂市高新 区金雨露加 工有限公司	套	5	58	290	
68	保温汤 桶带盖	304 不锈钢 50cm 加厚	304 不锈钢	潮州市潮安 区金石镇钢	个	10	360	3600	

				龙五金制品 厂					
69	保温汤 桶带盖	304 不锈钢 40cm	304 不锈钢	潮州市潮安 区金石镇钢 龙五金制品 厂	个	15	340	5100	
70	密胺瓷 汤碗 A5 材质白 色	老人用直径 15cm 高 12cm	密胺	东莞市诺森 密胺制品有 限公司	个	250	13.5	3375	
71	密胺筷 子 A5 材 质白色	23cm	密胺	东莞市诺森 密胺制品有 限公司	双	250	1.5	375	
72	密胺瓷 面碗 A5 材质白 色	老人用带盖子	密胺 15x7	东莞市诺森 密胺制品有 限公司	个	250	14	3500	
73	密胺瓷 餐盘 A5	老人用直径 35cm. 宽 30cm	密胺 39x30	东莞市诺森	个	250	24	6000	

	材质白色			密胺制品有限公司					
74	密胺瓷汤勺 A5 材质白色	老人用 18cm	密胺 18cm	东莞市诺森密胺制品有限公司	个	250	7	1750	
75	勺子	12CM	陶瓷	唐山市开平区盛旺瓷厂	把	60	6	360	
76	白金碗	10CM/3 寸	陶瓷	唐山市开平区盛旺瓷厂	个	60	12.5	750	
77	热菜盘	10-40CM 不等	陶瓷	唐山市开平区盛旺瓷厂	个	50	45	2250	
78	鱼盘	40cm/12 寸	陶瓷	唐山市开平区盛旺瓷厂	个	5	60	300	
79	筷子	28cm	合金	临沂市高新区金雨露加工有限公司	双	100	7.5	750	

80	白酒分酒器	高 10cm	玻璃 抗热震性和热震耐久性合格	利比玻璃制品(中国)有限公司	个	50	15	750	
81	红酒分酒器	高 25cm	玻璃 抗热震性和热震耐久性合格	利比玻璃制品(中国)有限公司	个	2	65	130	
82	红酒杯	25cm	玻璃 抗热震性和热震耐久性合格	利比玻璃制品(中国)有限公司	个	20	25	500	
83	啤酒杯	20cm	玻璃 抗热震性和热震耐久性合格	利比玻璃制品(中国)有限公司	个	50	9	450	
84	白酒杯	8cm	玻璃 抗热震性和热震耐久性合格	利比玻璃制品(中国)有限公司	个	50	3	150	
85	筷托	8cm	陶瓷	唐山市开平	个	60	7.5	450	

				区盛旺瓷厂					
86	破壁机	4 升	电器	中山市隆粤 电器有限公司	个	1	880	880	
87	铁板（生 铁）	20CM	铁	稷山县翟店 镇鑫兴铸造 厂	个	2	50	100	
88	面碗（包 间）	15CM 白瓷	陶瓷	唐山市开平 区盛旺瓷厂	个	25	10	250	
89	烟灰缸	陶瓷	陶瓷	唐山市开平 区盛旺瓷厂	个	15	20	300	
90	牙签盒 （陶瓷）	陶瓷	陶瓷	唐山市开平 区盛旺瓷厂	个	10	9	90	
91	汤盆（陶 瓷）	25CM	陶瓷	唐山市开平 区盛旺瓷厂	个	2	65	130	
92	茶水杯 （陶瓷）	7.5x7	陶瓷	唐山市开平 区盛旺瓷厂	个	50	9	450	

93	餐具垫子	灰色（包间使用）	布	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	50	6.5	325	
94	砂锅竹网	230cm	木质	揭阳空港经济 区兴烨厨 五金制品厂	个	10	6.5	65	
95	锅仔（生铁）	20CM	铁	稷山县翟店 镇鑫兴铸造 厂	个	2	40	80	
96	带火砂锅（白瓷）	35CM	陶瓷	唐山市开平 区盛旺瓷厂	个	2	85	170	
97	菜刀	2号片刀	304 不锈钢 李氏家	阳江市阳东 区李氏家铁 匠铺	把	10	110	1100	
98	密胺瓷餐盒 A5 材质，带	长 26cm 宽 20cm 高 5cm	密胺 260*200*53	东莞市诺森 密胺制品有	个	250	18	4500	

	盖子			限公司					
99	割草机	230KW	型号: TMS4202 电机: 铜线电机 功率: 2300W 电压: 220-240v 割草宽度: 420mm 割草高度: 25-75mm 调高系统: 5 档调高 1 杆调节 集草袋容量: 45L 机器净重: 12.5kg 汽油割灌机打草机除 草机斜挎式割草机	余姚托马斯 园林工具有 限公司	台	1	800	800	
100	多功能 擦地机	825*1400*1040mm	洗刷吸三合一, 秒干不留痕	扬子	台	1	7500	7500	
101	吹干机	50*43.5*43cm	吹地机厕所地面吹干机地毯吹干 机鼓风机	洁霸		2	450	900	
102	热水壶	2L	316 不锈钢热水壶	苏泊尔	个	150	150	22500	
103	烧水壶	1.8L	防烫烧水壶智能断电	美的	个	20	70	1400	
104	房口车	不锈钢双通车 5 寸-整装款	酒店双边房口车客房工作清洁服 务车保洁车 脏布回收车不锈钢双通车 5 寸-整 装款	斯铂格	个	2	1250	2500	
105	清洁车	承重 200 斤	多功能清洁车手推杂物车保洁工 具车 酒店服务垃圾收纳车多用途清洁 车	欧唛多功 能清洁车	个	4	250	1000	

106	送餐车	60×40×95cm 3层	不锈钢餐车封闭三层带门封闭式推车 养老院医院送菜 60×40×95cm 3层	万盛家具 送餐车	个	10	3500	35000	
107	板车	72x46cm 承重 300斤	小推车折叠平板车 72x46cm 承重 300斤	好嘉居	个	4	300	1200	
108	高压水枪	220V	高压洗车水枪家用 220V 大功率商用工业洗地神器强化款 A+23 米进出水管+调压阀+升级大滚轮 型号: A5 电压/频率: 220/50 使用压力: 120 最大压力: 160	金华开凯 清洁设备 有限公司	个	1	1500	1500	
109	保温车	1 个	保温送餐车手推餐车医院养老院单位食堂送饭车 4 盒+1 桶	好嘉居	个	1	4500	4500	
110	淋浴椅	100 个	老人洗澡专用椅 防滑大吸盘防侧翻、可调节高度、带扶手靠背	雅马哈	个	100	410	41000	
111	车库安装 电动车充电桩	80KW	80KW 双枪直流充电桩, 工作电压:DC150V-750V 连续可调, 7 寸高亮触摸屏, 枪线长度:≥4.5 米, 支付方式: 刷卡、扫码 (微信、支付宝), MTBF:10 万小时, 尺寸:1655*705*490mm	广东道尔电 科技术有限公司	套	1	25000	25000	80KW 双枪 直流 充电桩

112	普通床	1 米单人床	1000*2000, 软包减去, 床侧板离地 100, 棕垫厚 100 床座高 460, 1. 采用优质实木框架。2. 油漆: 采用全自动喷漆线先进油漆工艺“五底三面”, 底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、环保等指标不低于 E1 级的符合 GB18581-2009 品牌油漆	陕西范玺家具系统工程 有限公司	张	19	2700	51300	
113	电动床	900*2000 900*2000	电动双电机带轮带垫子 长度 2010±30 宽带 950±30 最低高度 250±50 最大高度 600±50 背部折起角度 0~70° 腿部折起角度 0~25°	梦泊 (上海) 科技有限公 司	台	23	4300	98900	
114	棕垫	1 米	1000*2000*100, 天然椰棕, 针织面料	西安福和家具有限公司	张	19	320	6080	已采购标准; 和床配套
115	扶手	450*450 高	1. 采用优质实木。 2. 油漆: 采用全自动喷漆线先进油漆工艺“五底三面”, 底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、环保等指标不低于 E1 级的符合 GB18581-2009 品牌油漆	梦泊 (上海) 科技有限公 司	支	38	150	5700	已采购标准 扶手间距需优化
116	床头柜	450*450*500	1. 板材: 采用 E1 级环保三聚氰胺板符合 GB/T 15102-2017 技术标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m³, 经	陕西范玺家具系统工程	个	17	430	7310	

			防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准 2. 封边：采用优质新型环保封边带，大型环绕式全自动机械封边机封边，甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$.	有限公司					
117	方桌	650*650*750	1. 基材：采用环保多层板，各种物理化学性能指标均达到相关标准。优质绿色环保产品，实木脚架。 2. 油漆：采用全自动喷漆线先进油漆工艺“五底三面”，底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、环保等指标不低于 E1 级的符合 GB18581-2009 品牌油漆 3. 五金配件：优质一线品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件。	陕西范玺家具系统工具有限公司	个	9	780	7020	
118	衣柜	1800*600*2500 下为两扇推拉门 上为四扇平开门	1. 板材：采用 E1 级环保三聚氰胺板符合 GB/T 15102-2017 技术标准，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到相关标准 2. 封边：采用优质新型环保封边带，大型环绕式全自动机械封边机封边，甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$.	陕西范玺家具系统工具有限公司	组	26	4550	118300	

119	挂衣板	700*1700 其中 05号房 650*1700 08号房 600*1700	1. 板材：采用 E1 级环保三聚氰胺板符合 GB/T 15102-2017 技术标准，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到相关标准 2. 封边：采用优质新型环保封边带，大型环绕式全自动机械封边机封边，甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 带挂衣钩	陕西范玺家具系统工程有限责任公司	件	13	840	10920	10F 每个房间一个
120	棋牌桌 电动	1000*1000*750	铜芯电机、四面恒温、EVA 隔音棉 出牌方式：四口机、USB 接口 类型：折叠式 打骰子方式：电动打骰子	雀友	张	1	2500	2500	
121	棋牌桌 手动	880*880*750	型号：809 1. 基材：采用环保多层板，各种物理化学性能指标均达到相关标准。优质绿色环保产品，实木脚架。 2. 油漆：采用全自动喷漆线先进油漆工艺“五底三面”，底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、环保等指标不低于 E1 级的符合 GB18581-2009 品牌油漆 3. 五金配件：优质一线品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件。	乐晨匠	张	1	1500	1500	8 层

122	活动室 方桌	960*960*750	1. 基材：采用环保多层板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。优质绿色环保产品，实木脚架。 2. 油漆：采用全自动喷漆线先进油漆工艺“五底三面”，底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、环保等指标不低于 E1 级的符合 GB18581-2009 品牌油漆 3. 五金配件：优质一线品牌 32mm 系统可拆装国际标准五金配件。	陕西范玺家具系统工程 有限公司	张	6	880	5280	
123	活动室 椅子	常规	1. 面料：选用优质环保皮，柔软而富有韧性，手感舒适。 2. 内架：优质白桦、松木等多年实木，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率小于 8% 小于所在地区年平均木材平衡含水率，内置蛇形弹簧及弹力绷带。 3. 辅料：采用通过 GB/T10802-2006 技术标准的国优名牌高回弹切割泡棉，开模注压定型，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。	陕西范玺家具系统工程 有限公司	把	16	800	12800	
124	室内垃圾 篓	37CM*25CM	铁	润楷	个	55	12	660	小号

125	形象牌	600*900	233 浅木纹装饰画+高清油画布	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	套	10	250	2500	
126	一四楼制度	600*900	户外背胶+哑膜+kt+小银边	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	18	40	720	
127	评估室	500*300	9毫米PVC粘1.9毫米透明亚克力UV	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	6	62	372	
128	康复中心	4000*1500	户外背胶+哑膜+kt+小银边	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	2	500	1000	
129	二楼玻璃贴	白胶车贴覆哑膜	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实业股份公司	幅	1	420	420	
130		5530*1630	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实业股份公司	幅	1	540	540	

131		5340*1610	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	515	515	
132	四楼玻 璃贴	2000*1540	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	185	185	
133		2100*1700	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	214	214	
134		1520*1540	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	140	140	
135		3730*1690	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	380	380	
136		3760*1540	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	350	350	
137		5460*1540	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	幅	1	505	505	
138	四楼医 疗人员 表盒子	内径 A4	亚克力定做	铜川市兴尚 源建筑工程	个	10	35	350	

				有限公司					
139	医疗人 员简介	A4	高光相纸 300 克	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	张	10	25	250	
140	5-11 楼 服务站 服务台	1050*900	白胶车贴覆哑膜	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	幅	7	65	455	
141	地库导 引牌	600*900	户外背胶+哑膜+kt+小银边	铜川市兴尚 源建筑工程 有限公司	块	2	45	90	
142	电梯腰 线	1400*140*1	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	m	1.4	20	28	
143		2400*140*2	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	m	4.8	20	96	
144		1450*140*6	白胶车贴覆哑膜	上海纳尔实 业股份公司	m	8.7	20	174	

145	电梯按钮	60*30	1.9 毫米透明亚克力 UV+双面胶	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	个	15	10	150	
146	乘梯安全须知	600*900	户外背胶+哑膜+kt+小银边	铜川市兴尚源建筑工程有限公司	块	5	40	200	
小计								811694.00 元	
总 计 (人民币元)			大写：壹佰捌拾叁万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分					¥：1834690.76	

法定代表人或被授权人 (签字或盖章): _____

