

宝鸡市中医医院 医疗器械（设备）采购合同

甲 方： 宝鸡市中医医院

乙 方： 西安瑞健医疗器械有限公司

签订日期： 2026 年 5 月 9 日

甲方（购货方）：宝鸡市中医医院

乙方（供货方）：西安瑞健医疗器械有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》等法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方协商，签订本合同并共同信守下列条款。

一、合同标的

名称	规格型号	注册证号(或 备案凭证号)	生产企业	单 位	数 量	单价	金额
医用血管造影X 射线机	uAngio AVIVA Elite	国械注准 20243060266	上海联影 医疗科技 股份有限 公司	套	1	6789000.00	6789000.00
备注：本价格为含税价。							
合计总金额(人民币/ 元)：		(大写)：陆佰柒拾捌万玖仟元整 (小写)：¥6789000.00					
设备配置清单：（见附件1）。							

注：医疗器械的产品名称、型号、生产企业等，应与注册证中记载的内容相同；乙方保证成交价格不高于市场成交价，否则乙方应承担超出部分。需要性能、精度校核等检定的设备，需由乙方承担检定校准费用，委托有资格的机构进行校核并办理相关手续。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由乙方承担。

二、付款方式

1. 本合同签订后，设备到货安装调试并验收合格，由乙方向甲方开具该设备全额发票，并随发票附合同文件；

2. 甲方在验收完成后办理入库、付款等相关手续，按合同金额一次性付款。

3. 乙方收款银行信息：

账户名称： 西安瑞健医疗器械有限公司

开户银行： 中国民生银行股份有限公司西安土门支行

账 号： 655050734

三、交货及交货条件

1. 交货日期：乙方在合同生效的30天内向甲方交付上述产品，逾期将按照第九条相关规定执行。

2. 交货地点：使用科室（手术室）或甲方指定交货地点。

3. 收货人：王祎 联系电话：0917-3886051 17309178882

4. 乙方承担器械（设备）的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

5. 乙方在货物具备发运条件前，准确通知甲方货物的名称、数量、重量、外形尺寸、发运日期、发运方式等基本情况，以便甲方做好接收准备。

6. 乙方在货物发运后，同时安排人员到现场配合接收货物，甲方配合乙方共同完成货物接收；由于承运部门造成的货物损失，由乙方自行与承运部门协商解决，甲方不承担运输过程中的损失。

7. 乙方向甲方随设备提供全套设备技术资料（设备的出厂检验报告、合格证书、装箱清单、随货通行单等证明器械合法的文件）。

四、包装与标记

1. 乙方提供的全部货物予以坚固包装，并有良好的防潮、防锈、防震和防腐等保护措施，以确保货物安全运抵甲方。乙方应承担由于包装不良而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

2. 每件包装箱内，应附有合格证、质量检验记录及有关技术资料。

3. 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“防潮”“易碎”“小心轻放”“勿倒置”等字样的通用标记。

五、标准和检验

1. 乙方应保证所供器械是全新的、未使用过的，采用厂家原装包装，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求；乙方应提供器械设备的技术条件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，与货物一并移交甲方。

2. 乙方应在货物发运前，对设备的质量、规格、数量进行准确、全面地检验。

3. 甲方在收到货物后，乙方应派遣开箱检验人员，甲方为乙方人员提供便利的工作条件。

4. 开箱检验由甲乙双方代表与货运方共同进行，如发现设备、材料有损坏、丢失，应作详细记录，并由双方代表会签，甲方有权拒绝接收，并要求乙方在限定时间内更换新品。

5. 凡进口医疗设备实行申报检验监管制，设备到院后，乙方需向出入境检验检疫机构按照检验监管内容进行申报并配合现场检验和监督检验，检验合格方可验收，投入临床使用，并提供《入境货物检验检疫证明》。

六、安装调试验收

1. 甲方负责提供场地，乙方负责提供有关技术资料和技术指导。

2. 乙方协调厂家工程师和第三方产品的技术人员对设备进行安装调试。

3. 甲方根据生产厂家提供的出厂标准，或经国家有关部门批准的技术标准、行业标准进行验收；大型器械、贵重器械或精密器械等需双方共同现场验收。

4. 验收时甲乙双方须按照合同文件（或投标文件）内容进行验收，乙方验收过程中须将合同交设备管理部门备案。

5. 验收中如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施进行妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

6. 甲方应在设备安装调试完毕达到验收条件后，15 天内完成设备验收；甲方人员能够独立操作该设备且设备各项指标均符合投标文件响应的技术标准，甲乙双方共同签字验收。

七、培训

设备安装调试后，由乙方安排应用专家对甲方操作人员进行现场操作使用培训和指导，使甲方人员能够熟练操作该设备。

八、售后服务

1. 乙方应保证所供设备是在 2026 年 1 月 1 日后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

2. 质量保证期：器械（设备）的保修期为六年。保修期应从甲乙双方验收合格之日起计算；保修期内，由乙方免费更换零配件及免工时费；乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期；乙方在保修期内定期进行预防性维护保养，次数不少于两次/年。保修期结束前一个月内应安排一次器械（设备）状态检测并出具检测报告，若有故障、隐患存在应在保修期内解决。

3. 乙方负责器械的终身维修，保修期满后应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并以成本价供应维修零配件；设备专用耗材的供应由双方另设协议决定。

4. 乙方在接到需方设备故障通知的24小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，提供备品供用户临床使用，此条款也适用于保修期外。

九、赔偿条款

1. 如经国家相关监督部门检验，确认器械不符合本合同约定或不符合国家或行业标准的，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

1.1 同意甲方退货，并将全额货款退还甲方，同时负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

1.2 根据器械的瑕疵程度、损坏范围和甲方所遭受的损失，对货物进行贬值处理。

1.3 调换有瑕疵的器械，换货必须全新并符合本合同规定和国家或行业标准；乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三个工作日内负责处理，否则视为默认甲方提出的处理意见。

3. 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

4. 乙方应保证甲方和使用单位在使用该器械或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

5. 甲方逾期付款的，应按合同价0.5%/天向乙方偿付逾期付款的违约金；

6. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7. 合同双方如有一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失，则全部损失及责任由违约方承担。

8. 不可抗力：甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全安全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明时，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。

十一、与本合同有关的招投标文件、附件等均为本合同的组成部分，其内容与本合同不一致的，以本合同为准；如需对合同条款进行修改，双方应协商后另行签订书面补充协议。

十二、合同生效与其他

1. 本合同经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式六份，甲方执两份，乙方执四份，具有同等法律效力。

(下无正文)

甲方：宝鸡市中医医院

法定代表人：

授权代表人：



乙方：西安瑞健医疗器械有限公司

法定代表人：刘

授权代表人：刘



签订时间：2026年5月9日

附件 1: 设备配置清单


序号	名称	品牌	注册证号(或备案凭证号)	型号或规格	生产企业	数量
1	血管造影系统	联影	国械注准 20243060266	uAngio AVIVA Elite	上海联影医疗科技股份有限公司	1 套
2	高压注射器	圣诺	粤械注准 20152060124	SinoAngio-12 00	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	1 台
3	除颤仪	飞利浦	国械注准 20183080392	Efficia DFM100	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	1 台
4	有创心电监护仪	飞利浦	国械注准 20173070562	G40E	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	1 台
5	分体式铅衣、铅帽等防护用品	宇龙	鲁烟械备 20230016 号	分体式铅衣: FA06	龙跃医疗器械有限公司	4 套
			鲁烟械备 20230018 号	铅帽: FA08	龙跃医疗器械有限公司	
			鲁烟械备 20230064 号	铅眼镜: FC13-6	龙跃医疗器械有限公司	
6	长壁铅帘	宇龙	鲁烟械备 20230021 号	定制	龙跃医疗器械有限公司	1 个
7	医用手术交换车	毕威泰克	浙嘉械备 20240039	ZY-DJ01	毕威泰克(浙江)医疗器械有限公司	15 套
8	悬吊式手术灯	科曼	粤械注准 20232012130	L3	深圳市科曼医疗设备有限公司	1 台
9	床下防护铅帘	宇龙	鲁烟械备 20230021 号	FH05	龙跃医疗器械有限公司	1 个
10	悬吊式防护铅屏	宇龙	鲁烟械备 20230061 号	FH02	龙跃医疗器械有限公司	1 个



联影业界首款「零噪声」血管造影系统

uAngio AVIVA Elite

产品配置清单

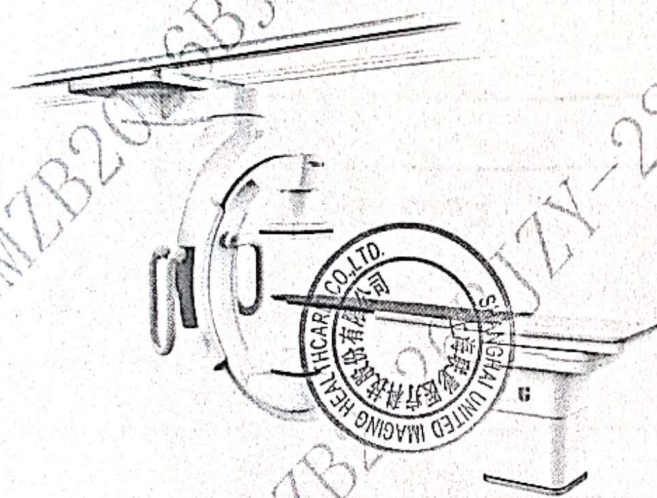

上海联影医疗科技股份有限公司
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

一、主系统配置

序号	描述	数量
1.	机械系统	
	<ul style="list-style-type: none"> 八轴空中机器人 C 臂系统 285cm 行程轨道 机架自动位置控制系统 	一套 一套 一套
2	X 射线发生系统	
	<ul style="list-style-type: none"> 高频逆变精准 kV 控制高压发生器 长效智能栅控 X 射线球管 限束器及遮光器 混合 X 射线滤过器 	一套 一套 一套 一套
3	数字平板探测器	
	<ul style="list-style-type: none"> 非晶硅数字化平板探测器 5G 高速转换接口 定位激光灯 可拆卸高透滤线栅 	一套 一套 一套 一套
4.	导管床	
	<ul style="list-style-type: none"> 高承重检查床 床面旋转模块 床旁可视化系统控制模块 	一套 一套 一套

	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查室急停开关 ● 高 X 射线透过床垫 ● 头托组件 ● 病人臂托 ● 病人身体固定带 ● 杆夹一体化输液架 ● 电缆夹 ● 操作室脚闸 	<p>一个</p> <p>一个</p> <p>一套</p> <p>二个</p> <p>一套</p> <p>一套</p> <p>十个</p> <p>一套</p>
5.	控制室人机交互	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 控制室多功能系统中控台 ● 控制室急停开关 ● 多功能手闸 ● 原站双向对讲通话系统 	<p>一套</p> <p>一个</p> <p>一套</p> <p>一套</p>
6.	图像处理及显示	
	<ul style="list-style-type: none"> ● VeraNF 多帧实时降噪引擎 ● 图像处理系统 ● 5M 影像链 ● uVera IQ 高清低剂量算法平台 ● 检查室 24 吋显示器 ● 四架位显示器吊架 ● 大容量图像存储归档系统 	<p>一套</p> <p>一套</p> <p>一套</p> <p>一套</p> <p>4 块</p> <p>一套</p> <p>一套</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● 控制室 24 吋液晶显示器 	两台
7.	介入工具	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 数字减影功能 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 透视及摄影 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 旋转血管采集功能 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 智能运动补偿二维路图 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 2D 图像浏览与处理 	一套
8.	接口	
	<ul style="list-style-type: none"> ● DICOM Send 	一个
	<ul style="list-style-type: none"> ● DICOM Print 	一个
	<ul style="list-style-type: none"> ● 标准 DICOM 图像输出接口 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● DICOM Query / Retrieve 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 激光打印机输出接口 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 高压注射器联动接口 	一套
9	uVera Dose 全流程剂量管理系统	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 无射线束光器调整系统 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 无射线患者定位系统 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 射线剂量监测及预警系统 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 剂量报告系统 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> ● 大容量透视存储 	一套

	<ul style="list-style-type: none"> 床旁剂量选择 	一套
	<ul style="list-style-type: none"> 超低帧频透视 	一套
10	算力硬件扩展	
	<ul style="list-style-type: none"> 额外 VeraNF 高算力工 	一套



号: ZMZB2026BJZY-28R 投标文件

供项目编号: ZMZB2026BJZY-28R 投标文件

项目编号: ZMZB2026BJZY-28R 投标文件

二、高级临床工具

序号	描述	数量
1.	冠状动脉定量分析功能	一套
2.	左室定量分析功能	一套
3.	冠脉提取增强功能	一套
4.	支架精细显影功能	一套
5.	3D DSA 功能	一套
6.	3D DR 功能	一套
7.	VeraCT 功能	一套
8.	VeraCT 功能扩展包 <ul style="list-style-type: none"> ● VeraCT HD 高分辨率 CT ● 去金属伪影再重建 ● VeraCT Multi 多期 CT ● VeraCT Right 开环 CT ● 多模态影像自动融合引导功能 	一套
9.	多容积融合功能	一套
10.	DSA 踏图功能	一套
11.	实时三维踏图功能	一套

12.	双透视功能	一套
13.	双透视放大功能	一套
14.	双序列同屏同步功能	一套
15.	uChase 下投连续采集功能	一套

