咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：［2025］215号

项目名称：麻醉系统采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西医药控股集团医疗科技有限公司

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西医药控股集团医疗科技有限公司

甲方根据需求委托陕西开源招标有限公司对咸阳市中心医院多功能麻醉机等医疗设备采购项目（采购包1：多功能麻醉机）进行国际招标，项目编号KY2025-I-531确定乙方陕西医药控股集团医疗科技有限公司为中标人。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签定本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	招采名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	麻醉科	多功能麻醉机	麻醉系统	A5C	迈瑞	1	全套质保3年	378000.00	378000.00
合同总价		大写：人民币叁拾柒万捌仟元整，小写：¥378000.00元							

交货期（包含安装、调试）：合同签订后60个日历天内，逾期将按照第六条规定执行。

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用，此外，本项目合同总价不受市场价变化影响。

二、设备运输、安装和验收

2.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

2.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10天内安装调试完成。

2.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《验收合格单》上签字确认。

三、付款方式

3.1付款方式：

合同总价款：人民币叁拾柒万捌仟元整（大写），¥378000.00元（小写）。

货到医院安装、调试完毕、验收合格后，经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方一次性支付合同总价款。

3.2支付方式：银行转账。

3.3结算方式：乙方持验收单，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乙方负责设备的安装、调试及培训工作，培训内容包括日常维作要领和简单故障排除方法，培训结果应有所有应该参加培训的人员签字认可；售后由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，12 小时内维修完毕，若不能在规定时间内修好的免费提供备品（机）备件，特殊情况必须事先告知甲方，进行协商。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为 3 年（原厂质保），涉及全部软件终生免费升级，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（有医院使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内 4 次/年巡检，2 次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在医院医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后服务支持，持续免费升级软件版本，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 如设备故障修复时间≥12h，乙方应及时提供备用机，满足临床需求；如设备故障在 20 个日历日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.4 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.5 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至医院医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.6 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则医院有权拒绝接受。

5.7 为保证设备正常运行，乙方应在陕西区域内方便地点设置备件库，存入所有必须的备件。

5.8 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训，直到科室使用医生能够熟练操作设备为止，可根据科室需求提供人员外出学习培训机会。

5.9 提供设备操作手册及设备操作规范；提供设备非标的电源连接线及其他外接转接口。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，误期赔偿费最高限额为合同总价5%，超过此限额，甲方可直接终止合同）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

以下为空白页面

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2025年9月6日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号 029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2025年9月6日	单位名称	陕西医药控股集团医疗科技有限公司
		地址	陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团大厦东配楼9楼整层 、10楼整层
		纳税人识别号	91610131MA7112TX6D
		电话	/
		传真	/
		户名	陕西医药控股集团医疗科技有限公司
		开户银行1	中国建设银行股份有限公司西安科技二路支行
		帐　号1	6105 0110 7710 0000 0478
		联系人姓名	曹嘉宸
		联系人电话	17612958310
		联系人Email	229184670@QQ.COM

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一、货物说明一览表

货物说明一览表

报价人名称：陕西医药控股集团医疗科技有限公司　　项目编号：KY2025-1-531

采购包：1

项目名称：咸阳市中心医院多功能麻醉机等医疗设备采购项目　　采购包：1

项目编号：KY2025-1-531　　共 1 页，第 1 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	多功能麻醉机（注册证名称：麻醉系统）	迈瑞	A5C	中国深圳	台	1	378000.00	378000.00
…								
N								
投标报价（人民币大写）：叁拾柒万捌仟元整　　（¥378000.00 元）								
备注： 1、表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 2、本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，各子项分别报价。								

投标人全称（公章）：陕西医药控股集团医疗科技有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

设备其他信息：

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
麻醉系统	中国	否	是	否	男

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数文件和装箱清单

A5C 麻醉系统 技术参数

1 配置需求：全能麻醉系统：1 台

2 技术规格：

2.1 工作条件及基本配件

2.1.1 工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

2.1.2 电源：220V-240V，50/60Hz，支持 4 个辅助电源接口

2.1.3 标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持 1 块电池使用时间≥60 分钟，2 块电池使用时间≥180 分钟

2.1.4 标配 4 个辅助电源接口

2.1.5 接口：1 个 LAN 接口支持网络和软件升级，1 个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2 个 USB 接口；可选配基于无线网卡的网路接口

2.1.6 机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缠线绕功能，带工作台侧栏背推车，可选配折叠辅助工作台

2.1.7 显示屏可 360 度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作

2.1.8 适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

2.1.9 非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2.1.10 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2.2 气源

2.2.1 标配氧气、空气和笑气三气源

2.2.2 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25%

2.2.3 快速充氧范围 25 - 75 L/min

2.3 流量计

2.3.1 电子显示流量计，空气范围： 0L/min~15L/min，氧气范围： 0L/min~15L/min，笑气范围： 0L/min~12L/min

2.3.2 电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度

2.3.3 可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.3.4 可选配具备麻药消耗量统计功能

2.3.5 具备辅助吸氧流量计

2.3.6 标配高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围 21~100%

2.4 挥发罐

2.4.1 标配双麻醉罐位

2.4.2 可选配第三个麻醉罐位

2.4.3 标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和麻醉机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非 OEM）产品，挥发罐通过 CE（MDR）认证，具备输入流速和温度补偿

2.4.4 可选配同品牌地氟醚挥发罐，挥发罐和麻醉机同品牌

2.5 呼吸回路

2.5.1 一体化集成回路，具有可观测的吸气/呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关

2.5.2 回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染（包括流量传感器）

2.5.3 二氧化碳吸收罐，容积 1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

2.5.4 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准

2.5.5 可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如 Bain 回路、T 管等，也可不选 ACGO，以防止误操作

2.5.6 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

2.5.7 标配 CO2 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换

2.5.8 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示

2.5.9 呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在 3.0kPa 压力条件下）

2.6 呼吸机

2.6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV（容量控制通气）、PCV（压力控制通气）、和SIMV（同步间歇指令通气）、PS（压力支持通气）模式，PCV-VG（压力控制容量保证通气）

2.6.3 可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重

2.6.4 容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml

2.6.5 吸气压力设置范围：3-80 cmH2O

2.6.6 支持压力：0，3cmH2O~60 cmH2O

2.6.7 呼吸频率：2-100次/分钟

2.6.8 吸呼比：4:1到1:10

2.6.9 压力限制范围：10-100 cmH2O

2.6.10 电子PEEP，显示屏设置，范围：0FF，2-50 cmH2O

2.6.11 吸气暂停：0FF，5%-60%

2.6.12 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

2.6.13 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

2.6.14 具备心肺旁流模式CPB，且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动

2.6.15 可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能

2.6.16 标配喷射通气功能，支持单频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式

2.7 数字和波形监测

2.7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

3.7.2 不小于15英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

2.7.3 支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

2.7.4 电容触摸屏，支持手势操作

2.7.5 内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.7.6 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

2.7.7 配备 AG 带氧麻醉气体模块，可监测麻醉气体，二氧化碳

2.7.8 可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O、EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-F、V-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度、BIS（BIS/Pi 监测

2.7.9 同屏幕≥5 通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容积时间波形，CO2 或麻醉气体浓度波形等）

2.7.10 潮气量监测范围：0-3000ml

2.7.11 分钟通气量监测范围：0-100L/min

2.7.12 可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给予文字和图形提示，具备自动报警限功能

2.7.13 图示化自检，系统自检失败时给予文字和图示提醒可能出错的原因

2.7.14 可存储至少 10000 条事件记录，50 张屏幕截图

2.7.15 可存储患者参数趋势图（表）信息至少 48 小时

2.7.16 可选配麻醉趋势图功能，可显示未来 20 分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势

2.8 麻醉工作站功能

2.8.1 可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上

2.8.2 可扩展连接支持 HL7 协议的设备

A5C 麻醉机配置清单

序号	物料描述	数量（套）	备注
1	A5C 主机	1	
2	15.6英寸彩色触摸屏	1	
3	钠石灰吸收罐	1	
4	风箱保护罩	1	
5	风箱皮囊	1	
6	手动通气皮囊	1	
7	七氟醚挥发罐	1	
8	后备电池	2	
9	皮囊支架	1	
10	呼吸回路	2	
11	呼吸管路	1	
12	AG 带氧麻醉气体模块	1	
13	成人面罩	2	
14	儿童面罩	2	
15	新生儿面罩	1	
16	合格证	1	
17	设备保修卡	1	
18	说明书	1	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三、售后服务承诺

mindray迈瑞

迈瑞产品质量和售后服务承诺

(V6.0)

为了更好地服务于广大深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（简称“迈瑞公司”）的客户，迈瑞公司将提供技术咨询、产品选型、以及整体解决方案，确保产品的质量性能、供货时间、服务保障以及产品的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：

一、 产品质量承诺

1、迈瑞公司对本次招投标所提供的产品符合咸阳市中心医院多功能麻醉机等医疗设备采购项目，采购包1：多功能麻醉机 招标编号：KY2025-1-531 要求的规格型号和技术性能。

2、迈瑞公司保证所供产品是经过出厂检验的合格产品。

3、迈瑞公司承诺对所供产品满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规要求，附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

二、 售后服务承诺

1、保修范围：用户应按照说明书、操作卡使用所购买的产品，在保修期内，机器出现故障，迈瑞公司提供免费维修和配件更换。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户应承担配件成本费和人工费（另行约定），但迈瑞公司会尽快协助排除故障，使系统恢复正常。


- 由于用户不按操作规程操作或者用户人为造成产品损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。
- 由于电网电压在本产品规定的适用范围外引起的故障及严重损坏等。
- 由于不可抗力引起的机器损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、失窃等。
- 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。
- 对产品的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。
- 由于产品与其他仪器连接使用而发生的故障。
- 其它非因产品本身质量问题而发生的故障。

2、服务热线：


迈瑞专设客户交互中心全天候24小时接听服务申告热线及客户投诉，热线号码：400 700 5652，供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题，第一时间响应并全程响应和支持客户的需求。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、迈瑞产品服务请求处理流程图：

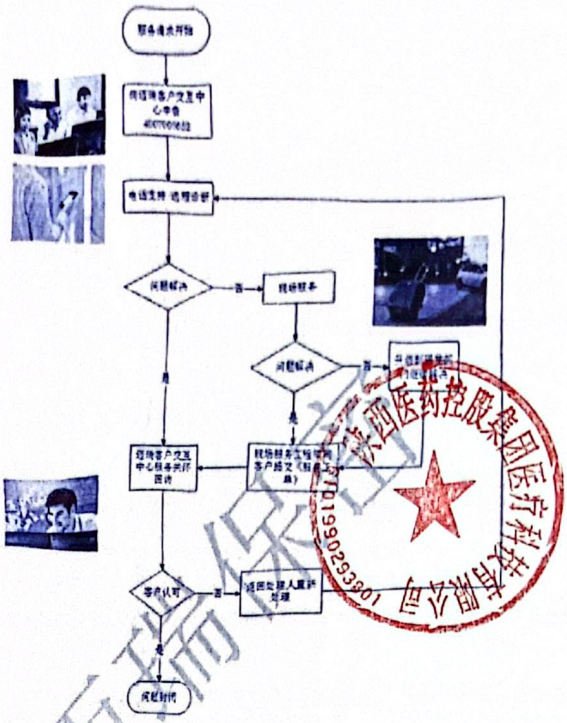

4、服务团队：迈瑞服务人员均经过公司严谨的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。

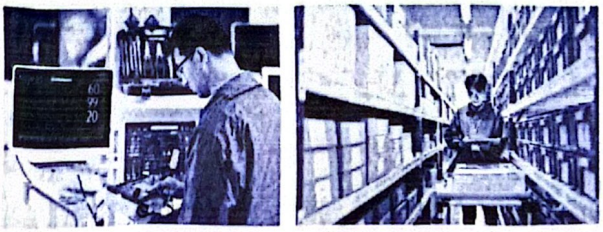

5、敏捷高效的备件中心 迈瑞公司拥有总部、6 个大区物流中心、55 个城市备件中心、37 个驻点地区备件中心和授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，零担、快递、

急送三级物流派送服务，保障产品全生命会周期备件供应及时、充足。

6、收费服务：保修期满后，客户可以与迈瑞签订《保修销售合同》进行续保，或由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。

7、关怀服务：客户交互中心为客户提供技术咨询电话；迈瑞服务人员在保修期内提供公司规定的主动服务，如主动走访，为产品进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级等。

三、 培训计划

迈瑞公司将按与买方的约定对最终用户进行培训。

1、培训方式：

根据客户需求，组织客户进行集中培训或在现场、线上定期或不定期的技术培训。

2、培训内容：

涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。

3、培训资料：

产品的培训资料由迈瑞公司免费提供。

四、 其他事项

1、返厂维修时请您妥善包装，防压、防潮，购买足额运输保险，以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失。

2、不论产品因何种原因发生损坏，请立即停止使用并联系我们维修。

3、本承诺适用于迈瑞公司在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售的全部迈瑞公司产品。

4、迈瑞公司只提供本承诺所包含的服务，不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺内容的承诺负责。

5、迈瑞公司保留对本承诺的最终解释权。

6、迈瑞联系方式：

24小时服务热线	400 700 5652		
迈瑞公司 全球用户服务部地址	广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
全球用户服务部总经理	张亚帅	邮编	518057
服务中心	西安	服务中心邮编	710065
服务中心联系人	齐博深	服务中心联系电话	029-88360649
服务中心联系地址	西安市雁塔区丈八四路18号		

五、 保修及服务响应时间承诺

仅限 咸阳市中心医院多功能麻醉机等医疗设备采购项目，采购包 1：多功能麻醉机 招标编号：KY2025-1-531

1、产品保修期：保修期从产品“安装验收日”起开始计算。

投标产品型号	主机免费保修期（月）
A5C	36
保修期内非仪器故障平均开机率：≥95%，即每年停机不超过 13 个工作日（一年 250 个工作日），超过一天保修期顺延一天。	

2、附件、试剂、超声探头或其他模块保修期：

产品	保修期（月）
附件	/
试剂	/
超声探头或其他模块	/

3、保修期间，对迈瑞公司提供的产品出现的故障，迈瑞公司承诺的服务时间如下：

服务时间	市区内	市区外
响应申告时间	0.5小时内	
上门服务时间	1	2

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

二〇二五年七月二十四日

迈瑞保密

附件四、 中标通知书

陕西开源招标有限公司

中标通知书·采购包 1

陕西医药控股集团医疗科技有限公司：

《咸阳市中心医院多功能麻醉机等医疗设备采购项目》（项目编号：KY2025-1-531），招标工作已结束，根据评标委员会评审结果，经咸阳市中心医院的确认，最终确定贵公司为采购包 1 中标人，中标金额为：叁拾柒万捌仟元整（¥378000.00 元）。

请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

陕西开源招标有限公司

2025 年 8 月 12 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件五

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：

代 表 签 字：

日 期：2018.9.6

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App