

编号：GZC2025-CS-024-02

甘泉中医院关于针灸、脑病临床重点专科治疗设备项目

政 府 采 购 合 同

合同签订地点：甘泉县中医医院

合同签订日期：2025 年 7 月 11 日

政府采购合同书

采购人:甘泉县中医医院

(以下简称甲方)

成交人:陕西聚智药通物流服务有限公司

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定,通过甘泉县政府采购中心组织政府集中采购方式,确定陕西聚智药通物流服务有限公司为甘泉中医院关于针灸、脑病临床重点专科治疗设备项目成交供应商(即乙方)。为了保护甲乙双方合法权益,双方在平等自愿、协商一致的基础上,就该项目订立本合同,供双方共同遵守。

一、合同标的

1.乙方应当根据公告、磋商文件、磋商响应文件、中标(成交)通知书等有关文本要求,并按照甲方需求提供下列货物。

2.自动煎药机、中药汤剂包装机、中医定向透药治疗仪、吞咽功能障碍训练器、生物信息反馈治疗仪、经颅磁刺激仪、木插板、抛接球、体操棒、巴氏球、手指功能组合训练箱、套全板(卧式)、仙人掌跨栏、上肢协调功能训练器(手指)、泡沫轴、花生球 ϕ 56cm、悬吊康复训练系统、肩抬举训练器、肌肉筋膜刀、平衡板、套彩盘、PT凳、系列哑铃(卧式)等(具体参数详见合同附表)。

二、合同总价

人民币:柒拾叁万玖仟伍佰元 (¥739,500.00元)。

1.合同总价包括:货物、运输、装卸、安装、调试等其他一切费用(含税)。

2. 合同总价为固定不变价格，不受市场价格变化等因素影响。

三、供货期限及地点

1. 期限：合同签订后 30 日内。

2. 地点：甲方指点地点（甘泉县境内）。

四、结算方式及付款方式

1. 结算方式：结算工作量以实际发生工作量为准，单价按成交单价执行，最终以验收结果为准。

2. 付款方式：合同签订支付合同总金额的 40%，全部设备到货，安装、调试完毕初验合格后支付合同总金额的 30%，全部设备运行正常终验合格后支付合同总金额的 30%。

五、质保期及服务要求

1. 项目整体质保 1 年。

2. 乙方提供的货物标准不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、磋商文件的要求以及乙方在响应文件的相关承诺。

3. 若因甲方使用不当需要进行维修的，乙方应进行维修，甲方支付相应维修费，若因乙方提供的设备存在质量问题，乙方无条件更换，给甲方造成损失的，乙方承担相应责任及费用。

4. 质保期内，乙方负责上门对其提供的设备进行维护、维修并不得收取任何费用。

六、对货物提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所供的货物名称、品牌、型号、技术参数、数量和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验

收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方所供货物符合合同规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、甲乙双方的责任

1. 甲方提供必要的场地条件，并协助乙方完成设备的装卸、安装调试工作。

2. 甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5% 违约金。

3. 甲方应按照本合同约定，按时足额向乙方支付合同约定金额。

4. 乙方应按照合同约定供货，提供的设备是通过正常渠道获得的，且为全新的、未使用过的原厂合格产品，其有关技术、检验、商务等均要符合有关法律、法规，随货物提供所有相关的使用说明书、质量检验检测报告、保修卡等资料及随附配件工具等。

5. 乙方应当保证其提供的全部设备都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防破损等要求，确保设备安全无损运抵交货地点。

6. 乙方负责货物的运输、安装、调试、验收及交付使用及质保。乙方要提高安全生产意识，加强对员工（含雇用人员）的安全生产管理，上述诸环节发生的安全生产事故和人员伤亡事件，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

7. 乙方应对其所提供的设备承担所有权担保责任，并应保证甲方

在该设备使用中不侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利，否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

8. 乙方不能按时供货的，应向甲方偿付不能供货部分货款的 5% 的违约金；如果乙方没有按照规定的时间完成送货、安装、调试，应向甲方支付违约金，违约金从成交总价中扣除，按每周迟交货或未按时交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算，如果达到最高限额，甲方考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

9. 除不可抗力因素外，任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 30% 违约金。

八、货物验收

1. 验收分初验和终验：

（1）初验：全部设备到达交货地点后，由甲方根据磋商文件、磋商响应文件、合同对货物的名称、品牌、型号、技术参数、数量及质量进行验收。

（2）终验：所有设备安装、调试、培训完毕，正常使用 3 个工作后，由甲方组织其他相关单位及有关专家进行终验（最终验收），合格后签发《甘泉县政府采购项目验收单》。

2. 验收依据

- （1）磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；
- （2）本合同及附件文本；
- （3）国家相应的标准、规范。

九、违约责任及争议解决方式

1. 按《民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求供货或不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3. 因设备问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量及服务内容进行鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

4. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决，如协商不能解决争议的，任何一方可以向项目所地的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

1. 磋商公告、采购需求、答疑内容、补充通知、磋商响应文件、中标（成交）通知书、乙方在磋商活动过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、确认方贰份。
4. 本合同未尽事宜由甲乙双方签订补充合同约定。
5. 后附合同附表。

甲 方：甘泉县中医医院

法定代表人或委托人：

联系电话：



乙 方：陕西聚智药通物流服务有限公司

法定代表人或委托人：

联系电话：15619573443

开户银行：中国农业银行咸阳市秦都区支行营业部

账 号：26406201040014585



确 认 方：甘泉县政府采购中心

法人或委托代理人：

联系电话：



2015年 7 月 11 日

分项报价表（附件）

供应商名称：陕西聚智药通物流服务有限公司


项目编号：GZC2025-CS-024-02

序号	分项名称	制造商名称	制造商规模	品牌/型号	技术参数说明	单位/数量	单价（人民币元）	合价（人民币元）	备注
1	自动煎药机	北京东华原医疗设备有限公司	中型	东 华 原 /YJD20D-GL	功率：2940W，电压：AC220V 容量：20000ml 尺寸：630×620×1220（mm） 符合《煎药机行业标准》《煎药机国家标准》。煎药效果有效成份煎出率达 50%以上，符合中药煎药室管理规范的相关要求。 具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。 可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。 一体拉伸成型不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。 具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。 自动加热调节，文火、武火自动转换。 具有安全卸压阀，双安全阀，超压卸压自动闭合。 有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。 自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。 可配备单体包装机。	台/2	22,000.00	44,000.00	

2	中药汤剂包装机	北京东华原医疗设备有限责任公司	中型	东 华 原 /YB50-250	容量: 20000ML 功率: 1000W+800W 电压: AC220V 尺寸: 570X570X1200 (mm) 重量: 55kg 自动包装, 卫生健康, 保质期长, 易于携带, 服用方便。 包装温度、包装量自动显示。 具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议, 并支持包数、包装量通讯协议的自动设置; 具有喷淋清洗装置, 分为储液桶清洗、喷嘴清洗; 封合温度数字化控制, 可以设定自动恒定。配备 1000W 加热盘。 包装量为 50-250ML, 无极变量可调包装。 适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 包装平均速度 8 袋/分。	台/2		8,600.00	17,200.00	
3	中医定向透药治疗仪	南京鼎世医疗器械有限公司	小型	鼎 世 医 疗 /DS-MF2B 型	1、低频调制频率 0~150Hz; 2、中频脉冲工作频率 4000±10Hz。 3、输出强度 0~99 共 100 级步进可调。 4、定时时间: 设定范围 1~60 分钟, 默认 20 分钟; 5、治疗仪最大输出电流 80mA (r.m.s)。 6、7 寸真彩 TFT 触摸液晶屏, 全中文显示, 全触控操作。 7、实时显示治疗电流和波形。 8、输出波形 载波波形为中频脉冲方波; 输出波形为低频方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波 9、具备按摩、导入、导入按摩三种治疗模式; 10、两路 4 通道输出, 可同时治疗 2 人; 11、拥有 2 项国家发明专利技术 A. 中医定向透药治疗仪功率放大系统(专利: ZL 2012 1 0519951.0)	台/2		28,000.00	56,000.00	苏械注准 201720914 36

				B. 一种离子电渗透经络给药系统”（专利号：ZL 2021 1 0110731.1） 12、机器含有可控反峰脉冲抑制器在单向输出时能够可靠抑制反峰信号，透药电流可以实时跟踪，有利于提高药物投入效率。 13、治疗仪通过半对称中频电流产生的电场，对药物离子产生定向的推动力，使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速的进入人体。 14、治疗处方中文显示，20 组专家治疗处方。 15、治疗仪的输入功率：80VA 16、安全类型：II 类 BF 型 17、按运行模式分类：连续运行。					
4	吞咽功能障碍训练器	苏州好博医疗器械股份有限公司	中型	好博医疗/HB62BE	1、双通道便携机型，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成，含 2 个触发器、2 根四芯电极线、4 根两导电极，适配不同治疗模式。 2、仪器配置电极：内置电极放置和粘贴示意图，同时配有蝶形电极片（治疗、评估用）、矩形电极片（训练用）、月牙形电极片（小脑顶核电刺激用）； 3、彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭定位操作。 4、评估功能：采用三角波和方波，脉冲宽度为 1000ms、500ms；输出电流 0 - 25mA；脉冲间隔 5s；脉冲频率方面，脉冲宽度 1000ms 时为 0.167Hz，500ms 时为 0.182Hz，适配不同程度吞咽及构音障碍评估。 5、治疗功能：同时具备评估、治疗及训练功能；辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出，四种基本频率为 23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz；辅极脉宽 500 μs±15%。 6、报警功能：电极脱落及插错报警功能。 7、输出电参数： a) 输出电流：0~25mA，分 50 档连续可调，精度±20% b) 主电极开路输出电压：150V 以内	台/1	45,000.00	45,000.00	苏械注准 20172090252

				8、5种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式。 8.1、成人连续模式 输出电流：0~80mA，分160档连续可调； 脉冲宽度：1-31档可调，100 μs~400 μs 可调，脉冲间隔：100 μs 脉冲频率：20Hz~100Hz 可调，步距增量 1Hz 8.2、儿童交替模式 输出电流：0~80mA，分160档连续可调； 脉冲宽度：1-31档可调，100 μs~400 μs 可调，脉冲间隔：100 μs 脉冲频率：20Hz~100Hz 可调，步距增量 1Hz 持续时间：1s 8.3、手持触发模式脉冲宽度：10ms~1000ms，分50档可调 8.4、自动触发模式脉冲宽度：10ms~1000ms，分50档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s 9、时间选择：1~99分钟可调，步距增量为1分，误差±5%。 10、设备可连续工作8h。					
5	生物信息反馈治疗仪	苏州好博医疗器械股份有限公司	中型	好博医疗/HB-ME2	1. 设备治疗和评估通道数量4个。 2. 包括电刺激、反馈刺激、镜像刺激、模板训练、多媒体场景动画生物反馈训练等多种方式。 3. 4通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。 4. 独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。 5. 设备具有73个治疗方案，包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。 6. 评估位置54个，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。 7. 具有快速肌电评估功能，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰。	台/1	94,000.00	94,000.00	苏械注准20212091335

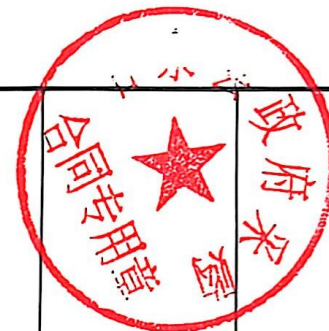

				#2.3 最大刺激频率: 150Hz, 0Hz~150Hz 可调。(佐证材料见第5.3.6 章节经颅磁刺激仪(锐诗得/RSD K11A), 第三方检测报告第2 页, 第3 条-输出频率)。 #2.4 刺激频率调节: 脉冲频率在 1Hz 以下时调节步长为 0.01Hz, 超过 1Hz 时步长为 1Hz。 2.5 磁感应强度最大变化率: 10kT/s-80kT/s。 2.6 脉冲上升时间: 35~65 μs。 2.7 输出频率允差值: $\pm 3\%$ 2.8 单个脉冲持续时间: 340 μs$\pm$20 μs。 2.9 在工作条件下, 系统以 1Hz, 100%强度进行刺激, 可以连续 24h 工作。 2.10 使用磁场力线控制技术分为靶肌聚焦区及非靶肌刺激区, 刺激线圈磁场分布均匀。 2.11 线圈类型: 标配圆型及八字形线圈, 能实现双面双向刺激。 2.12 可拓展儿童、深部双锥及盆底磁线圈, 拓展临床应用场景。 2.13 提供触发脉冲刺激输入输出接口, 可用于连接其他设备。 #2.14 高压储能电容放电次数超 100,000,000 次, 当电容放电次数达到上限时提供电容维护。 2.15 配备随动悬停调节系统, 通过扭臂抵消线圈重力, 剩余预紧力防止脑袋向下移动时离开磁拍, 360 度空间活动度, 确保治疗过程中靶点不偏移, 保证治疗效果。 3. 运动诱发电位监测 (MEP) 模块 3.1 MEP 通道数: 2 通道。 3.2 传输方式: 有线传输。 3.3 运动诱发电位测量灵敏度范围: 1~3000 μV, 最小分辨率 0.2 μV, 检查频率范围: 20Hz~550Hz。 3.4 配置原厂双通道运动诱发电位检测模块, 集成于主机内部, 检测模块与主机之间无需有线或无线通讯, 数据传输稳定性强。		
--	--	--	--	--	--	--

				3.5 可捕捉肌电信号（EMG），并自动计算得到潜伏期和峰值。 3.6 点击 MEP 触发按钮可以触发一次或连续多次脉冲刺激、满足运动阈值测试需求。 3.7 治疗时可进行生理安全监测，实时监测运动诱发电位波形，当出现痉挛信号时会播放警告声音进行癫痫预警安全提示。 4. 冷却系统和保护系统 4.1 冷却系统：采用液态循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行。 4.2 可在高散热需求场景下，启动风冷液冷一体化散热模式，保证设备高性能运行，满足临床长时间治疗需求。 4.3 安全工作温度预警功能，当刺激线圈温度超过 40℃，磁刺激仪自动停止刺激输出，保证安全使用。 4.4 当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。 4.5 可以实时显示冷却液温度。 4.6 惰性冷却液：冷却液直流电阻率为 10MΩ·cm。 4.7 变频风冷：主机散热风扇的转速可改变。 4.8 磁感应线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，停止磁场输出并有视觉或听觉提示。 5、软件参数 5.1 人机交互管理软件，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，不受记录次数限制，直接启动刺激。 5.2 内置 MEP 模式、标准模式、TBS 模式，可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS 爆发序列刺激，并且提供多种临床治疗方案供医生选择，且所有内置方案参数可查看及编辑。 #5.3 具有一键快速启动历史方案功能，可在治疗记录界面一键快速启动历史治疗方案。 5.4 刺激方案具有患者体位示意图或人体大脑解剖定位图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。			
--	--	--	--	--	--	--	--



					5.5 可进行刺激参数的设置, 包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、间歇时间及工作时间等。 5.6 刺激强度从运动阈值(MT)的 0-250%可调, 使病人能更快的适应治疗。 5.7 刺激开始及结束有语音提醒, 便于医生和病人做好刺激准备, 缓解病人紧张情绪。 #5.8rTMS 与 TBS 治疗模式下, 单次治疗方案可设置 5 种不同的刺激频率 6. 其他要求 6.1 上位机软件通过 GB/T25000.51 软件产品质量要求与评价。 6.2 整机通过 YY/T0994-2015《磁刺激设备》规定行业标准。 6.3 整机符合 GB9706.1-2020《医用电气设备第 1 部分: 基本安全和基本性能通用要求》的规定。 6.4 符合 YY9706.102-2021《医用电气设备第 1-2 部分: 安全通过要求并列标准: 电磁兼容要求和试验》的规定。				
7	木插板	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-MCB-3	说明: 作业治疗用具, 将木棒准确插到位。 36×29×10cm, 规格直径 2.5×10cm, 数量 20 个 22×18×9cm, 规格直径 1.8×0.9cm, 数量 20 个 18×14×8cm, 规格直径 1.3×0.8cm, 数量 20 个	台/1	630.00	630.00	
8	抛接球, 体操棒	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-TCB-1	规格(cm): 40×40×102 质量: 14.0Kg 结构型式: 体操棒、抛接球、木架 材质: 木制 体操棒规格(cm): $\Phi 3 \times 100$ 体操棒数量: 5 个 抛接球直径(cm): 25 抛接球数量: 3 个 操棒侧向可承受最大荷载(n): 100	套/1	780.00	780.00	



					用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。				
9	巴氏球	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-BSQL	大：规格(cm)：Φ85cm左右，质量：2.1kg左右； 中：规格(cm)：Φ75左右，质量：2.0kg左右；材质：加厚防爆。 小：规格(cm)：Φ65左右，质量：1.8kg左右；材质：加厚防爆。 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛，提高儿童协调性。	台/1	1,280.00	1,280.00	
10	手指功能 组合训练 箱	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-ZGN	一、产品组成 主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁等 10 种训练用具组成。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高)：55×40×14 cm 2) 木插棍外形尺寸及数量：(大：Φ26mm，3根)、(中：Φ18mm，4根)、(小：Φ13mm，5根) 3) 玻璃球数量：大(4个)、中(5个)、小(5个) 4) 铁插棍外形尺寸及数量：(大：Φ8mm×60mm)、(中：Φ6mm×60mm)、(小：Φ4mm×60mm)，各 15 个 5) 螺栓外形尺寸及数量：M8×40(5只)、M6×40(3只) 6) 螺母外形尺寸及数量：M8(12只)、M6(6只)	台/1	1,200.00	1,200.00	
11	套 圈 板 (卧式)	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-TQB-1	材质：木质。由 9 根立柱 9 个套圈组成，底板有数字显示。尺寸：42×43×19cm，立竿直径 2.5cm 训练患者眼-手协调功能	台/1	460.00	460.00	
12	仙人掌跨 栏	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-XCZ-2	规格：88cm(长)×41cm(宽) 结构组成：每套含 3 组跨栏单元，支持独立或组合使用，满足不同场地与训练需求。 调节档位：3 档高度可调。	套/2	860.00	1,720.00	

13	上肢协调功能训练器(手指)	苏州博创医疗器械有限公司	小型	博创医疗/BC-SZX-3	规格(cm): 30×25×33 质量: 1.5kg 材料: 木质、钢丝 式: 曲线架、木珠、器架底板 用途: 训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力	台/1	780.00	780.00	
14	泡沫轴	苏州博创医疗器械有限公司	小型	博创医疗/BC-FMZ	尺寸: 45cm(长)×14cm(直径) 材质: 高密度 EVA 软硬度: 60 Shore A 密度: 220kg/m³ 按摩压力面: 1.22cm² - 5cm² 承重: 500KG(实心内管, 重压回弹不易变形)	根/2	220.00	440.00	
15	花生球 φ56cm	苏州博创医疗器械有限公司	小型	博创医疗/BC-HSQ	1. 规格(cm): φ56; 2. 重量: 1.3kg; 3. 用途: 提高儿童协调性; 4. 适用于平衡力欠佳儿童;	台/1	880.00	880.00	
16	悬吊康复训练系统	苏州好博医疗器械股份有限公司	中型	好博医疗/SET130A	1、悬吊系统安装方便, 场地要求低, 参考规格尺寸(L×W×H): 2900mm*2100mm*2400mm 2、悬吊系统为落地支架式, 每个悬吊器支持前后位移, 悬吊点分布合理, 悬吊点分布合理, 每个悬吊器设4个悬吊点, 结合悬吊架上2个悬吊点, 共计14个悬吊点。 3、每个悬吊器自带2条悬吊绳, 长3.2M, 支持上下拉伸并自固定, 一组悬吊绳最大承重270KG; 自带一条移控绳。 4、标配悬吊弹力绳: 300mm, 10条, 450mm, 4条, 最大承重30KG; 5、标配0.3米和0.45米自锁式组合弹力双绳, 共8条; 6、标配自锁式无弹力绳: 长300mm, 4条和600mm, 2条, 最大承重150KG 7、标配1个头颈悬带(中分带), 尺寸670*80*3mm, 用于头颈部的固定与手法治疗;	台/1	127,500.00	127,500.00	

					8、标配 1 个胸背悬带，尺寸 900*646*6mm，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑 9、标配 4 个腕带（握具），尺寸 330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕； 10、标配 4 个窄悬带，尺寸 860*130*8mm，用于四肢关节的托持固定 11、标配 1 个宽悬带，尺寸 850*240*8mm，用于上肢躯干的托持固定 12、标配 2 个圆形充气平衡垫，1 个充气筒，用于平衡能力训练 13、1 个三段位电动手法按摩床，支持高度调节 500-940mm，上下肢段位支持电动调节角度，最大承重 250KG。				
17	肩抬举训练器	苏州博创医疗器械有限公司	小型	博创医疗/BC-JTJ	50×48×73cm，可调坡度 20° ~85°。棒置间距 15cm，棍 ϕ3×92cm。 用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力 结构型式：支架、木棒、角度调节螺栓、角度盘 木棒尺寸 cm：ϕ3×92 规格 (cm)：架 65×45×76 可调坡度：20° ~85° 棒置间距 15cm	台/1	580.00	580.00	
18	肌肉筋膜刀	苏州博创医疗器械有限公司	小型	博创医疗/BT-JTDN	一套 6 件，包含一型定点刀、大 S 型钩子刀、C 型钩子刀、小 S 型钩子刀、D 型钩子刀、大 M 型刀。 材质：316 不锈钢 具备良好的耐腐蚀性、韧性与强度，保证工具耐用性及使用安全性	套/1	860.00	860.00	
19	平衡板	苏州博创医疗器械有限公司	小型	博创医疗/BC-PHB-1	材质：木制品 参考规格 (cm)：90×70×9 面板摆动角度：-13° ~+13°	台/2	340.00	680.00	

					最大承载质量为 135kg 参考质量: 9.0kg				
20	套彩盘	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-TCP	规格: 60×16×63cm 立柱直径: ϕ 2.8cm 用途: 训练患者手眼协调功能, 增加感知认识 配三角木块、正方形木块、圆板木块各 1 个	台/2	580.00	1,160.00	
21	PT 凳	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-PTD-2	结构型式: 主架、凳面; 材质: 座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合; 外形尺寸: 58×58×37~57cm; 带液压油缸, 360° 旋转; 额定承载: 2000N; 产品用途: 康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 特点和功能: 1、凳面高度可调, 方便康复师使用。 2、凳体底部设计有万向滑轮, 可以自由移动, 凳面可以 360° 旋转。	台/4	280.00	1,120.00	
22	系列哑铃 (卧式)	苏州博创 医疗器械 有限公司	小型	博 创 医 疗 /BC-YLI	用于肌耐力和医疗体操训练 1、参考规格 (cm): 120×80×60 2、参考质量: 37.0kg 3、结构型式: 哑铃、哑铃架 4、材质: 静电喷塑架、钢 5、哑铃规格: 质量, 5LB, 4 个。4LB, 4 个。3LB, 4 个。2LB, 4 个。1LB, 2 个	台/1	1,080.00	1,080.00	
总 计 (人民币元) 柒拾叁万玖仟伍佰元整					¥: 739,500.00				