

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-0623-001

安康市中心医院腹腔镜系统等设备采购项目

招 标 文 件

包 1：腹腔镜系统

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年四月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	8
(一) 投标人须知前附表	8
(二) 投标人须知	12
一、总则	12
1.采购人、采购代理机构及投标人	12
2.资金来源	13
3.投标费用	13
4.适用法律	13
二、招标文件	13
5.招标文件构成	13
6.招标文件的澄清与修改	14
7.投标截止时间的顺延	14
三、投标文件的编制	14
8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	14
9.投标文件组成	15
10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	15
11.投标报价	15
12.投标保证金	15
13.投标有效期	16
14.投标文件的制作	16
四、投标文件的递交	17
15.投标文件的加密	17
16.投标截止	17
17.投标文件的接收、修改与撤回	17
五、开标及评标	17

18.开标	17
19.资格审查及组建评标委员会	18
20.投标文件符合性审查与澄清	18
21.投标偏离	19
22.投标无效	20
23.比较与评价	20
24.废标	21
25.保密要求	21
六、确定中标	21
26.中标候选人的确定原则及标准	21
27.确定中标候选人和中标人	21
28.发出中标通知书	21
29.告知招标结果	22
30.签订合同	22
31.履约保证金	22
32.预付款	22
33.招标代理服务费	23
34.政府采购信用担保	23
35.廉洁自律规定	28
36.人员回避	28
37.质疑的提出与接收	28
附件 1：投标担保函	30
附件 2：履约担保函格式	32
第三章 评标方法和标准	34
第四章 拟签订的合同文本	45
第五章 采购需求及要求	54
第六章 投标文件格式	69
一、资格证明文件	72

第一部分 身份证明文件	71
第二部分 资格证明文件	75
二、商务及技术文件	79
投标函	79
开标一览表	80
投标分项报价表	46
技术偏离表	83
商务条款偏离表	84
中小企业声明函（货物）	85
投标人监狱企业声明函	86
残疾人福利性单位声明函	87
投标人参加政府采购活动承诺书	87
符合评分标准要求的商务文件	90
投标人须知第 10 条要求的所有技术文件	91
投标方案或技术方案	92
业绩一览表	93
投标人须知前附表要求的其他文件	94

第一章 招标公告

安康市中心医院腹腔镜系统等设备采购项目招标公告

项目概况

腹腔镜系统等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】获取招标文件，并于2025年05月16日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-0623-001

项目名称：腹腔镜系统等设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：17,600,000.00 元

采购需求：

合同包1（腹腔镜系统）

合同包预算金额：12,600,000.00 元

合同包最高限价：12,600,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	医用内窥镜	腹腔镜系统	4（套）	详见采购文件	12,600,000.00	12,600,000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，收到采购人书面供货通知函后的30个工作日内完成所有的供货。

合同包2（腔内混合动力碎石机）

合同包预算金额：2,000,000.00 元

合同包最高限价：2,000,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
-----	------	------	------------	------------	-------------	-------------

2-1	其他医疗设备	腔内混合动力碎石机	1（台）	详见采购文件	2,000,000.00	2,000,000.00
-----	--------	-----------	------	--------	--------------	--------------

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，收到采购人书面供货通知函后的 30 个工作日内完成所有的供货。

合同包 3（电子鼻咽喉内窥镜系统）

合同包预算金额：3,000,000.00 元

合同包最高限价：3,000,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
3-1	医用内窥镜	电子鼻咽喉内窥镜系统	1（套）	详见采购文件	3,000,000.00	3,000,000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后，收到采购人书面供货通知函后的 30 个工作日内完成所有的供货。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（腹腔镜系统）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目；

合同包 2（腔内混合动力碎石机）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目；

合同包 3（电子鼻咽喉内窥镜系统）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1（腹腔镜系统）特定资格要求如下：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投

标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的供应商均无资格参加投标。

合同包2(腔内混合动力碎石机)特定资格要求如下：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属

于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的供应商均无资格参加投标。

合同包3(电子鼻咽喉内窥镜系统)特定资格要求如下：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的供应商均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 15 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 05 月 16 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）

开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、招标文件获取须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。网上投标确认后在线下载招标文件，未在文件获取时间内从电子交易平台下载招标文件的，无法完成后续流程。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击安康市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）V1.0、安康市

公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程），请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；

4、请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

5、腹腔镜系统、腔内混合动力碎石机、电子鼻咽喉内窥镜系统允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：安康市中心医院

地址：安康市汉滨区金州南路 85 号

联系方式：0915-3284099

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路 2 号山西证券大厦八楼

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：张锐 雷鹏

电 话：029-88497916

陕西省采购招标有限责任公司

2025 年 04 月 08 日

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：安康市中心医院 地 址：安康市汉滨区金州南路 85 号 电 话：0915-3284099
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路 2 号山西证券大厦八楼 联系人：张锐 雷鹏 电话：029-88497916
1.3.3	合格投标人的特定资格条件： 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书； 3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

	3.5、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的供应商均无资格参加投标。
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>是</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求： <u>/</u>
1.7	项目所属行业： <u>工业</u>
2.2	项目预算金额：<u>17,600,000.00</u> 元。其中合同包 1(腹腔镜系统)12,600,000.00 元。 最高限价：<u>17,600,000.00</u> 元。其中合同包 1（腹腔镜系统）12,600,000.00 元。
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>3</u> 包
12.1	本项目不收取投标保证金
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起 <u>90</u> 个日历日
14.1	投标文件电子文档壹份（交易平台上传）
16.1	投标截止时间： <u>2025 年 05 月 16 日 14 时 00 分 00 秒</u> （北京时间）
18.1	开标时间：<u>2025 年 05 月 16 日 14 时 00 分 00 秒</u>（北京时间） 开标地点：<u>安康不见面开标大厅系统</u>
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.5	本项目核心产品： <u>合同包 1 为腹腔镜系统。</u>
23.2	评标方法： <u>适用适用综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u>

31.1	是否提交履约保证金： <u>否</u>
32.1	预付款比例为：30%
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法按标准按标段收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014
38	不见面开标注意事项及流程： 须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击安康市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）V1.0、安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程），请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000； 2、不见面开标流程相关注意事项如下： 2.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见

	面”开标系统。登录方式有以下几种： 1) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择安康市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器。 2.2 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内）； 2.3 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同； 注：在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 2.4 评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束。
--	--

(二) 投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9. 投标文件组成**
- 9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。
- 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件**
- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。
- 11. 投标报价**
- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。
- 12. 投标保证金**
- 12.1 本项目不收取投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 电子投标注意事项：

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

招标投标人在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子化平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

14.2 投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的加密

- 15.1 投标人应按照国家公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前按要求重新提交，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、加密。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
- 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。
- 投标人不足 3 家的，不予开标。
- 18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投

- 标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。
- 24. 废标**
- 出现下列情形之一，将导致项目废标：
- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
 - （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - （4）因重大变故，采购任务取消的。
- 25. 保密要求**
- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

- （1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。
- （2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等

原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

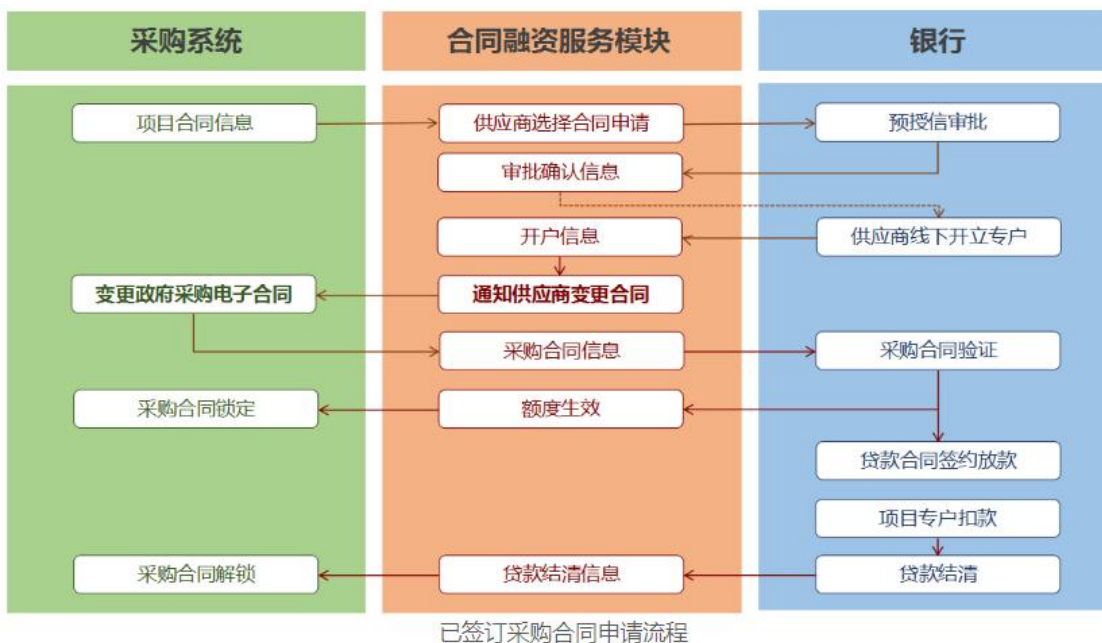

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E 政通）

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166
 西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘 冲 17702902131
 西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151
 西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651

西安经开区支行	西安市未央路 125 号	惠 媛	17792256100
西安南大街支行	西安市南大街 15 号	乔 鉴	18089136919
西安和平路支行	西安市和平路 101 号	陈 歆	18691816821
西安兴庆路支行	西安市兴庆路 61 号	李 妍	13892880386
西安新城支行	西安市南新街 29 号	朱子君	18629286269
西安长安区支行	西安市长安区青年街 2 号	王淑芸	13572289603
咸阳分行	咸阳市西兰路 4 号	邵 洋	13299079906
宝鸡分行	宝鸡市红旗路 36 号	李 倩	18629019817
铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636
榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275
延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557
汉中分行	汉中市石灰巷 21 号	王晨旭	15319375850
安康分行	安康市育才路 102 号	张少帅	13165762680
商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭 杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	刘晓伟	总经理助理	029-61828763 18066630518
西安高新开发区支行	梁凡	行长助理	029-61828531 18681945597
西安曲江文创支行	蒋超	室经理	029-65667366 15891737329
西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272 13991990373
西安长缨路支行	范凯	副行长	029-68717760 13991315609
长安区西长安街支行	陈明	行长助理	029-85724301 18149209660
泾渭工业园支行	杨奕	室经理	029-68213773 15934802021
北客站科技支行	周洁	副行长	029-61828129 18629518636
解放路支行	王莉	行长助理	029-61828185 15802966196
延安分行	奥宝森	室经理	0911-8076038 15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827 15353386777
宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282 18991749262
安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275 15667856663
铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878 17392898832
延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826 15291142933
汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773 18591607453
渭南分行	张欢	客户经理	09132095066 15229730006
咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370 18591006506
商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908 18691410305
商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908 18092802280
西安分行	巩越	客户经理	029-87609419 18629450680

四、中信银行（政采 e 贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段 1 号	曹晓聪 13759957407 魏敏 18681897602
咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群 13992016859
宝鸡分行	宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座	王尧 13636762976
渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳 18191815559
榆林分行	榆林市高新区长兴路 248 号中信银行	刘洪巍 13636885556
汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B 号	

楼 陈真 18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163
榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126
延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500
咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088
营销一部	李 敏	8723631113772031109	
营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078
营业部	张翔琮	87236306	18829235568
电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787
明德门支行	王 晨	85350770	13991249430
东大街支行	刘 林	87438914	15029673754
经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397
凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622
兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819
长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201
友谊路支行	负程敏	88422067	18792795210
边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048
北关支行	菅新培	86248203	18092169361
南郊支行	程 拓	85265234	13772491661
西关正街	马 瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185
雁塔路支行	闫梓阅	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983
南二环支行	刘 超	88362861	18192080396
曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行（政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586
宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816
宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926	13909176381
渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行 薛晗 公司业务部 029-32083788 15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行（政采贷）

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	建设银行	郭煜庆 田宇	13892535580 17797059890
2	浦发银行	孙哲龙 蒙波	13892383911 15249035320
3	中信银行	杨洋 耿浩	18191815559 13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张剑 张欢	18191356300 15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	张萱	13028431555 18091365182

延安市政府采购贷款银行信息：

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	徐欣蕾	15891686951
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222
4	邮储银行延安分行	宝塔区枣园路志丹大厦	刘凯	18691114222

序号	银行	地址	联系人	电话
5	光大银行延安分行	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500
6	交通银行延安分行	延安市宝塔区北大街 95 号	王瑶	13389119518
7	延安农商行	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦	段田瑞	18700166012
8	甘泉农商行	甘泉县中心街 019 号	白晶晶	15129872940
9	延长联社	延长县七里村镇街道城区中街	白永卿	18109119635
10	延川联社	延川县大禹街道北关信用合作联社	张沛兴	15129756920
11	子长农商行	子长市长兴街	王莉	13992153010
12	安塞农商行	延安市安塞区富民街 22 号	王平	15991569027
13	志丹联社	延安市志丹县保安街 134 号信合大厦	李倩	18792408171
14	吴起农合行	陕西省延安市吴起县北苑东路 26 号	李娜玲	15591103321
15	洛川农商行	陕西省延安市洛川县中心街	史云云	15291172848
16	富县农合行	富县富城镇正街 8 号	逯其玲	18091126065
17	黄陵联社	黄陵县桥山大厦	曹涛	13772255164
18	宜川联社	宜川县党湾街 65 号	毛永良	15009118628
19	黄龙联社	黄龙县石堡镇广场大街 40 号	郑国强	15991595662

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根

据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

- 37.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

- 37.3 投标人提交质疑函的要求

- 37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

- 37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号：

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）：

鉴于____（下称被保证人）将于____年__月__日参加贵方招标编号为____（采购项目编号）的____（项目名称）的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）____元（小写）____元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_____

单位地址：_____

电话：_____

日期：____年__月__日

附件2：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

时间：_____年_____月_____日

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人产品投标报价超出最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，或出现投标内容不满足招标文件的商务要求、技术中实质性要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

1.5 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价

格进行任何调整。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、本项目为使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

本项目采用综合评分法,则:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； (2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； (3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； (4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； (5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； (6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2	财务状况报告：提供(1)或提供(2)	(1) 提供 2023 年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 (2) 提供资信证明原件或复印件，应满足以下	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		要求: ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3	依法缴纳税收的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （4）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	
7	信用信息	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 (以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)。	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
10	已按要求从交易平台获取招标文件	需按要求从交易平台获取招标文件，未按要求获取招标文件的供应商均无资格参加投标。	
11	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明	(1) 法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； (2) 授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
12	特定资格要求	1、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)，并出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证; 2、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书。	
13	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注:

1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见, 符合的标记为“√”, 不符合的标记为“×”;
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”, 出现一个“×”为“不通过”, 不进入后续评审;
3. 对审查结论为“不通过”的, 要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件 签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求	
3	投标报价	投标人产品投标报价没有超出最高限价	
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务要求、技术中实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；

- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审标准

(适用于包 1)

评标因素	权值%	评价要素
价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分
节能、环境标志产品	2	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得 1 分，满分 2 分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
投标产品技术指标评审内容	36	评标委员会将根据投标文件中对技术部分的应答、测试报告，并结合投标人提供的技术资料 and 原厂技术文件等，对技术部分进行综合评价。完全响应或优于得 36 分。“▲”号重要技术指标参数一项不满足扣 3 分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣 1.5 分，扣完为止（提供证明资料，未提供不得分。请在技术偏离表“说明”栏中标明页码）。
投标产品的可靠性评审	5	所投产品技术先进、可靠性强、成熟度高，完全满足用户需求，得 5 分； 所投产品技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得 3 分； 所投产品技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得 1 分。
供货能力、履约能力等	5	由评标委员会横向比较，综合评审： 所响应的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，根据响应情况得 5 分； 所响应方案较完整，可基本实现及满足供货、履约要求，根据响应情况得 3 分； 所响应方案有明显缺陷，针对性较差，不能完全满足供货、履约要求，根据响应情况得 1 分； 未提供方案不得分。

项目整体 实施方案	6	根据投标人响应产品的技术方案和组织实施方案等内容进行综合评审：（根据医院现状，设计合理的安装、调试进度计划及措施方案。包括但不限于：安装调试进度计划及措施方案、质量保证措施、安全保障措施等）。 方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，能够确保医院使用，得 6 分； 方案较完整，可基本实现及满足采购要求，得 4 分； 方案有明显缺陷，针对性较差，得 2 分； 未提供方案不得分。
售后服务	12	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包括： 1、售后服务范围及保障措施：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分；内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。 2、培训方案：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分；内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分；内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺：内容完整、可实施、且有针对性得 3 分；内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。
产品业绩	4	提供 2022 年 1 月至今（以合同签订时间为准）所投核心产品（同品牌同型号）对用户的销售业绩，每提供一份有效合同得 2 分，最高得 4 分。
总分	100 分	

说明：1.同一指标不得重复打分。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

第四章 拟签订的合同文本

合同编号：_____

甲方（采购方）：安康市中心医院

乙方（供货方）：_____

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及采购文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订安康市中心医院腹腔镜系统等设备采购项目（项目编号：SCZD2025-ZB-0623-001）包1供应合同。

第一条 合同标的

序号	货物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	质保年限	单价（元）	金额（元）
人民币合计金额（大写）：						（小写）		
说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。								

第二条 质量保证

2.1 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。

2.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 知识产权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1 乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的

原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2 运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1 交货时间：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的 30 个工作日内完成所有的供货；在具备安装条件之后，于 _____ 个工作日内完成所有设备的安装、调试工作。

5.2 指定履约人员：甲方指定 _____ 为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 _____ 代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.3 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件(人员、设备、设施)，乙方负责承担。

5.4 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.4.1 所有系统设备、材料到达安装调试现场 2 个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的设备进行初步验收。系统设备、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.4.2 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、医疗器械注册证、卫生许可证等质量证明文件。进口产品还须提供商检及报关证明材料，生产厂家提供针对本项目的产品售后服务承诺书。

5.4.3 安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲

方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

5.5 技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及临床应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作；同时，乙方须于___内安排甲方指定人员_____人次在_____等地三级甲等医院或_____医院进行技术操作、维修维护学习，每人学习次数不少于_____, 并承担培训所有费用。

第六条 货款结算

6.1 本合同以人民币付款。

合同总价款：_____元，大写_____；本合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2 结算方式：银行承兑汇票或电汇。

6.3 付款条件与具体的付款金额：

6.3.1 合同签订完成后乙方凭预付款等额银行保函、正式合同、预付款项财务收据到甲方办理预付款业务，一个月内甲方支付给乙方合同总价 30%的预付款。

6.3.2 剩余未付款项待设备全部到货后，乙方凭付款收据到甲方办理付款业务，一个月内甲方支付给乙方合同总价的 20%。

6.3.3 待设备全部安装、调试完成，验收合格后，乙方凭正式发票、验收报告到甲方办理付款业务，一个月内支付给乙方合同总价的 40%。

6.3.4 无遗留问题，剩余 10%未付款项一年内付清。

第七条 售后服务

7.1 乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务，整机（含所有附件及配套设备）免费保修期 ≥ 3 年（提供厂家质保承诺函），自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

7.2 质保期内，乙方将定期（ $\geq$ ___次/年）派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3 乙方或其厂商省内应设置有售后服务机构，拥有成熟的售后技术团队，提供 7*24 全天候 800 或 400 技术支持，电话响应 $\leq 4h$ ，上门服务 $\leq 12h$ ，故障短时间无法解决时，提供备用机。

7.4 质保期内，如出现__次（含）以上非人为因素引起的故障或开机率<95%，影响甲方使用，乙方负责在 10 个工作日内免费更换相同新设备。

7.5 如因设备质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1 甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2 乙方逾期未完成约定义务超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3 乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过2次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1 甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付 15 日后按迟延支付金额的 1‰（日）的标准向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日 1%向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

9.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承

担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1 因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1 招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4 甲乙双方须共同遵守《医药购销廉洁协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5 本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件：

- 1.设备整套完整资质文件
- 2.法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)
- 3.设备配置清单
- 4.仪器设备技术参数响应偏离表
- 5.售后服务承诺
- 6.中标通知书
- 7.医药购销廉洁协议书
- 8.政府采购项目货物验收入库报告单

附件

一、设备整套完整资质文件

二、法定代表人授权书

致：安康市中心医院

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（公司名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就安康市中心医院腹腔镜系统等设备采购项目（项目编号：SCZD2025-ZB-0623-001）包1的合同签订和执行，并以我方的名义处理一切与之有关的事宜,我方均予以承认。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，有效期至合同内容服务结束，特此声明。

法定代表人（签名并盖章）：

被授权人（签名并盖章）：

法定代表人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

三、设备配置清单

四、设备技术参数响应偏离表

五、售后服务承诺

六、中标通知书

七、医药购销廉洁协议书

八、政府采购项目货物验收入库报告单

医药购销廉洁协议书

甲方（买方）：安康市中心医院

乙方（卖方）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医疗购销行为，维护正常的医疗秩序和医疗产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲乙双方协商，同意签订医疗购销廉洁协议书并予以共同遵守：

一、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

二、甲方购进医疗设备、医用耗材等医疗产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、接受乙方产品发票价以外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

三、甲方工作人员不得以暗示或任何其它形式索要回扣、提成、有价证券、现金和购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

四、甲方工作人员不得替乙方非法统计医用耗材销售数量等有关信息。

五、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐或提供国内或境外学术活动等手段进行医疗设备或医用耗材促销活动。

六、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床科室推销医疗产品，不得借故到甲方相关工作人员的家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方按照国家有关法律、法规规定和有关廉政制度给予处理，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

本协议书为医疗产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

安康市中心医院医疗设备验收报告

申请科室：

验收日期：

设备名称		规格型号	
数量(台)		质保年限	年
生产厂家 (公司名、电话)		出厂日期 产品编号(SN)	
配送企业 (名称、电话)		安装工程师 (姓名、电话)	
注册证号			☐ 有 ☐ 无报关单
商务验收	包装箱外观是否完好		☐ 是 ☐ 否
	设备外观是否完好		☐ 是 ☐ 否
	设备名称、规格型号及配置是否与合同相符		☐ 是 ☐ 否
	附件、备件是否齐全，与合同相符		☐ 是 ☐ 否
	使用说明书、技术手册、合格证等是否齐全		☐ 是 ☐ 否
	其它(以上未注明项)		
技术验收	性能、技术指标是否达到合同相符		☐ 是 ☐ 否
	运行状况是否良好		☐ 是 ☐ 否
	原理与结构、常见故障是否培训达标		☐ 是 ☐ 否
临床验收	功能情况是否与合同相符		☐ 是 ☐ 否
	性能状况是否良好		☐ 是 ☐ 否
	使用培训是否达标		☐ 是 ☐ 否
	日常维护培训是否达标		☐ 是 ☐ 否
	受培训人(签字)		
验收结论	☐ 合格，同意入库；验收完成日期： 年 月 日。 ☐ 不合格，处理意见： ☐ 更换 ☐ 补齐 ☐ 退货。原由：		
配送企业(签字)		技术工程师(签字)	
资产管理(签字)	使用科室负责人(签字)	技术主管(签字)	设备科负责人(签字)
备注：			

第五章 采购需求及要求

包 1:

5.1 采购需求一览表:

序号	产品名称	数量	品目预算（元）	最高限价（元）	备注
1	腹腔镜系统	4 套	12,600,000.00	12,600,000.00	允许采购进口产品，已做进口备案

5.2 技术要求:

全数字 4K/3D 荧光影像平台腔镜系统（2 套）

一、设备配置清单		
序号	产品名称	数量
1. 全数字 4K/3D 荧光影像平台腔镜系统		
1.1	全数字 4K/3D 荧光影像平台腔镜系统主机	2 套
1.2	全数字 4K/3D 荧光影像平台腔镜系统模块	2 套
1.3	4K/3D 荧光电子镜	2 根（含消毒盒 2 个）
1.4	32 英寸 4K/3D 医用监视器（含底座）	2 套
1.5	55 英寸 4K/3D 医用监视器（含可移动支架）	2 套
1.6	超高清 4K 荧光摄像头	2 套
2. LED 医用冷光源		
2.1	LED 医用冷光源	2 套
2.2	脚踏	2 个
3. 40L 电子气腹机		
3.1	40L 电子气腹机	2 套
3.2	气腹机过滤器	2 盒
3.3	可重复使用气腹管	2 根
3.4	气腹机气源净化套件	2 套

4. 台车		
4.1	腹腔镜专用台车	2 台
5. 腹腔镜及导光束		
5.1	10mm30° 超高清内窥镜	10 根
5.2	10mm45° 超高清内窥镜	1 根
5.3	5mm30° 超高清内窥镜	4 根
5.4	4.8mm 纤维导光束	4 根
5.5	内窥镜消毒盒	15 个
6. 高频电刀系统		
6.1	配套专用高频电刀	2 台
7. 腔镜器械		
7.1	配套腔镜器械	1 套（见清单）
8. 3D 眼镜		
8.1	3D 眼镜	40 副
二、设备总要求		
▲1、除特殊说明者外，均为同一品牌。		
2、适用于普外、胸外、妇科、泌尿外科等各种腔镜手术诊疗。		
三、设备技术规格		
1. 全数字 4K/3D 荧光影像平台腔镜系统		
1.1 全数字 4K/3D 荧光影像平台主机		
▲1.1.1	可处理 3D 和 2D 画面信号，输出分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，逐行扫描	
1.1.2	图像色域范围 BT. 2020、BT. 709	
1.1.3	主机自带刻录功能，通过 U 盘直插直用，可在术中记录全高清录像及 4K 图片拍照。	
▲1.1.4	主机内有两个图像处理器可双路采集，标准画面与增强画面可同屏对比显示。	
1.1.5	可同时处理可见光波段及近红外波段	
▲1.1.6	可实现双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。	
1.1.7	具备 ≥ 5 种影像增强功能，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益	

▲1.1.1.8	≥2 种图像处理及优化模式，可提高对血管的辨识度	
1.1.1.9	可通过画中画功能实现≥4 种同屏显示模式。	
1.1.1.10	具备纤维镜抗摩尔纹或抗网格模式	
1.1.1.11	术野画面≥5 级亮度可调	
1.1.1.12	荧光和白光模式的切换(脚踏、摄像头)	
1.1.1.13	术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能	
1.1.1.14	通过摄像头可操控手术设备（气腹机，电子调光冷光源），并可实现与一体化手术室无缝连接	
1.1.1.15	影像平台主机≥4 个 USB 接口	
1.1.1.16	输出端口：DP 数字端口≥1 个，12G-SDI 数字端口≥1 个，DVI-D 数字端口≥1 个	
1.1.1.17	电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备	
1.1.1.18	支持 50Hz 和 60Hz 输出	
1.2 4K/3D 荧光电子镜		
▲1.2.1	4K/3D NIR/ICG 一体电子镜	
1.2.2	采集像素：电子镜像素≥3840x2160，双路 4K 采集，逐行扫描	
1.2.3	电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌	
▲1.2.4	3D/2D 旋转模式，可 360° 旋转，具备 180° 自动翻转功能，支持自动水平校准	
▲1.2.5	≥5 种显影模式：重叠荧光模式（绿/蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等	
1.2.6	术野画面≥5 级电子放大功能	
1.2.7	具有除雾功能	
1.2.8	重量≤420g，可进行单手控制	
1.2.9	免调焦设计	
1.2.10	可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源	
1.2.11	摄像头 3 个按键可设置≥4 种快捷键，可预设包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI 模式、FI 开关等功能	
1.2.12	外径 10mm，视向角 30°	
1.3 医用显示器监视器		
1.3.1	种类	16：9 医用专业液晶监视器。
1.3.2	尺寸	≥32 英寸
1.3.3	分辨率	≥3840 x 2160
1.3.4	数字接口	DP 数字端口、12G-SDI 数字端口、 DVI-D 数字端口、HDMI 2.0 数字端口、HDMI 1.4 数字端口

1.3.5	色域	BT. 2020/ BT. 709
1.3.6	视角	$\geq 178^\circ$ / 178°
1.3.7		专业监视器生产厂家生产（无需与主机同一品牌）。
1.4 超清高 NIR/ICG 摄像头		
1.4.1	采集像素：摄像头像素 $\geq 3840 \times 2160$ ，逐行扫描	
▲1.4.2	重量 $\leq 260\text{g}$	
1.4.3	图像格式 16:9	
1.4.4	可同时采集可见光波段及近红外波段	
1.4.5	全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输	
1.4.6	可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源	
1.4.7	摄像头 3 个按键可设置 ≥ 4 种快捷键，可预设包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI 模式、FI 开关等功能	
1.4.8	术野画面放大功能，7 级可调，具备自适应缩放功能	
1.4.9	电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备	
2. 医用冷光源		
▲2.1	显影	NIR/ICG 显影技术
2.2	操作方式	触摸面板设计，方便数据的显示与触摸控制
2.3	光源种类	高性能 LED 光源
2.4	待机及储存功能键	具备待机及自动存储记忆功能
2.5	色温	$\geq 5700\text{K}$
2.6	灯泡寿命	≥ 30000 小时
2.7	安全等级	CF 级，可直接用于心脏手术
2.8		单踏板脚踏
3. 台车		
3.1	台车	腔镜专用台车
4. 40L 电子气腹机		
4.1	气腹压力	气腹压力：最大 30mmHg
▲4.2	气腹流量	二氧化碳气腹流量：最大 40L/min。
4.3	高速灌流模式	适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min
▲4.4	高精给灌流模式	适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。 当流速调节范围为：0.1-2 l/min 范围，调节精度为 0.1 l/min；当

		流速调节范围为 2-10 l/min 范围，调节精度为 0.5 l/min
4.5		液晶显示屏，触摸界面，操作直观动态实时显示腹腔内压及流速等数值
4.6		可直接通过摄像头控制气腹机操作界面。
4.7	预警系统	内置压力、流量自动控制系统、故障诊断系统、声光报警系统
4.8		自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题
4.9		集成安全系统，可快速检测压力过高情况
4.10		电气安全最高等级 CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者
5. 腹腔镜及导光束		
5.1 超高清内窥镜		
5.2.1	镜体结构	超广角，无失真，具有防球变系统
5.2.2	镜面材质	蓝宝石，耐磨损，镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理
5.2.3	镜体成像角度	镜体成像角度 30°、45°，直径 10mm±0.5mm、5mm±0.5mm，长度≥30cm
5.2.4	灭菌方法	高温高压、气熏或浸泡消毒等
5.2 导光束		
5.2.1	纤维导光束	直型接头，直径≤4.8mm，长度≥300cm
5.3 内镜消毒盒		
5.3.1	灭菌方法	可高温高压消毒
6. 高频电刀系统		
6.1	具备单极和双极切割和凝血功能	
6.2	输出功率≥300W	
6.3	输出频率≥430KHz	
6.4	输出特性：浮地式（隔离式）输出	
6.5	CF 型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电	
6.6	具备智能组织感知技术，可自动跟踪调整，适用于所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰	
6.7	显示屏：液晶触摸屏	
6.8	具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能	
6.9	具备病人回路电极监控系统	
6.9.1	监测阻抗范围：5-135 欧姆，漏电流≤100 μA	
6.9.2	当监测到接触电阻较初始电阻增大 40%（以较小值为准）时，报警系统启动，同时高频电刀	

	输出停止
6.10	单极切割模式 ≥ 2 种：纯切，混切
6.10.1	纯切：功率 1-300W 峰值电压 $\geq 1200V$
6.10.2	混切：功率 1-200W 峰值电压 $\geq 2100V$
6.11	具备特殊功能模式
6.11.1	止血与分离结合，减慢移动或加快移动速度提高止血或切割效果，功率 1-200W、峰值电压 $\geq 2100V$
6.12	刀笔具备启动切割功能、止血与切割功能、启动凝血功能
6.13	单极凝血模式 ≥ 3 种：软凝，电灼，喷凝
6.14.1	软凝：功率 1-120W 峰值电压 $\geq 260V$
6.14.2	电灼：功率 1-120W 峰值电压 $\geq 3400V$
6.14.3	喷凝：功率 1-120W 峰值电压 $\geq 3900V$
6.15	普通双极模式 ≥ 3 种：精确，标准，宏模式
6.15.1	精确：功率 1-70W 峰值电压 $\geq 280V$
6.15.2	标准：功率 1-70W 峰值电压 $\geq 410V$
6.15.3	宏：功率 1-70W 峰值电压 $\geq 530V$
6.16	双极模式 ≥ 3 种：低，中，高
6.16.1	低：功率 1-15W 峰值电压 $\geq 410V$
6.16.2	中：功率 16-40W 峰值电压 $\geq 210V$
6.16.3	高：功率 45-95W 峰值电压 $\geq 460V$
6.17	演示模式：具备演示模式功能
6.18	具备排烟系统
6.19	心电图消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号
6.20	USB 连接：对设备进行维修操作
6.21	氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能
6.22	脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关
6.23	配置单、双极、三踏板脚踏开关各 1 套，负极板连接线 1 根
6.24	配套开放式病人回路电极板
6.25	提供原厂配套电极最低报价（不计入投标报价中），提供原厂配套电极数量 ≥ 10 套
6.26	可与主机系统非同一品牌

6.27	配备腔镜用可重复消毒双极电刀头≥6个		
7. 腔镜器械（可与主机系统非同一品牌）			
序号	名称	数量	性能描述
7.1	拆线剪	30	医用不锈钢，多规格可选
7.2	肠抓钳	6	用于内窥镜术中组织夹持、提拉。Φ直径5mm，长度330mm±20mm
7.3	持针钳	21	用于腹腔镜术中缝合时夹住缝合针。Φ直径3mm，长度210mm±20mm
7.4	冲吸泵 （医用加压器）	2	用于内窥镜术时对腹腔和胸腔进行冲洗和吸引用，≥50W
7.5	穿刺器（磁片）	36	用于腹腔镜术中在腹腔中建立器械通道。直径5mm、Φ直径10mm，长度90mm±20mm
7.6	穿刺器 （磁片带保护）	12	用于腹腔镜术中建立器械通道。Φ直径5mm/10mm，长度90mm±20mm
7.7	穿刺器 （磁片带螺纹）	60	用于腹腔镜术中建立器械通道。Φ直径5mm/10mm，长度90mm±20mm
7.8	穿刺器（翻盖）	21	用于腹腔镜术中建立器械通道。Φ直径12mm，长度90mm±20mm
7.9	打结钳	6	用于内窥镜术中，缝线打结。Φ直径5mm，长度330mm±20mm
7.10	单极电凝线	6	用于内窥镜术中，可与奥林巴斯、storz等主流腔镜品牌能量平台、高频电刀配套使用。Φ直径4mm，长度3300mm±20mm
7.11	胆囊抓钳	3	用于内窥镜术中组织夹持、提拉。Φ直径5mm，长度330mm±20mm
7.12	弹簧抓钳	3	用于内窥镜术中夹持组织、提拉。长头直径5mm，长度330mm±20mm；直径3mm，长度210mm±20mm等。
7.13	导光束	6	用于腹腔镜术中配套能量平台输出光能。工作长度3000mm±200mm
7.14	电凝（铲状、棒状）	2	用于内窥镜术中，可与奥林巴斯、storz等主流腔镜品牌能量平台、高频电刀配套利用高频电流凝血和切割组织。电凝钩用于术中切割、凝血。Φ直径5mm，长度330mm±20mm
7.15	电凝钩	16	用于内窥镜术中切割、凝血，可与奥林巴斯、storz主流腔镜品牌能量平台、高频电刀配套。直径5mm，长度330mm±20mm；Φ直径3mm，长度210mm±20mm等。
7.16	缝合钳	3	用于内窥镜术中缝合腹壁。10mm/5mm/2mm/2.5mm/2mm等，具备多个规格可选
7.17	腹壁缝合钳 （钩式）	6	用于内窥镜术中缝合腹壁。2.2mm小儿专用
7.18	腹腔镜弯分离钳	6	儿童交通性鞘膜积液用，直径5mm，长度330mm±20mm
7.19	哈巴狗抓钳	6	用于内窥镜术中配套哈巴狗钳头血管阻断，Φ直径12mm，长度350mm±20mm等多尺寸。
7.20	活检钳	3	膀胱镜配套手术器械

7.21	肌瘤钳	1	用于在内窥镜术中固定子宫肌瘤配合旋切器切割。Φ直径 5mm，长度 330mm±20mm±20mm
7.22	简易举宫器	2	用于宫腔镜术中对于子宫固定、调位，具备多个规格可选
7.23	举宫杯	2	用于宫腔镜术中对于子宫固定、调位，有效工作长度≥400mm,具备多个规格可选
7.24	锯齿钳	6	膀胱镜配套手术器械
7.25	可拆换吸引器	9	产品用于在内窥镜手术中吸引。Φ直径 3mm
7.26	阑尾抓钳	6	用于内窥镜术中组织夹持、提拉。Φ直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.27	腔镜剪刀	30	医用不锈钢，裁剪精度 5mm±1mm
7.28	腔镜器械消毒盒	9	同时容纳 10-15 件腔镜器械，长 550cm，宽 250cm，高 100cm±20cm（双层）
7.29	切开刀	6	用于胆管切开。Φ直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.30	取物钳	3	用于在内窥镜术中取物。直径 10mm，长度 330mm±20mm
7.31	疝气针	6	腔镜手术配套器械
7.32	施夹器	9	用于内窥镜术中配套血管夹夹闭血管，直径 10mm/5mm，长度 330mm±20mm 等，具备双开，加大号、大号、中大号等多个规格可选
7.33	手术剪	30	医用不锈钢，多规格可选
7.34	鼠牙抓钳	2	用于内窥镜术中组织夹持、提拉。Φ直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.35	双关节持针钳	2	胸腹腔开放式手术使用。弯/直头
7.36	双关节肺叶抓钳	2	胸腹腔开放式手术使用。三角头，头宽 5mm±2mm
7.37	双关节分离剪	2	胸腹腔开放式手术使用。宽圆头 3.5mm
7.38	双关节分离止血钳	2	胸腹腔开放式手术使用。带锁扣，角弯高 25/70°
7.39	双关节分离止血钳	2	胸腹腔开放式手术使用。带锁扣，弧弯高 15°
7.40	双关节淋巴结钳	2	胸腹腔开放式手术使用。有锁扣，头宽 8mm 或 12mm
7.41	双关节卵圆钳	2	胸腹腔开放式手术使用。弯有槽，头宽 8mm 或 10mm
7.42	双关节卵圆钳	2	胸腹腔开放式手术使用。弯无槽，头宽 8mm 或 10mm
7.43	双关节香蕉（卵圆）钳	6	胸腹腔开放式手术使用。弯无槽，头宽 8mm 或 10mm，长度 280mm±20mm，等多个规格可选
7.44	双关节香蕉钳	2	胸腹腔开放式手术使用。长条，头宽 8mm 或 10mm
7.45	双极电凝钳	30	内窥镜术中可与奥林巴斯、storz 等主流腔镜品牌能量平台、高频电刀配套使用与高频手术设备互连。双极电凝钳作用于患者组织表面，烧灼血管，电凝、止血，直径 5mm，长度 330mm±20mm 双动、直/弯头

7.46	双极高频电 缆线	18	内窥镜术中可与奥林巴斯、storz 等主流腹腔镜品牌能量平台、高频电刀配套使用与高频手术设备互连，双极电凝钳作用于患者组织表面，烧灼血管，电凝、止血
7.47	钛夹钳	6	用于腹腔镜术中与钛夹配套使用。Φ 直径 10mm，长度 330mm±20mm
7.48	推结器	6	用于内窥镜术中缝线打结。Φ 直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.49	弯分离钳	9	用于在内窥镜术中与高频手术设备互连利用高频电流凝血和切割组织，用于手术中组织游离、夹持、提拉。直径 5mm，长度 330mm±20mm；直径 3mm，长度 210mm±20mm 等。
7.50	弯剪刀	6	用于手术中组织缝线、切割Φ 直径 3mm，长度 210mm±20mm；直径 5mm，长度 330mm±20mm 等。
7.51	胃抓钳	6	用于在内窥镜手术中组织夹持、提拉，直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.52	无创抓钳	12	用于在内窥镜术中组织夹持、提拉。Φ 直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.53	无损抓钳	12	直径直径 5mm，长度 330mm±20mm，用于内窥镜手术中，组织夹持、提拉。
7.54	吸引器	3	用于内窥镜术中吸引。推杆式直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.55	异物钳	6	膀胱镜配套手术器械
7.56	直分离钳	2	用于内窥镜术中与高频手术设备互连利用高频电流凝血。胃抓钳用于手术中组织游离、夹持、提拉。Φ 直径 5mm，长度 330mm±20mm
7.57	转换器	30	用于内窥镜术中与穿刺器配合转换器械通道规格。Φ 直径 5mm-Φ 10mm
7.58	子宫抓紧钳	3	用于内窥镜术中组织夹持、提拉。Φ 直径 10mm，长度 330mm±20mm
7.59	组织镊	30	医用不锈钢，多规格可选

全数字 4K 荧光影像平台腹腔镜系统（2 套）

一、设备配置清单		
序号	产品名称	数量
1. 全数字 4K 荧光影像平台腹腔镜系统		
1.1	全数字 4K 荧光影像平台腹腔镜系统主机	2 套
1.2	全数字 4K 荧光影像平台腹腔镜系统模块	2 套
1.3	超高清 4K 荧光摄像头	2 套
1.4	32 英寸 4K 医用监视器（含底座）	2 套
2. LED 医用冷光源		
2.1	LED 医用冷光源	2 套

2.2	脚踏	2 个
3. 40L 电子气腹机		
3.1	40L 电子气腹机	2 套
3.2	气腹机过滤器	2 盒
3.3	可重复使用气腹管	2 根
3.4	气腹机气源净化套件	2 套
4. 台车		
4.1	腔镜专用台车	2 台
5. 腹腔镜及导光束		
5.1	30° NIR/ICG 30° 荧光腹腔镜	2 根
5.2	10mm 30° 超高清内窥镜	8 根
5.3	5mm 30° 超高清内窥镜	2 根
5.4	10mm 45° 超高清内窥镜	2 根
5.5	5mm 胆道镜	1 根
5.6	2.5mm 胆道镜	1 根
5.5	4.8mm 纤维导光束	4 根
5.6	内窥镜消毒盒	16 个
6. 高频电刀系统		
6.1	配套专用高频电刀	2 台
二、设备总要求		
▲1、除特殊说明者外，均为同一品牌。		
2、适用于普外、胸外、妇科、泌尿外科等各种腔镜手术诊疗。		
三、设备技术规格		
1. 全数字 4K 荧光影像平台腔镜系统		
1.1 全数字 4K 荧光影像平台主机		
1.1.1	可处理 3D 和 2D 画面信号，输出分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，逐行扫描	

1.1.2	图像色域范围 BT. 2020、BT. 709	
1.1.3	主机自带刻录功能，通过 U 盘直插直用，可在术中记录全高清录像及 4K 图片拍照	
▲1.1.4	主机内有两个图像处理器可双路采集，标准画面与增强画面可同屏对比显示。	
1.1.5	可同时处理可见光波段及近红外波段	
▲1.1.6	可实现双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。	
1.1.7	具备≥5 种影像增强功能，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光;可实现图像色彩增益	
▲1.1.8	≥2 种图像处理及优化模式，可提高对血管的辨识度	
1.1.9	可通过画中画功能实现≥4 种同屏显示模式。	
1.1.10	具备纤维镜抗摩尔纹或抗网格模式	
1.1.11	术野画面≥5 级亮度可调。	
1.1.12	荧光和白光模式的切换(脚踏、摄像头)	
1.1.13	术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能。	
1.1.14	通过摄像头可操控手术设备如（气腹机，电子调光冷光源），并可实现与一体化手术室无缝连接。	
1.1.15	影像平台主机气腹机，电子调光冷光源 4 个 USB 接口。	
1.1.16	输出端口：DP 数字端口≥1 个，12G-SDI 数字端口≥1 个，DVI-D 数字端口≥1 个	
1.1.17	电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备	
1.1.18	支持 50Hz 和 60Hz 输出	
1.2 超清高 NIR/ICG 摄像头		
1.2.1	采集像素：摄像头像素≥3840x2160，逐行扫描	
▲1.2.2	重量≤260g	
1.2.3	图像格式 16:9	
1.2.4	可同时采集可见光波段及近红外波段	
1.2.5	全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。	
1.2.6	可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源	
1.2.7	摄像头 3 个按键可设置≥4 种快捷键，可预设包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI 模式、FI 开关等功能	
1.2.8	术野画面放大功能，7 级可调，具备自适应缩放功能	
1.2.9	电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备	
1.3 医用显示器监视器		
1.3.1	种类	16：9 医用专业液晶监视器。

1.3.2	尺寸	≥32 英寸
1.3.3	分辨率	≥3840 x 2160
1.3.4	数字接口	DP 数字端口、12G-SDI 数字端口、DVI-D 数字端口、HDMI 2.0 数字端口、HDMI 1.4 数字端口
1.3.5	色域	BT. 2020/ BT. 709
1.3.6	视角	178° / 178°
1.3.7		专业监视器生产厂家生产（无需与主机同一品牌）。
2. 医用冷光源		
▲2.1	显影	NIR/ICG 显影技术
2.2	操作方式	触摸面板设计
2.3	光源种类	高性能 LED 光源
2.4	待机及储存功能键	具备待机及自动存储记忆功能
2.5	色温	色温≥5700K
2.6	灯泡寿命	≥30000 小时
2.7	安全等级	CF 级，可直接用于心脏手术
2.8		单踏板脚踏
3. 台车		
3.1	台车	腔镜专用台车
4. 40L 电子气腹机		
4.1	气腹压力	气腹压力：最大 30mmHg
▲4.2	气腹流量	二氧化碳气腹流量：最大 40 L/min。
4.3	高速灌流模式	适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min
▲4.4	高精给灌流模式	适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。当流速调节范围为：0.1-2 l/min 范围，调节精度为 0.1 l/min；当流速调节范围为 2-10 l/min 范围，调节精度为 0.5 l/min
4.5		液晶显示屏，现代触摸界面，操作直观动态实时显示腹腔内压及流速等数值
4.6		可直接通过摄像头控制气腹机操作界面。
4.7	预警系统	内置压力、流量自动控制系统、故障诊断系统、声光报警系统
4.8		自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题
4.9		集成安全系统，可快速检测压力过高情况
4.10		电气安全最高等级 CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者

5. 腹腔镜及导光束		
5.1 NIR/ICG 光学镜		
5.1.1	镜体结构	超广角，无失真
5.1.2	镜面材质	蓝宝石
▲5.1.3	镜体	采用柱状镜体技术
5.1.4	镜体成像角度	镜体成像角度 30° ，直径 10mm，长度 $\geq 30\text{cm}$
5.1.5	灭菌方法	可高温高压、浸泡、熏蒸等
5.1.6	消毒盒	腹腔镜消毒盒
5.2 超高清内窥镜		
5.2.1	镜体结构	超广角，无失真，具有防球变系统
5.2.2	镜面材质	蓝宝石，耐磨损，镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理
5.2.3	镜体成像角度	镜体成像角度 30° 、 45° ，直径 $10\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ 、 $5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，长度 $\geq 30\text{cm}$
5.2.4	灭菌方法	高温高压、气熏或浸泡消毒等
5.3 导光束		
5.3.1	纤维导光束	直型接头，直径 $\leq 4.8\text{mm}$ ，长度 $\geq 300\text{cm}$
5.4 胆道镜		
5.4.1	国际通用标准目镜接口	
5.4.2	视野角 $\geq 110^{\circ}$	
5.4.3	视向角 0°	
5.4.4	镜体头端外径 5mm 或 2.5mm，含 6Fr 工作通道及灌流通道	
5.4.5	弯曲角度：上角度 $\geq 180^{\circ}$ ，下角度 $\geq 100^{\circ}$	
5.4.6	工作长度 $\geq 35\text{cm}$	
5.4.8	扭矩稳定，1:1 旋转	
5.4.9	无需任何镜鞘即可完成胆道镜手术和检查	
5.4.10	内镜与灌流通道整合	
5.4.11	工作通道内径 6 Fr，LUER 灌流接口，带阀门开关	
5.4.12	镜体头端特殊人体工程学无创设计	
5.4.13	双路照明系统	
5.4.14	胆道镜抓钳 2 把，直径 $\leq 10\text{mm}$	

5.4.15	胆道镜抓钳头端硅胶垫 2 套	
5.4.16	双通接头 2 个，用于造影	
5.5	内镜消毒盒	
5.5.1	灭菌方法	可高温高压消毒
6. 高频电刀系统		
6.1	具备单极和双极切割和凝血功能	
6.2	输出功率 $\geq 300W$	
6.3	输出频率 $\geq 430KHz$	
6.4	输出特性：浮地式（隔离式）输出	
6.5	CF 型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电	
6.6	具备智能组织感知技术，可自动跟踪调整，适用于所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰	
6.7	显示屏：液晶触摸屏	
6.8	具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能	
6.9	具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险	
6.9.1	监测阻抗范围：5-135 欧姆，漏电流 $\leq 100 \mu A$	
6.9.2	当监测到接触电阻较初始电阻增大 40%（以较小值为准）时，报警系统启动，同时高频电刀输出停止。	
6.10	单极切割模式 ≥ 2 种：纯切，混切	
6.10.1	纯切：功率 1-300W 峰值电压 $\geq 1200V$	
6.10.2	混切：功率 1-200W 峰值电压 $\geq 2100V$	
6.11	具备特殊功能模式	
6.11.1	止血与分离结合，减慢移动或加快移动速度提高止血或切割效果，功率 1-200W、峰值电压 $\geq 2100V$	
6.12	刀笔具备启动切割功能、止血与切割功能、启动凝血功能	
6.13	单极凝血模式 ≥ 3 种：软凝，电灼，喷凝	
6.14.1	软凝：功率 1-120W 峰值电压 $\geq 260V$	
6.14.2	电灼：功率 1-120W 峰值电压 $\geq 3400V$	
6.14.3	喷凝：功率 1-120W 峰值电压 $\geq 3900V$	
6.15	普通双极模式 ≥ 3 种：精确，标准，宏模式	
6.15.1	精确：功率 1-70W 峰值电压 $\geq 280V$	
6.15.2	标准：功率 1-70W 峰值电压 $\geq 410V$	

6.15.3	宏：功率 1-70W 峰值电压 $\geq$ 530V
6.16	双极模式 $\geq$ 3 种：低，中，高
6.16.1	低：功率 1-15W 峰值电压 $\geq$ 410V
6.16.2	中：功率 16-40W 峰值电压 $\geq$ 210V
6.16.3	高：功率 45-95W 峰值电压 $\geq$ 460V
6.17	演示模式：具备演示模式功能
6.18	具备排烟系统
6.19	心电图消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号
6.20	USB 连接：对设备进行维修操作
6.21	氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能
6.22	脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关
6.23	配置单、双极、三踏板脚踏开关各 1 套，负极板连接线 1 根
6.24	配套开放式病人回路电极板
6.25	提供原厂配套电极最低报价（不计入投标报价中），提供原厂配套电极数量 $\geq$ 10 套
6.26	可与主机系统非同一品牌
6.27	配备腔镜用可重复消毒双极电刀头 $\geq$ 6 个

说明：以上标“★”类为核心指标，如发生负偏离视为非实质性响应，其投标将被认定为无效投标。标“▲”类为重要指标，未标记的为一般指标。

第六章 投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-0623-001

安康市中心医院腹腔镜系统等设备采购项目
投 标 文 件

包 号：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

一、资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件

二、商务及技术文件

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、投标人参加政府采购活动承诺书

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件

10、投标方案或技术方案

11、业绩一览表

12、投标人须知前附表要求的其他文件

一、资格证明文件

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）提供 2023 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件 6-9）

要求：以上资格证明文件须提供加盖投标人红色公章的扫描件。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 2023 年度经审计的财务报表

投标人提供 2023 年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

重要提醒：报告首页须带有经财政部注册会计师行业统一监管平台备案的二维码和报告编码，否则视为无效报告。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：1、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；2、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书。

二、商务及技术文件

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档____份。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- (1)按照招标文件的规定,我公司投标总价为:人民币(大写)_____元(¥:_____元)。
- (2)本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日,若我方中标,投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (3)已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如有),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (4)按照招标文件的规定,在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
- (5)按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资料,我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件,且尊重评标结论和定标结果。
- (6)完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(盖公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

_____年_____月_____日

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

包号：

投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

包 号：

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

包 号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包 号：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包 号：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
1	合同标的说明			
2	第二条质量保证			
3	第三条知识产权			
4	第四条包装和运输			
5	第五条交付和验收			
6	第六条货款结算			
7	第七条售后服务			
8	第八条合同的变更、终止与转让			
9	第九条违约责任			
10	第十条不可抗力			
11	第十一条争议解决办法			
12	第十二条 其他			
14	投标文件有效期			
15	投标文件数量			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）

投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
2. 不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
7. 不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第**10**条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
 2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

投标人须知前附表要求的其他文件

附件：陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）

一、系统登录

- 1、打开全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），点击【不见面开标】->选择对应辖区不见面大厅（注意一定要选对应辖区的不见面开标大厅）->【不见面开标】进入不见面开标大厅登录首页。



- 2、点击【登录】---挑选投标人身份使用 CA 锁登录系统，提前登录系统调试环境，确保系统登录正常。




备注：推荐使用 IE11 浏览器

二、开标流程


1、选择参加的开标项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。

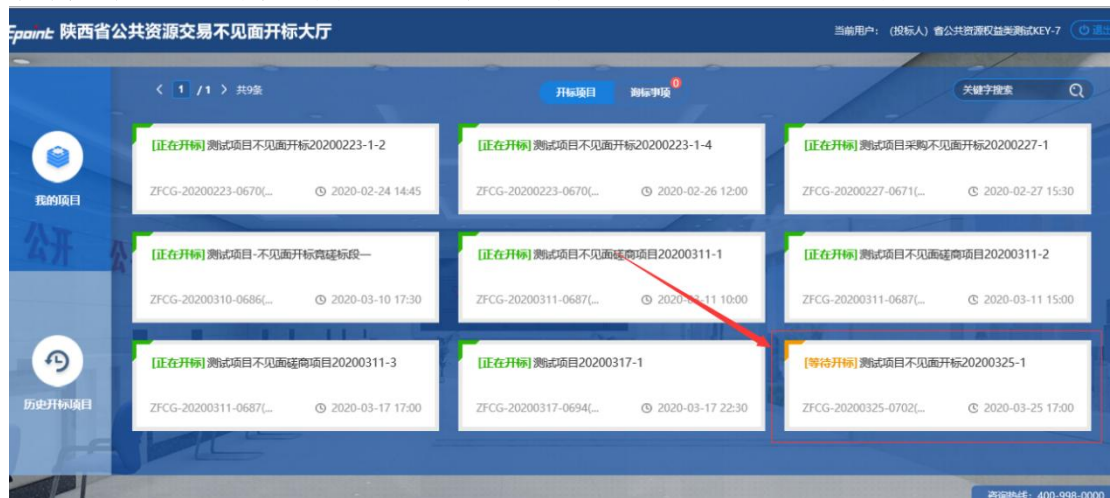

2、阅读开标流程

投标人阅读开标流程。

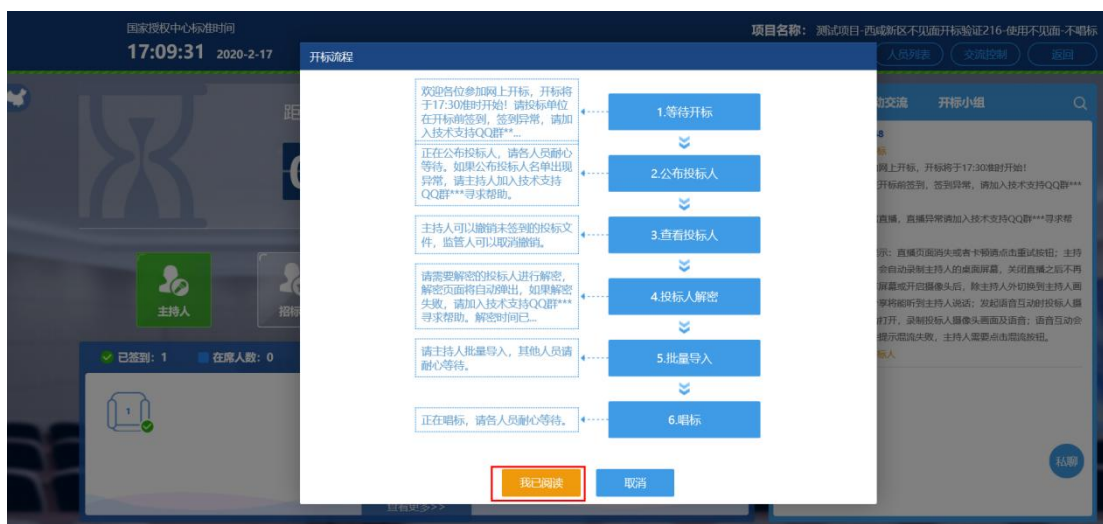


3、查看投标人

开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒，等待公布投标人



投标人公布完成后，投标人名单有图标展示模式和列表展示模式，可根据自己意愿进行切换。

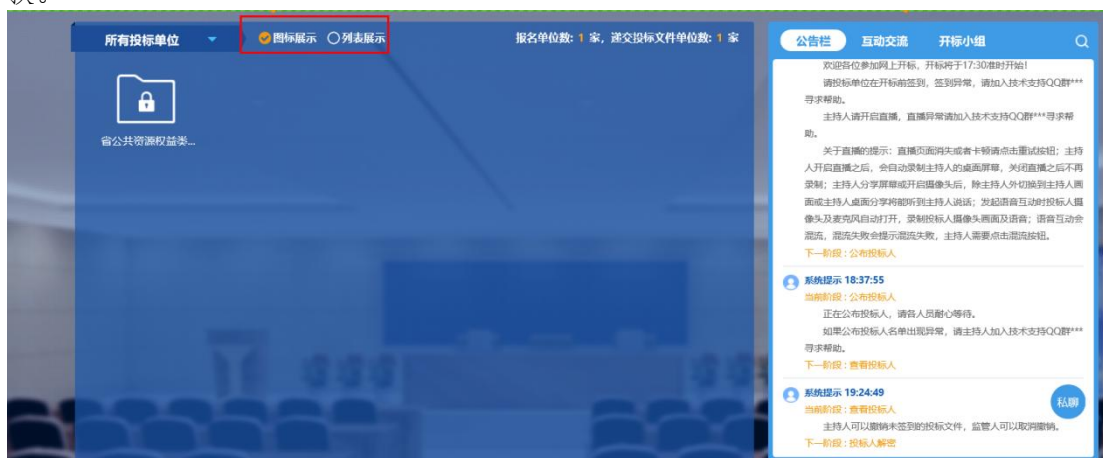

所有投标单位				
		☐ 图标展示	☒ 列表展示	报名单位数: 1 家, 递交投标文件单位数: 1 家
序号	投标单位名称	递交状态	文件状态	文件送达时间
1	省公共资源权益类测试KEY-9	已递交	未启封	2020-02-17 14:41:22

4、投标人远程解密

采购代理机构主持人宣布进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。系统会自动弹出以下界面。

剩余时间: 00: 26: 11

☒ 图标展示
 ☐ 列表展示

此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 0 家

我的投标文件

解密剩余时间

00: 26: 11

请输入PIN码:

解密

开标异议文字提问

解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。

注意：解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

剩余时间: 00: 23: 54

☒ 图标展示 ☐ 列表展示

此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 1 家

公告

面
像
混
下

系
当

寻
下

系
当

下

系
当

失
或
下

我的投标文件

剩余时间: 00: 22: 53

☐ 图标展示 ☒ 列表展示

此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 1 家

序号	投标单位名称	投标单位解密状态	解密时间	最终解密状态
1	我的投标文件	解密成功	2020-02-17 19:33:58	解密成功

开标异议文字提问

5、投标文件批量导入

由采购代理机构将解密成功的投标文件进行批量导入。导入前任何人无法打开已解密的投标文件。

6、唱标及公布开标结果

解密成功后投标人可在线等待唱标，等待公布开标结果。



7、开标结束


开标结束后投标人可对开标过程进行评价。



三、其他功能介绍


1、主持人桌面分享以及开标环境查看

投标人在采购代理机构主持人开启直播间后，可以通过控制下图查看按钮，进行“主持人桌面分享查看”以及“开标环境查看”操作。

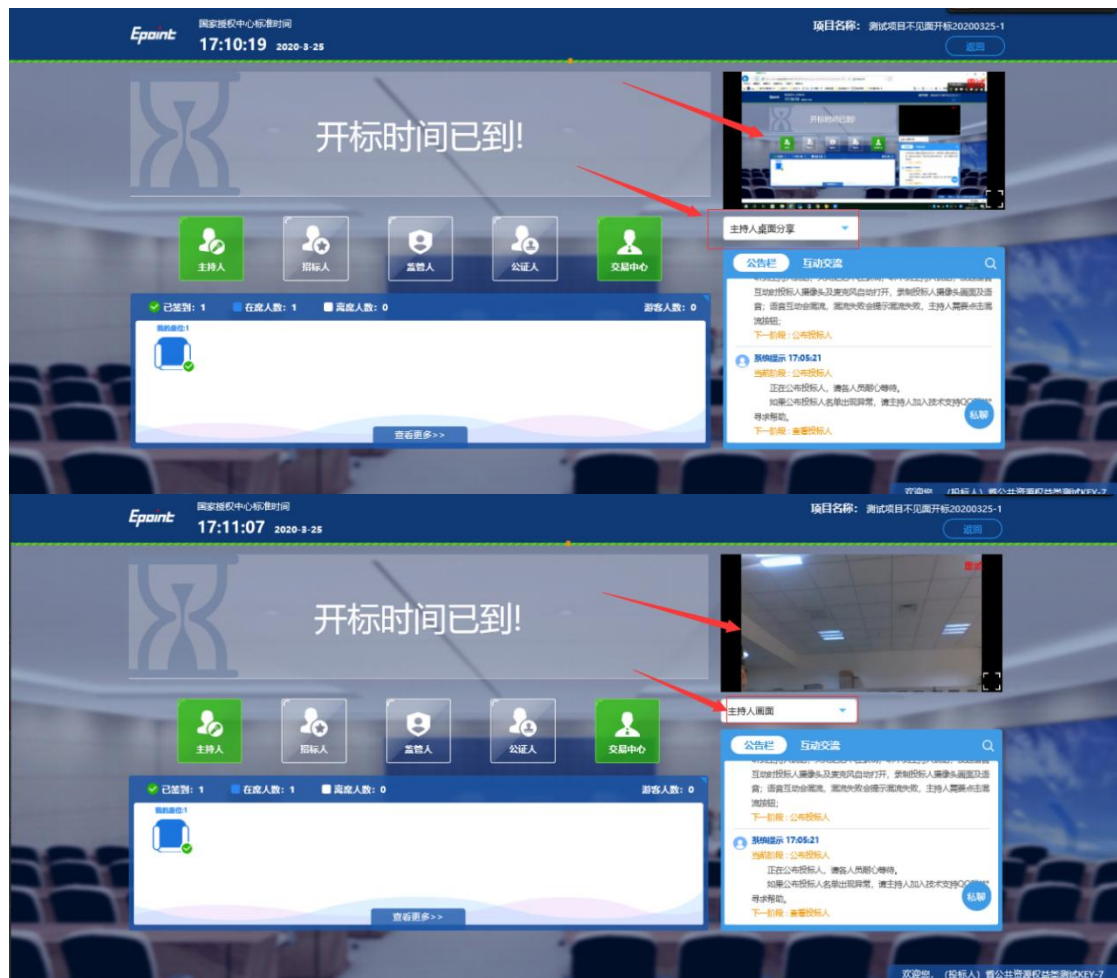



2、互动交流

投标人可在互动交流页面查看采购代理机构发出的文字、语音信息，当采购代理机构发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。

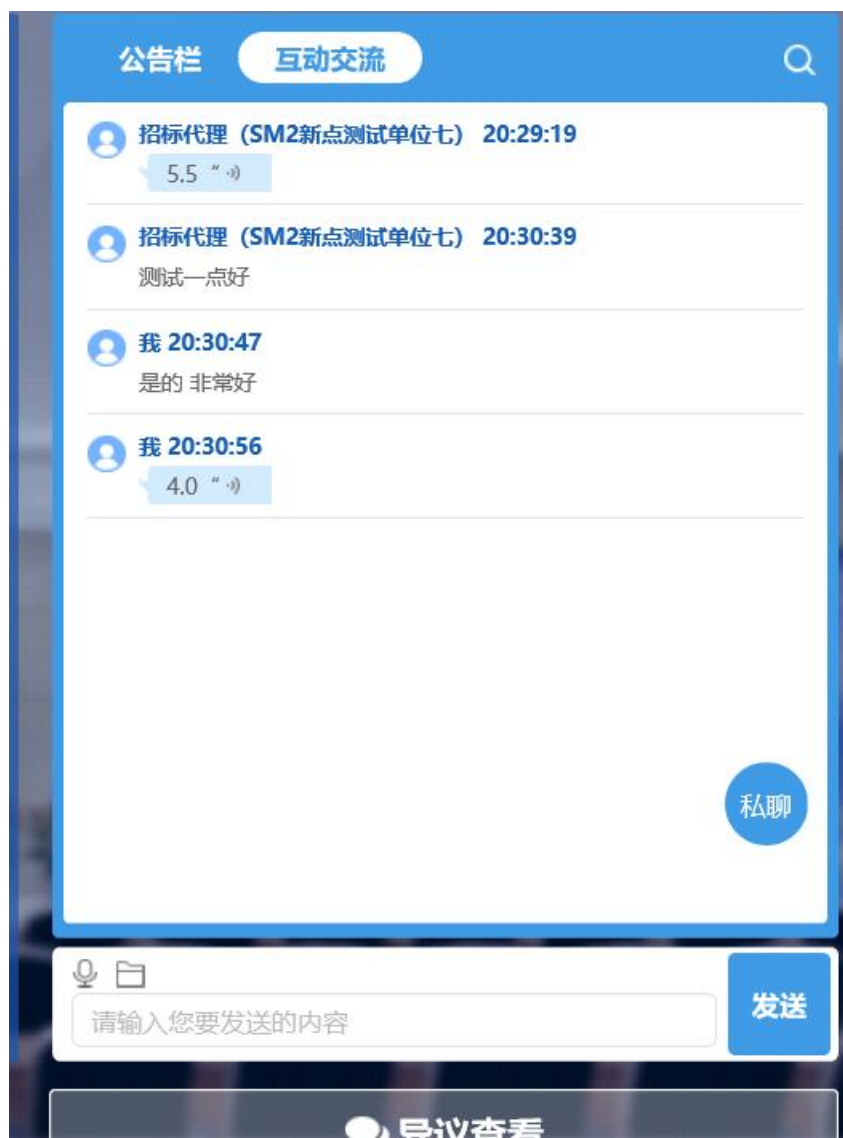


当采购代理机构开启私聊，并有人向投标人发送了私聊信息后，投标人端会在左下角看到有私聊提醒，点击即可与其进行私聊。

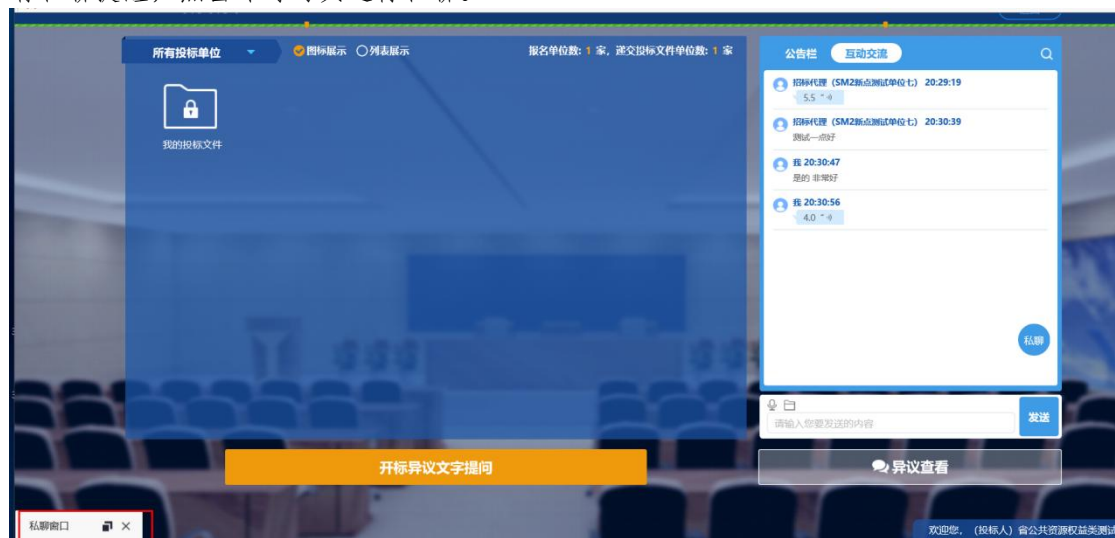

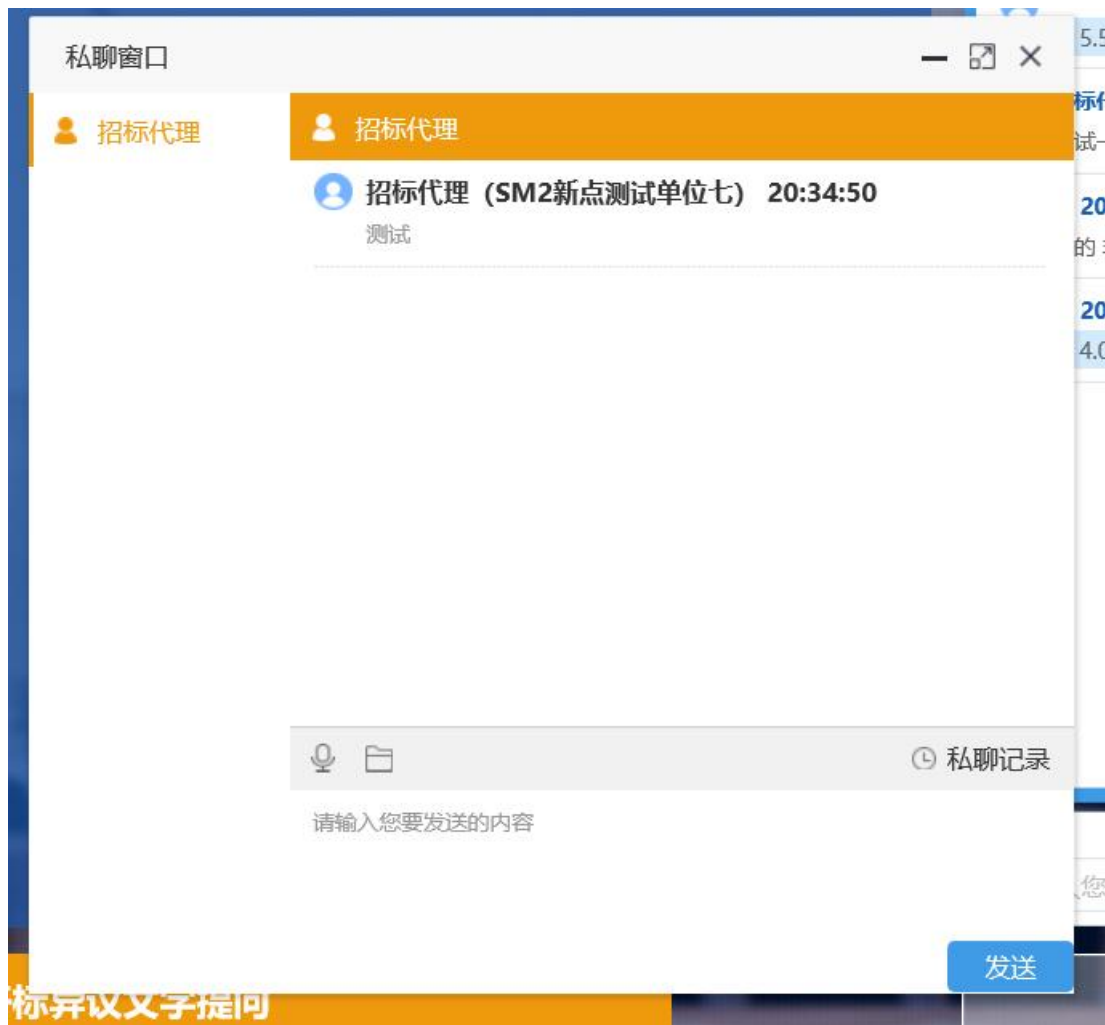

3、开标异议提出及答复

投标人可通过“开标异议文字提问”向采购代理机构提出异议

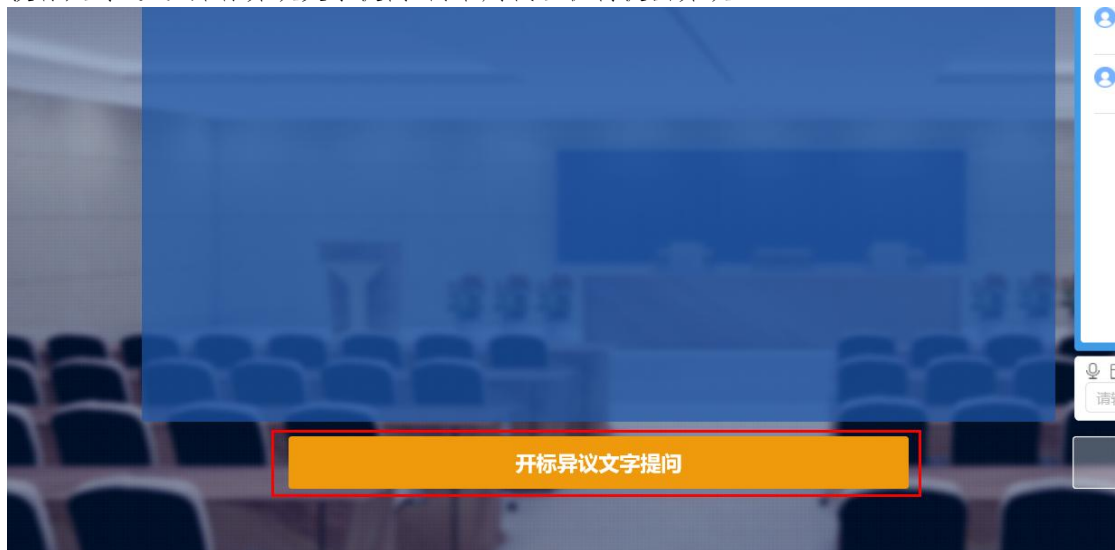

填写异议内容、依据和理由，也可上传相关证明附件。

[illegible]

4、异议查看

投标人可通过异议查看功能查看自己或其他投标人提出的异议及异议的回复内容。

The image is a screenshot of a procurement system's user interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for '所有投标单位' (All Bidding Units), '图标展示' (Icon Display), and '列表展示' (List Display). It also shows '报名单位数: 1 家' (Registered Units: 1) and '递交投标文件单位数: 1 家' (Submitted Bid Documents Units: 1). On the right, there are links for '公告栏' (Notice Board) and '互动交流' (Interactive Communication). Below the navigation bar, there's a section for '我的异议' (My Objections) and '全部异议' (All Objections). A sidebar on the left shows '全部' (All), '未回复' (Not Answered), and '已回复' (Answered). The main content area displays a table with columns: '序号' (Serial Number), '异议内容' (Objection Content), '回复摘要' (Reply Summary), '回复时间' (Reply Time), and '查看' (View). The first row shows an objection with serial number '1' and content '测试仪一丝一等' (Test Instrument One Thread One Grade). Below this, there's a detailed view of the objection, titled '异议详情' (Objection Details). This section includes fields for '异议单位' (Objection Unit) with the value '省公共资源权益类测试KEY-9', '异议内容' (Objection Content) with '测试仪一丝一等', '依据和理由' (Basis and Reason) with a long string of '1's, '附件' (Attachments) with '无' (None), and '异议时间' (Objection Time) with '2020-02-17 20:40'.

四、注意事项

1、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

2、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

3、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。及时关注右侧公告及互动栏目信息。