

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-1377/001

绥德县中医医院医疗设备器械及医用相关设施
采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年六月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	6
第三章	评标方法和标准	25
第四章	拟签订的合同文本	36
第五章	采购需求及要求	43
第六章	投标文件格式	43

第一章 招标公告

绥德县中医医院医疗设备器械及医用相关设施采购项目招标公告

项目概况

绥德县中医医院医疗设备器械及医用相关设施采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后获取招标文件，并于 2025 年 07 月 22 日 09 时 30 分（北京时间） 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZK2025-ZB-1377/001

项目名称：绥德县中医医院医疗设备器械及医用相关设施采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2743870.00 元

采购需求：

合同包 1（绥德县中医医院医疗设备器械及医用相关设施采购项目）

合同包预算金额：2743870.00 元

合同包最高限价：2743870.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他医疗设备	医疗设备器械及医用相关设施采购项目	1（批）	详见招标文件	2743870.00	2743870.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成供货安装并达到使用要求。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为部分专门面向中小企业的项目，且面向中小企业的合同份额不少于 73.78%，供应商须填写《中小企业声明函》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或自然人的身份证明）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标供应商 2024 年或 2023 年经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附并附基本存款账户信息表；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）投标供应商应提供投标截止时间前六个月中任意一个月的纳税证明或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章），依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

（2）投标供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件），不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.6 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.7 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.8 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3.9 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证或备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 4 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年 7 月 22 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：线上递交投标文件、线上开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕

财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：绥德县中医医院

地址：榆林市绥德县名州镇名州街 3 号

联系方式：0912-5632252

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层

联系方式：0912-3683703

3、项目联系方式

项目联系人：乔俊衡

电 话：15771610687

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人： <u>绥德县中医医院</u> 地 址： <u>榆林市绥德县名州镇名州街3号</u> 电 话： <u>0912-5632252</u>
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址： <u>西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层</u> 联系人： <u>乔俊衡</u> 电话： <u>15771610687</u>
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见公告
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>是</u> ，且面向中小企业的合同份额不少于 <u>73.78%</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求： /
1.7	项目所属行业： <u>工业</u>
2.2	项目预算金额：2743870.00 元；最高限价：2743870.00 元
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标/包
12.1	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址： https://credit.yl.gov.cn/ ）。 各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投

	标信用的承诺事由为“项目名称+投标保证金”（例：×××××项目+投标保证金），承诺有效期同投标有效期。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起 90 个日历日
14.1	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/ ）递交，无需提交纸质版投标文件；
16.1	投标截止时间：2025 年 7 月 22 日 09 时 30 分 00 秒
18.1	开标时间：2025 年 7 月 22 日 09 时 30 分 00 秒 开标地点：本项目采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页〉不见面开标】系统，在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.4	本项目涉及的政府强制采购产品：/ 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：/
20.5	本项目核心产品： <u>肌电图诱发电位仪</u>
23.2	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u>
31.1	是否提交履约保证金： <u>否</u>
32.1	预付款比例为：若中标人所投的产品全部为中小企业生产的，合同签订后，预付款 40%；若中标人所投的产品不是全部为中小企业生产的，无预付款。
32.3	情形如下： ☐ 采购资金在履约完成之后才能到位 ☐ 政府采购合同履行期限小于 20 日

	☐ 政府采购预算资金小于 50 万元 ☐ 其他采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法按标准收取 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014 通讯地址：西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
38	进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下： 1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标

	文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。 3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。 4. 承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心； 注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。
39.1	本项目是否为不见面开标： ☒是 ☐否 若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 采用不见面开标的方式进行； 1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2、供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 3、不见面开标流程 该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

	3.2 IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login; 3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 3.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
--	--

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门或部分面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》或出具的《中小企业声明函》未全部包含采购文件规定的专门面向中小微企业采购的产品、出现漏项、中小企业产品的金额占比不满足招标文件规定的（中小企业的合同份额不少于 73.78%），其投标将被认定为投标无效。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关

规定。

- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。
- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标,共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标,否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知前附表**。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的,其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见**投标人须知前附表**。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算,具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价(如有)见**投标人须知前附表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的,其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

- 9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标复制。

11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

- 12.1 本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），未按招标文件规定的格式要求上传并公示投标信用承诺书其投标将被认定为投标无效。
- 12.2 投标人有下列情形之一的，在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
- （1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
 - （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
 - （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - （5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - （6）中标人拒绝履行合同义务的。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
- 14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标

文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 密封要求：本项目采用电子化招投标，投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密”指令后，及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的商务条款负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是

否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (6) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确确保付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台

（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 37.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
- 37.3 投标人提交质疑函的要求
 - 37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
 - 37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
 - 37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
 - 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
 - 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。
 - 37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织

的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

38、 信用承诺：详见投标须知前附表。

39 不见面开标注意事项及流程。

39.1 不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”。

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

1.4 属于招标文件规定的其他投标无效情形

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%（榆林）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

本项目为部分专门面向中小企业采购的项目，故不在进行价格折扣。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%（工程为3%）的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品

为相同品牌)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法,则:在全部满足以上实质性要求前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的,按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法,则:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； (2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； (3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； (4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； (5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； (6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2	财务状况报告：提供(1)或提供(2)	(1) 提供递交 2023 或 2024 年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		(2) 提供资信证明原件或复印件, 应满足以下要求: ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具并提供基本存款账户信息表。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”, 投标人提供的复印件在本次投标中予以认可(即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效)。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3	依法缴纳税收的相关材料	(1) 投标人应提供投标截止时间前六个月中任意一个月的纳税证明或完税证明, 时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件, 并加盖本单位公章)。 (2) 缴纳税凭证复印件须清晰可辨, 并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类, 单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 (3) 依法免税或无须缴纳税收的投标人, 应提供相应文件证明。	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	(1) 投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件), 并加盖本单位公章。 (2) 凭证复印件须清晰可辨, 并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 (3) 依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应证明文件, 并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	
7	信用信息	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）。	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
10	已向采购代理机构获取招标文件	需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的供应商均无资格参加投标。	
11	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明	（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
12	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况	
13	特定资格条件	1. 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； 2. 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证或备案凭证	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	
3	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
4	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；

- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审标准

（采用综合评分法时适用）

评标因素	分值	评价要素
价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$
投标产品 评审	38	一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： 1、所投产品属于节能产品得 0.5 分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 2、所投产品属于环境标志产品得 0.5 分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（32分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得 32 分。“▲”号技术参数一项不满足扣 2 分，扣完为止非“▲”号技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 三、投标产品的可靠性（5分） ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。
实施方案	12	依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

		3、技术支持方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
售后服务方案	12	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包括： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
产品业绩	8	投标人提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）类似项目的业绩，每提供一个业绩得2分，满分8分。 评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。
总分	100分	

第四章 拟签订的合同文本

合同编号：_____

买方（以下简称甲方）：绥德县中医医院

卖方（以下简称乙方）：_____

签订地点：绥德县中医医院

签订时间： 年 月 日

一、产品名称、规格型号、材质、数量、单价、金额：

序号	产品名称	规格型号	数量	单价（元）	总金额（元）	备注
1						
合计						

二、产品质量要求、技术标准：按下列第（3）项执行：

- （1）按国家有关标准执行，如无国家标准按下列第（2）项执行；
- （2）按部颁标准执行，如无部颁标准按下列第（3）项执行；
- （3）按甲乙双方在合同中商定的技术条件或补充的技术要求执行。

三、产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装按供方标准，费用供方承担，包装物不回收。

四、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

1. 产品的交货单位：_____
2. 交货方法：乙方负责安装，现场交货
3. 运输方式及运费负担：由乙方负责确定运输方式并承担运费
4. 接货单位（或接货人）绥德县中医医院

五、产品的交货期限：合同签订后 30 日内完成供货安装并达到使用要求

六、货款

1. 合同总价包括：产品费、运输费、装卸费、量体费用、技术人员差旅费、税金及其他完成本项目的费用。

2. 合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

3. 结算方式：若中标人所投的产品全部为中小企业生产的，合同签订后，预付款40%；若中标人所投的产品不是全部为中小企业生产的，无预付款，合同签订后，按照规定日期交货，安装调试至设备运行正常后一次性支付全额货款。

七、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的满足招标技术参数最优产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合格产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后12个月，质保期后，只收取维修成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

八、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告。

2-2、产品使用说明书（中文）。

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明。

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：产品使用、简单维修、保养及维护。

3-2、培训地点：绥德县中医医院。

3-3、培训时间：验收合格后，具体时间由甲方通知。

3-4、培训人数：由甲方确定。

3-5、培训费用：厂家所派培训人员及技术人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方量体电话通知后在 12 小时内派出合格的技术人员到达现场进行量服务，承担相应费用。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-2、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

九、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

十、对产品提出异议的期限和办法：

1. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不合规定，应在五天内向乙方提出书面异议；

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、乙方的责任

9-1 乙方负责将货物运至甲方指定地点。

9-2 乙方应负责货物具有防锈蚀、防震并符合运输方式的包装；由于包装不良使商品发生损坏或性能不良等结果，乙方应负责由此产生的一切费用和损。

9-3 乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，若涉及费用由乙方负担。如造成甲方任何损失，概由乙方予以赔偿。

9-4. 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。

9-5. 乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

9-6 乙方保证提供的产品全新、完好且为满足招标技术参数的最优产品，具备随附的产品说明材料中标明的各项性能指标和厂家提供的技术参数，所用材料及产品外观均无缺陷，符合甲方生产要求，乙方对产品的偏差负全部责任。

9-7 乙方的赔偿责任：

9-8 乙方承诺备品备件优惠：包括常用备品备件清单、备品备件库存情况、备品备件价格优惠不包含在项目合同价款中，此项为乙方根据自身实际情况所定备品备件优惠。

十二、违约责任：

1．乙方不能交货的，同时向甲方偿付不能交货部分产品总价 20% 的违约金。如果违约金不足以赔偿甲方的损失，乙方还应支付相应的赔偿金。

2．乙方所交产品品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3．因包装或运输问题引起货物损毁或灭失由乙方负责承担一切损失。因此不能按时交货的甲乙双方可协商适当推迟交货时间。

4．乙方逾期交货的，每延期一天，乙方每天向甲方支付延期交货部分产品总价 2% 的违约金。

5. 乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交货,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

6. 甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

7. 甲方如错填到货地点或接货人,应承担乙方因此所受的损失。

十三、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内付清,否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,任何一方均可向甲方住所地人民法院起诉。

十六、本合同经双方签字盖章后,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式叁份,甲方贰份,乙方一份。

十七、其它约定: _____ (合同签订时填写)

采购方（甲方）	供货方（乙方）
单位名称（章）_____	单位名称（章）_____
:单位地址：_____	单位地址：_____
代 表 人：	代 表 人：
电 话：	电 话：
开户银行：	传 真：
帐 号：	开户银行：
税 号：	帐 号：

合同附件：

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）		使用单位验收意见：（盖章）	
签字： 年 月 日		签字： 年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第五章 采购需求及要求

一、采购一览表

序号	设备名称	数量	单位	是否专门面向中小微企业采购
1	心电图机（便携式）	1	台	否
2	肌电图诱发电位仪	1	台	是
3	中医定向透药治疗仪	4	台	是
4	超声波治疗仪	1	台	是
5	耳鼻喉综合治疗台	1	台	是
6	经颅磁脑反射治疗仪	2	台	是
7	全胸振荡排痰机（成人）	2	台	是
8	全胸振荡排痰机（儿童）	1	台	是
9	医用振动排痰机	2	台	是
10	空气波压力治疗仪	2	台	是
11	电脑中频脉冲治疗仪	4	台	是
12	心电监护仪	12	台	否
13	24小时动态心电监护仪	2	台	否
14	麻醉机和呼吸机回路消毒机	1	台	是
15	颈腰椎多功能牵引床	2	台	是
16	颈椎牵引椅	2	台	是
17	医用可视喉镜	1	套	是
18	麻醉用喉镜	4	套	否
19	电动手术台	1	台	是
20	医用转移床（升降转运车）	2	台	是
21	生物灯	10	台	是
22	高压上挤压煎药机	3	台	是
23	智能煎药包装机	2	台	是
24	负压吸引器	3	台	是
25	治疗柜	4	台	是
26	吸痰器	2	台	是
27	辐射保温台	1	台	是
28	气垫床	4	个	是
29	按摩床	25	张	是
30	手动双摇病床	200	张	是
31	床头柜	160	张	是
32	折叠陪护椅	100	张	是
33	输液架	160	个	是
34	带底座输液架	80	个	是
35	手术器械套车	2	套	是
36	手术器械台（中号）	6	台	是

37	手术器械台（特大号）	6	台	是
38	治疗车	13	台	是
39	手术用开放式头圈、肢体绑带、体位垫	1	套	是
40	单抽治疗车	7	台	是
41	麻醉车	4	台	是
42	虚拟化服务器	3	台	否
43	虚拟化软件	1	套	否
44	存储配置扩容	1	台	否

二、技术参数

序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位
1	心电图机（便携式）	1、导联：12 导联同步采集、显示、打印。 2、噪声电平： $\leq 15\mu\text{Vp-p}$ 3、频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） ▲4、时间常数： $\geq 5\text{S}$ ； ▲5、耐极化电压： $\pm 650\text{mV}$ ； 6、共模拟制比： $\geq 105\text{dB}$ ； 7、增益至少包含：2.5 mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC； 8、记录速度至少包含：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 9、 ≥ 5.6 英寸 TFT 液晶屏，支持中文、英文输入； 10、交直流两用，内置环保耐用型锂电池，能连续工作 2 小时以上； 11、可存储回放不少于 250 例病人数据，数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出，并可通过 U 盘，扩展内存容量； 12、具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息； 13、外形美观大方。	1	台
2	肌电图诱发电位仪	1、基本参数 （1）系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及相关配件 （2）整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池； （3）双脚踏开关 2、放大器 ▲（1）通道数：四通道附可伸缩悬臂，可不移动仪器检查患者全身； ▲（2）每通道同时提供两种接口，配备插针国际标准小孔径脑电导联线接口； ▲（3）差模输入阻抗： ≥ 2000 兆欧 （4）输入短路噪声： $\leq 0.38\mu\text{Vrms}$ （通频带 0.5Hz~10 kHz，输入对地短路） （5）共模抑制比： $\geq 126\text{dB}$ （6）滤波频率：0.1Hz-20kHz（高通滤波：0.1-1000Hz；低通滤	1	台

		波：0.02-20kHz) (7) 幅频特性：0.5Hz - 10KHz 内，幅度偏差最大为+5%--10% (8) 通道增益：50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000 倍 (9) 阻抗测试：放大器面板配备阻抗测试按钮 3、记录器 (1) 接口技术：USB (2) 采样率：≥200KHz (3) 采集数据最大时长：不限时 (4) 扫描时程：1ms - 6s 4、刺激器 声刺激器 (1) 刺激强度：0-120dB SPL (2) 掩蔽音强度：0-125dB SPL (3) 极性：疏波、密波、疏密交替波 (4) 刺激声类型：短声、短音 光刺激器（二种） A. 闪光刺激器 (1) 闪光输出：眼罩 (2) 亮度 0-100%可调 (3) 闪光持续时间 2~500 mS (4) 最大照度：距离 LED 法线方向 4mm 处 ≤ 10000Lx B. 图像刺激器（CRT） (1) 图像输出：彩色液晶显示器 (2) 场频：≥60Hz (3) 提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式 (4) 图像亮度：5 级，约为最大亮度的 0%、20%、40%、60%、100% (5) 注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关 (6) 图像类型：棋盘格、垂直条、水平条 (7) 图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、128*96 (8) 刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右 1/4 屏 电流刺激器 (1) 两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出 (2) 恒流源、短路及过载保护 (3) 刺激速率：0.05 ~ 50 次/秒 (4) 刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 (5) 输出刺激强度：0 - 100mA (6) 输出脉冲宽度：50 -1000 μ s (7) 输出短路电流：≤120mA (8) 最大输出电压：≤350V 6、配套设备 (1) 工控双核主机，内存≥2GB，固态硬盘 (2) 液晶显示器：≥22 寸		
--	--	---	--	--

		(3) 打印机：彩色激光打印机 (4) 音箱：针肌电图声音输出 三、执行标准：性能标准、安全标准、质量标准均符合相关行业标准。		
3	中医定向透药治疗仪	1、输出幅度：在 500Q 无感负载电阻最大输出时， $\leq 50V \pm 10\%$ 。 2、直流分量：在 500Q 无感负载电阻最大输出时，中频模式下直流分量小于 1V(r.m.s)，导入模式下直流分量小于 20V(r.m.s)； 3、输出电流：在 500Q 无感负载电阻下，中频模式下输出电流小于 80mA(r.m.s)，导入模式下输出电流小于 50mA(r.m.s)； 4、输出电流稳定度：定向透药治疗仪在不同负载下的输出电流变化率应 $\leq 10\%$ ； 5、中频调制频率 1250~4000Hz。不同处方下对应的载波频率允差 $\pm 10\%$ 。 6、调制频率范围：0.5Hz~150Hz； 7、调制波形：定向透药治疗仪输出的调制波形有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波； 8、调幅度：定向透药治疗仪的调制幅度允差 $\pm 5\%$ ； 9、热疗温度：输出温度调节方式： ≥ 12 档可调，调节范围 40℃~53℃，步进 1℃，允差 $\pm 3^\circ\text{C}$ ，热垫表面温度 $\leq 60^\circ\text{C}$ ，大于 60℃时保护装置切断热疗电源。 10、定时装置：设定范围 1min~60min，默认 20min，步进值 1min，允差 $\pm 30\text{s}$ 。 11、连续工作时间：定向透药治疗仪连续工作时间 $\geq 4\text{h}$ ； 12、定向透药治疗仪按防电击类型分类：1 类设备； 定向透药治疗仪按防电击程度分类：BF 型应用部分； 14、定向透药治疗仪额定电压和频率：AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 10\%$ ；	4	台
4	超声波治疗仪	1、输入功率： $\geq 50\text{VA}$ ； 2、输出通道：单路输出； 3、显示方式：不小于 5 英寸液晶屏，支持一键飞梭； 4、声工作频率：1MHz $\pm 10\%$ ； 5、输出模式： $\geq$ 四种，连续、断续 1、断续 2、断续 3； a) 连续输出； b) 断续 1：输出 1s，间歇 1s； c) 断续 2：输出 0.5s，间歇 0.5s； d) 断续 3：输出 0.3s，间歇 0.3s； ▲6、有效声强：0~1.5W/cm ² ； 7、定时范围：1~30min，步进 1min； 8、最大输出功率：6W，允差 $\pm 20\%$ ； 9、有效辐射面积： $\geq 4\text{cm}^2$ ； 10、波束不均匀性系数 RBN：不超过 8.0； 11、波束类型：准直型； 12、具有超温保护功能。	1	台
5	耳鼻喉综	1、工作主台面尺寸不小于 1600mm*600mm*800mm；	1	台

	合治疗台	2、操作台面和书写台面采用一体式流线型设计； 3、智能控制系统：喷枪和吸枪智能化设计，触摸屏； 4、正压泵：性能稳定，噪音小，最高压力为 300KPa 以上； 5、负压泵：噪音小，最高吸引力为 140KPa； 6、配置有悬臂灯、正负压力表、加热除雾装置、器械盘、药棉罐、吸引管、污物瓶、万向转动照明系统； 7、电动病人椅医生椅各一套，旋转角度 360°，可升降≥80mm，头架部位控制可上下，前后调整。		
6	经颅磁脑反射治疗仪	1、经颅磁脑反射输出部分基本参数： （1）治疗体磁感应强度：低档：6mT±3mT；强档：14mT±4mT； ▲（2）治疗体磁场频率：50Hz±1Hz （3）治疗体数量及特点：每个经颅磁脑反射治疗帽有 6 个治疗体，头围部分 5 个治疗体可以横向移动，也可根据患者头围大小调节经颅磁脑反射治疗帽子的弹力带。 （4）治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。 （5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。 （6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在 1min~99min 范围内设定所需时间。 （7）经颅磁脑反射治疗帽的各导线连接部位能承受 20N 拉力。 （8）微震按摩功能：a)震动幅度：分 4 档可调(1-4) b)震动频率：分 5 档可调(1-5) 2、电疗输出部分基本参数： 脑电反射性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：儿童发育相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）； （1）脑电反射治疗电极最大输出电流强度<20mA （2）肌电反射工作频率 8kHz±30%； （3）肌电反射电极最大输出电流强度：60mA±30%； （4）恒流输出特性，输出负载变化±50%时，输出电流变化不大于 5%； （5）输出电路最大电压峰值<100V； （6）四种输出模式可供选择； （7）电极数量：每路电疗输出最多可同时连接 6 对电极（2 对脑电反射电极（小脑顶核低频电刺激）、4 对肌电反射电极（肢体中频电刺激））； （8）连续工作时间：≥4 小时； （9）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在 1min~99min 范围内设定所需时间； 3、电疗仪主机：重量：≤50KG；	2	台
7	全胸振荡排痰机（成人）	1、机型：柜式机，方便移动； 2、屏幕：≥7 英寸 分辨率≥700*600、触摸屏； 3、成人，儿童一体机（有儿童专用自动模式）； 4、显示方式：真彩触摸屏，触摸操作； 5、压力范围：0.4kPa~4.0kPa，步距 0.3kPa；	2	台

		6、振动频率： 5Hz~30Hz，步距 1Hz，连续可调； 7、手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数； 8、自动模式：≥6 种模式，分为儿童模式和成人两大模式，又各有轻柔，标准，加强三种模式； 9、系统内设 3 种儿童专用模式； 10、自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节； ▲11、定时时间：1min-99min，连续可调，步长为 1min； 12、手持控制器：治疗过程中一键急停； 13、防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒； 14、设备具有雾化功能； 15、仪器可配多种型号充气背心；		
8	全胸振荡排痰机（儿童）	1、机型：柜式机，方便移动； 2、屏幕：≥7 英寸 分辨率≥700*600、触摸屏幕； 3、成人，儿童一体机（有儿童专用自动模式）； 4、显示方式：真彩触摸屏，触摸操作； 5、压力范围： 0.4kPa~4.0kPa，步距 0.3kPa； 6、振动频率： 5Hz~30Hz，步距 1Hz，连续可调； 7、手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数； 8、自动模式：≥6 种模式，分为儿童模式和成人两大模式，又各有轻柔，标准，加强三种模式； 9、系统内设 3 种儿童专用模式； 10、自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节； ▲11、定时时间：1min-99min，连续可调，步长为 1min； 12、手持控制器：治疗过程中一键急停； 13、防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒； 14、设备具有雾化功能； 15、仪器可配多种型号充气背心；	1	台
9	医用振动排痰机	1、主机和推车可分离，方便单独使用。不是撑杆式，也不是一体机，设备整体 ABS 模具成型 2、电源电压 A.C. 220V±22V，频率 50HZ±10HZ 输入功率 300w 3、操作方式 触摸按键操作，转换功能和参数一步到位 4、操作手柄 操作手柄可 360 度旋转，不受任何体位的限制 5、叩击输出 双路输出，适用于成人 儿童；伺服电路设计，使设定振动频率与动力实际输出振动频率保持一致，无功率衰减 6、频率控制 10—60HZ，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制 7、时间控制 0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制，可自动停机 8、输出速度 600 转/分—3600 转/分 9、振动幅度 4-8mm 患者漏电流≤40 微安 10、叩击头 AP210 叩击头 直径 70mm，聚氨酯海绵，适用于儿童或身体中小的敏感部位，与叩击接合器相连，用于儿童体位引流。	2	台

		▲AP212 叩击头 直径 95mm，软聚氨酯海绵组成，产生的作用力更为轻柔，用于老年人或敏感病人体位引流。 AP229 叩击头 直径 105mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。 AP230 叩击头 轭状，宽度 165mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。 叩击接合器 用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。 11、五种自动 叩击模式 自动叩击模式 变频 15—20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人；定时 5 分钟。 自动叩击模式 变频范围 15—25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人；定时 5 分钟。 自动叩击模式 变频范围 20—25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人；定时 5 分钟。 自动叩击模式 变频范围 20—30HZ；适合体质强壮或肥胖病人；定时 5 分钟。 自定义叩击模式 用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。 12.1、安全等级：I 类 B 类 12.2、传导发射：符合 YY0505-2012 条款 36.201.1；GB-4824-2013 12.3、辐射发射：符合 YY0505-2012 条款 36.201.1；GB-4824-2013 12.4、静电放电抗扰度：符合 YY0505-2012 条款 36.202.2；GB/T17626.2-2006 12.5、射频电磁场辐射抗扰度：符合 YY0505-2012 条款 36.202.3；GB/T17626.3-2006 12.6、电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合 YY0505-2012 条款 36.202.4；GB/T17626.4-2008		
10	空气波压力治疗仪	1、柜式一体机，可同时使用两个十二腔气囊。 2、液晶触摸屏加旋转编码器操作。 3、时间设定功能时间范围为 0~60min，步长 1min。 ▲4、生物波功能： a. 四组生物波输出； b. 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式； c. 脉冲频率应为 1Hz~99Hz 连续可调，步长为 1Hz，脉冲宽度为 500 μs。 5、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 6、治疗仪压力范围：5~25kPa 可调。 7、极限压强$\leq$40kPa，且超过 2kPa 的持续时间应不大于 3min。 8、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 10、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 11、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应$\leq$70dB。 12、生物波输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。	2	台

11	电脑中频脉冲治疗仪	1、工作频率:1-10kHz,允差±10%。 2、输出电流:在500Ω的负载电阻下,输出电流不超过以下的限值:频率<1500Hz,为80mA(r.m.s),频率>1500Hz为100mA(r.m.s)。 ▲3、调制频率范围:在0~150Hz范围内。 4、差频频率范围:在0~200Hz范围内。 5、调幅度:0%和100%两种。 6、动态节律:4s~10s范围内。 7、差频变化周期:在15s~30s范围内 8、调制波形:方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波。 9、电极板温度:电极温度应在25℃~41℃范围内。	4	台
12	心电监护仪	1、便携式一体化监护仪,固定式提手。 2、可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数,可升级Masimo/NellcorSP02、2IBP、ETC02等参数。 3、心电(心律失常、ST段分析)、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 4、仪器重量≤3.0kg。 5、彩色显示屏≥12寸,分辨率≥700*500。 6、屏幕亮度10-100级调节。 7、心电:支持3/5导心电,具有智能导联脱落,多导同步分析功能。 8、具有ECG全屏级联。 9、心律失常分析>26种。(提供证明文件)。 10、具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁,下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 11、血氧:可选Masimo血100%:在70%~100%范围内,成人/儿童测量精度为±2%(运动状态下),新生儿为±3%(非运动状态和运动状态下)。 12、可显示灌注指数(PI),测量范围0.02-20%。(提供证明文件)。 13、具有NIBP与血氧同侧测量功能。 14、NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 15、NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 16、血压测量按键单独设置,减少误操作。 17、IBP监护可实时监测PPV/SPV,IBP波形叠加显示。 18、IBP监护可测量10余种压力项目。 19、呼末C0_测量范围0-190mmHg,awRR测量范围0-150rpm。 20、具有数据存储功能:趋势图/表,报警事件,无创血压测量数据,波形全息回顾。 21、具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 22、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面。	12	台
13	24小时动态心电监护仪	1、采集盒: 1.1 重量≤50克,方便受检者佩戴。 1.2 存储方式及容量:mircoSD卡存储,容量≥1G。 1.3 采集盒为彩色屏幕显示波形,可以查看电极连接情况及病人信	2	台

		息。 1.4 具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间。 1.5 可同时支持 microSD 卡拔插方式和 USB2.0 高速直接数据读取方式。 1.6 仅需要一节 7 号(AAA)电池就可以实现 24 小时数据监测。 1.7 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束 30 分钟后将自动关闭电源。 2、信号处理 2.1 频率响应:0.05~60Hz。 2.2 输入阻抗:$\geq 20\text{M}\Omega$。 2.3 输入回路电流:$\leq 0.1\mu\text{A}$。 2.4 噪声电平:$\leq 50\mu\text{Vp-p}$。 2.5 极化电压:$\pm 300\text{mV}$。 2.6 共模抑制比(CMRR):$\geq 100\text{dB}$。 2.7 时间常数:$\geq 3.2\text{s}$。 2.8 增益: 0.5、1、2。 2.9 记录通道:12 通道。 2.10 采样率: 128、256、512、1024Hz，默认为 128Hz。 2.11 A/D 转换精度:8、12、14、16、18 位可调，默认为 16 位。 2.12 起搏检测:多通道同时检测。 3、电脑工作站 3.1 软件同时兼容 3/12 导联记录盒。 3.2 根据用户需要，配置软件界面工作流程功能。 3.3 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配。 3.4 具有反混淆分析功能，模板聚类后可将模板的内的的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形。 3.5 心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调。 3.6 软件对记录的所有动态心电图数据的 ST 段变化进行统计总结，显示 ST 段变化的趋势，ST 测量不准确时，可以进行 ST 段重分析 3.7 可快速的查找各个时间点心电图和 ST 段变化，可修改/添加 ST 事件 3.8 可以对 AOO、VOO、AAI、VVI、DDD 等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲 检测功能，起搏采样率达 10000 点/秒。 3.9 心率变异分析:从 R-R 间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位。 3.10 具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。		
14	麻醉机和呼吸机回路消毒机	1、消毒工作模式：2 个程序模式（麻醉机、呼吸机），1 个自定义模式 2、(麻醉机、呼吸机)程序模式：15min 的雾化程序、60min 的消	1	台

		毒灭菌程序和 30min 的干燥程序 (可 选择) 3、自定义模式：雾化消毒 0min-60min 可调，步进值 5min；臭氧消毒 0min-120min 可调，步进值 5min；解析干燥 0min-60min 可调，步进值 5min。 4、输排气速度 (L/min) ：3-5 ▲5、输入臭氧浓度 (mg/m ³) ：≥ 100 6、臭氧残留量 (mg/m ³) ：≤0.16 7、雾化量 (ml/min) ：0.2-0.5 (可视雾化窗口) 8、报警功能：机器内部超温、高低臭氧发生、消毒液缺失 9、工作噪声 (dB) ：≤ 55 10、电源：AC(220±22)V、 (50± 1)HZ、 ≤200VA		
15	颈腰椎多功能牵引床	1、电源：220V，50Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、腰椎牵引行程：0~300mm，允差±10mm。 4、主动牵引行程：0~200mm、对抗加力牵引行程：0~100mm，允差±10mm。 5、腰椎牵引力：0~990N 范围内可调，级差 10N。 6、牵引总时间：0~99min 范围内设定，级差 1min，允差不大于 30s。 7、牵引时间：0~9min，级差 1min，误差不大于 30s。 8、间歇时间：0~9min，级差 1min，误差不大于 30s。 9、颈椎牵引力：0~300N 范围内可调，级差 10N。 ▲10、颈椎牵引行程：0~300mm，允差±10mm。 11、成角动作范围：-10° ~+30° 连续可调，允差±2°。 12、平摆动作范围：±20° 连续可调，允差±2°。 13、旋转动作范围：±25° 连续可调，允差±2°。 14、腰部热疗加热温度 45℃，允差±3℃。 15、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 16、慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有≥8 种牵引模式。 17、牵引力自动补偿功能。 18、20 种治疗方案存储并读取。 19、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 20、多种安全设计 (最大牵引力 990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键)。 21、颈腰椎一体化牵引。	2	台
16	颈椎牵引椅	1、电源电压：AC220V±22V 50HZ±1HZ； 2、额定输入功率：75VA； 3、颈椎牵引力：0~300N 连续可调； 4、颈椎牵引行程：0~300mm； 5、牵引总时间：0~99min 连续可调； 6、持续牵引时间：0~9min 连续可调； 7、间歇牵引时间：0~9min 连续可调； 8、中频电疗： 中频频率范围：2~6kHz； 中频调制频率范围：0~150Hz；	2	台

		中频调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波； 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制； 中频调制幅度：25%、50%、75%、100%（允差±5%）； 中频输出电流：0~100mA，分为0~99级可调； 中频输出电流稳定度：±5%； 电极板温度范围：38℃~55℃，分为6档可调； 9、颈、背部按摩：连续工作时间：≤30min； 按摩转速：32~45转/min； 10、牵引力自动补偿功能； 11、具备牵引力过大自动保护功能； 12、具备通过手动按钮调整牵引力大小的功能，且可做牵引前的自动预拉紧功能； 13、配备颈部固定装置，可在牵引过程中对颈椎实行稳定保护作用； 14、配备中频电疗，在牵引过程中进行中频电流刺激按摩及治疗，促进局部血液循环，增加牵引效果； 15、配备颈部机械按摩功能，可在牵引工程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度； 16、配备腰部按摩装置及红外线热疗功能，增加座位治疗时的舒适性。		
17	医用可视喉镜	1、显示屏 1.1 高清广角显示屏≥3寸 1.2 分辨率：960×480 1.3 屏幕旋转角度：前后：0°~135°，左右：0°~275° 1.4 具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥32G 2、摄像系统 2.1 数字化摄像系统，像素≥200万 2.2 视场角≥72 2.3 有效景深：3~100mm 2.4 超强的防雾功能：开机即用，无需预热 2.5 光照度：≥3000lux 3、电池 ▲3.1 充电器输入：100~240V，50/60Hz 3.2 充电器输出：5V，2000mA 3.3 电池容量≥3400mA 3.4 充电时间：≤4h 3.5 电池放电时间≥6h 4、具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能 5、具有AV输出功能 6、手柄和摄像系统的连接采用一体化设计	1	套
18	麻醉用喉镜	1、由窥视片、手柄组成。其中窥视片为选配品组成中至少配置一个选配窥视片。 2、光源为LED式，导光方式分为Z型(直接照明式)和G型(纤维导光束照明式)两种，可重复使用。	4	套

		3、材料：喉镜中手柄部分采用符合 GB/T 2040-2017 中的黄铜材料、铝材料、不锈钢材料和 PC 聚碳酸酯，窥视片与人体接触部分采用 GB/T3280-2015 中 06Cr19Ni10 不锈钢材料制成。		
19	电动手术台	1、台面长宽：2000（±20）×580（±20）mm 2、台面高度：580（±20）mm 3、高度调节：700-900mm 4、前后调节：±400 mm	1	台
20	医用转移床(升降转运车)	1、平车体采用碳素型钢焊接成形,表面除锈,树脂粉末静电喷涂;平车面纵梁采用 30mm*20mm*2mm, 矩形空心型钢制造, 坚固可靠。 2、平车面采用 ABS 工程注塑料一次铸压成型, 具有阻燃性高, 耐腐蚀, 韧性强等特点, 四角分别设计有把手, 方便护理急救人员操作。 3、平车长≥1900mm, 床面宽度≥620mm,, 满足人体身高需求, 靠背可起伏 0-75 度, 可根据人体舒适程度调节。 4、护栏采用 ABS 提拉升降式护栏, 放下采用气弹簧缓冲设计, 提高舒适度及护栏使用寿命。平车面分体设计, 背部起背采用气弹簧式起背, 背部起升 0-70° ±5°, 操作简便, 可单手操作。 5、整体升降采用摇杆式设计, 升降高度范围: 580-880mm; 摇把采用双向过盈保护, 自动润滑功能。 6、头部带有氧气瓶托架, 可放置 5L 氧气瓶, 以便急救使用。车头车尾带有对角输液架插孔, 并配有不锈钢伸缩输液架, 方便患者输液。 7、平车采用中控刹车系统, 中控刹车脚轮≥140mm, 有脚踏制动, 灵活行动方便; 配有中央导向轮装置。 8、配有厚度≥2CM 牛津布车垫, 带有≥2 条安全绑带, 在紧急运送病人时, 可保护病人不从运送推车掉落。 9、最大承重≥ 240kg。	2	台
21	生物灯	1、适用治疗板直径: 166mm; 2、电源输入: AC 220V 50Hz; 3、功率: 250VA/个治疗头; 4、支臂伸缩范围: 0-78cm; 5、电源盒升降范围: 0-50cm; 6、头部调节范围: 仰角: 0-90°; 方位角: 360°; 7、波普范围: 2 μm-25 μm; 8、定时范围: 0-60 分钟; 9、工作寿命: >2000 小时。	10	台
22	高压上挤压煎药机	1、容量: 20L: 19000ml--21000ml. 2、功率: ≥2900W。 3、电压: AC220±10V 4、符合《煎药机行业标准》, 药物有效成份煎出率不低于 50%, 以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准; 5、可预设不少于 12 种煎药方案, 并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议; 6、具有安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 7、具有先煎后下提示功能, 具有常压煎药、密闭煎药、循环煎药功	3	台

		能。自动完成一煎两煎中药煎煮，一煎二煎时自动加水，自动清洗。 8、具有安全、卫生、自下往上的定位电动机械挤压系统，实现药液药渣充分分离。 9、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。 10、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。 11、自动加热调节，文火、武火自动转换。 12、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。 13、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境 14、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。 15、能与单体包装机有效对接。		
23	智能煎药包装机	1、储药筒容积 ML: ≥ 20000 2、功率 kW: ≥ 2.8 3、额定电压 V: 220 ± 10 4、包装速率: 7-8 袋/分 5、包装容量: 50~300m	2	台
24	负压吸引器	1、极限负压值: $\geq 0.09\text{MPa}$ (680mmHg) 2、负压调节范围: $0.02 \sim 0.09\text{MPa}$ (150~680mmHg) 3、抽气速率: $\geq 40\text{L/min}$ 4、贮液瓶: 2500ml $\times$ 2 只(玻璃) 5、电源: AC220V 50Hz 6、输入功率: 250VA	3	台
25	治疗柜	1、规格: $90*25/50*175\text{mm} (\pm 10\text{mm})$。 2、材质: 优质不锈钢板材, 厚度 $\geq 1.2\text{MM}$。整体抗冲击、承载强。 3、工艺: 焊接表面平滑均匀, 美观坚固。 4、隔板承重 $\geq 28\text{KG}$, 隔板可以放置器械包(可按科室使用增加隔板), 隔板下有加强筋。 5、上柜门配有透明玻璃。	4	台
26	吸痰器	1、极限负压值: $\geq 0.08\text{MPa}$ (600mmHg) 2、负压调节范围: 0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值 3、抽气速率: $\geq 20\text{ L/min}$ 4、噪声: $\leq 60\text{ dB(A)}$ 5、贮液瓶: 1000mL (PC 塑料) 6、电源: $\sim 220\text{V}$ 50Hz 7、输入功率: 110VA	2	台
27	辐射保温台	1、电源: $220\text{V} \pm 10 / 50\text{Hz}$ 2、功率: $\geq 1000\text{VA}$ 3、温控方式: 微电脑高精度伺服控温 4、温控模式: 预热、自动、手动控制模式 ▲5、温控范围: $32^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 5. 1、温控扩充范围: $25^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$, , 用于特殊婴儿护理 6、温度显示范围: $25^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$ 7、温控精确度: $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$	1	台

		8、床面温度均匀度： $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 9、温度显示精确度： $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 10、温度传感器精确度： $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ 11、升温时间： $\leq 45\text{min}$ 12、显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时 LED 分屏显示 13、报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能 14、温度校正：温度偏差可在前面板修正 15、超温保护：具备双 CPU 控制系统、独立热切断装置等多重超温保护 16、脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置 17、辐射头角度： $\pm 90^{\circ}$ 水平无级可调 18、床面倾斜 $\pm 10^{\circ}$ 无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 19、LED 照明：照明方向、亮度无级可调 20、APGAR 评分计时器 21、婴儿床下置 X 光拍片盒 22、材质工艺：铝镁合金机体，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强 23、整体支架采用立柱轨道 24、双托盘、输液架在立柱轨道上下可调 25、具有底座托盘 26、具有输液密封口		
28	气垫床	1、电压： $\text{AC}220\pm 10\text{V}$ ，50Hz 2、功率：11VA 3、最大允许工作压力： $15\text{KPa}\sim 20\text{KPa}$ （220V 时） 4、输出流量：流量调节至最大是，气泵流量输出 $\geq 7\text{L}/\text{min}$ ；流量调节至最小时，气泵流量输出 $\geq 3\text{L}/\text{min}$ ； 5、. 噪音： $\leq 45\text{dB}$ （A） 6、气垫波动循环时间： $12\text{min}\pm 10\%$	4	个
29	按摩床	1、规格尺寸： $1900*600*650\text{mm}$ （ $\pm 20\text{mm}$ ） 2、床框：采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 的矩形钢材焊接而成 3、床腿：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 的钢管材焊接而成，表面防腐蚀处理，表面有高压静电喷塑涂层。 4、床面：采用优质防水布面，内衬实木板，辅以海绵包制而成。易于清洗，美观大方。	25	张
30	手动双摇病床	1、规格： $2000\times 960\times 500\text{mm}$ （ $\pm 10\text{mm}$ ） 2、升降功能： 2.1 背部升降：升降角度 $0\sim 75^{\circ}$ ， $\pm 2^{\circ}$ ； 2.2 腿部升降：升降角度 $0\sim 45^{\circ}$ ， $\pm 2^{\circ}$ 。 3、床面板 3.1 床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构；床板四周焊接矩管加强筋； 3.2 病床靠背采用双支撑转轴结构，转轴与床板接触处用滑轮；	200	张

		3.3 床板链接采用钢质铰链，单片厚度$\geq 3.5\text{mm}$。耐磨，运作无噪音，防折断。 3.4 床面动态载荷$\geq 250\text{KG}$，有效载荷$\geq 400\text{KG}$。 4、床框采用优质碳钢矩管；床尾板下方设计有隐藏式餐板槽。 5、护栏 5.1 铝合金护栏主管采用直径$\geq 28\text{mmD}$ 型铝合金管，立管使用直径$\geq 18\text{mm}$； 5.4 护栏升起后护栏上缘距离床面高度$\geq 35\text{CM}$，有效防治患者发生坠床风险。 6、床头床尾板 6.1 高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁； 6.3 床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。 7、床架：整体床架采用优质冷轧型材，整个床体结实、牢固，运行平稳，喷涂涂层均匀； 8、传动装置：摇把可 180° 平放，三档折叠； 9、床垫：床垫组成：棕垫$\geq 38\text{mm}$，40D 高弹海绵$\geq 38\text{mm}$，一层牛津防水布。带透气孔，床垫套可清洗。 10、配置：ABS 床头床尾板、高强度铝合金管护栏、碳钢分离杂物架、两个引流钩、静音脚轮。		
31	床头柜	1. 规格尺寸：长*宽*高 $480\text{mm}*470\text{mm}*750\text{mm}(\pm 20\text{mm})$， 2. 材质为 ABS 注塑成型 3、床头柜抽屉为滑槽式设计并带限位装置，防止抽屉滑脱，柜体两侧配有毛巾架。 4. 柜门内有两层隔板，方便分类存放物品。	160	张
32	折叠陪护椅	1、椅架、内框采用不锈钢管，坐卧两用结实大方。 2、软垫采用木板，高回弹海绵及耐刮皮钉制而成； 3、配件：椅脚配备胶质防滑垫、扶手、枕头、座位下面配备有 4 个肥仔轮。 4、承重 350-450 千克	100	张
33	输液架	1、输液杆采用不锈钢管或铁管镀铬；输液挂钩采用不锈钢组成。 2、输液架外表光洁，无毛刺、飞边，各结合处齐整；电镀件外观、油漆件外观光洁。	160	个
34	带底座输液架	1、材质：钢板底座$\geq 40\text{cm}$，防滑胶座 3 个； 2、不锈钢外管$\geq 24\text{cm}$，不锈钢内管$\geq 18\text{cm}$； 3、不锈钢勾 4 个，带科室编号牌； 4、升降方式：旋钮式 5、高度：$1.1\text{m}\sim 2.1\text{m}$	80	个
35	手术器械套车	1、规格：$100*53*90\text{cm}(\pm 2\text{cm})$；$90*48*85\text{cm}(\pm 2\text{cm})$；$80*43*80\text{cm}(\pm 2\text{cm})$。 2、材质：选用 304 不锈钢加厚管材，管壁厚度$\geq 1.0\text{mm}$。整车抗冲击、承载强。 3、工艺：焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、. 板材厚度$\geq 0.8\text{MM}$，台面承重$\geq 28\text{KG}$，双层，有支撑管、护栏。 5、静音医用脚轮，转动轻便。	2	套

36	手术器械台（中号）	1、规格：66*44*86cm（±2cm） 2、材质：不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0mm。整车抗冲击、承载强。 3、工艺：焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、板材厚度≥0.9mm,台面承重≥30KG，双层，有支撑管、护栏。 5、配有塑料污物桶。 6、抽屉推拉顺畅，无噪音，承载量大。 7、静音医用脚轮，转动轻便。	6	台
37	手术器械台（特大号）	1、规格：100*60*86cm（±3cm） 2、材质：不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0mm。整车抗冲击、承载强。 3、工艺：焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、板材厚度≥1.0mm,台面承重≥30KG，双层，有支撑管,护栏。 5、配有塑料污物桶。 6、抽屉推拉顺畅，无噪音，承载量大。 7、静音医用脚轮，转动轻便。	6	台
38	治疗车	1、规格：66*44*86cm（±2cm）。 2、材质：不锈钢加厚管材，管壁厚度≥0.8mm。整车抗冲击、承载强。 3、工艺：焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、板材厚度≥0.9mm,台面承重≥28KG，双层，有支撑管、护栏。 5、配有不锈钢抽屉一个，塑料污物桶。 6、抽屉推拉顺畅，无噪音，承载量大。 7、静音医用脚轮，转动轻便。	13	台
39	手术用开放式头圈、肢体绑带、体位垫	要求：结实耐用，不易松动、移动； 包括： 1、开放式头圈 20cm×7cm×5cm（±0.5cm）1个； 2、肢体绑带 60cm×8cm×1cm（±0.3cm）；60cm×14cm×1cm（±0.3cm）各1个； 3、俯卧位头垫 28cm×24cm×13.5cm（±0.6cm）1个； 4、俯卧位垫 60cm×49cm×18cm（±1cm）1个； 5、膝关节及上肢通用垫 50cm×15cm×4cm（±1cm）1个； 6、半圆形体位垫 50cm×15cm×7cm（±0.5cm）1个； 7、足跟垫 18cm×10cm×7cm（±0.5cm）1个； 8、斜形垫 30cm×22cm×5cm（±0.5cm）1个； 9、圆形头圈 20cm×7cm×5cm（±0.5cm）1个； 10、通用方形垫 40cm×30cm×1.5cm（±0.2cm）1个； 11、甲状腺垫 48cm×39cm×9cm（±0.6cm）1个；	1	套
40	单抽治疗车	1、规格：66*44*86cm（±2cm）。 2、材质：不锈钢加厚管材，管壁厚度≥0.8mm。整车抗冲击、承载强。 3、工艺：焊接表面平滑均匀，美观坚固。	7	台

		4、板材厚度 $\geq 0.9\text{mm}$,台面承重 $\geq 28\text{KG}$,双层,有支撑管、护栏。 5、配有不锈钢抽屉一个,塑料污物桶。 7、抽屉推拉顺畅,无噪音,承载量大。 8、静音医用脚轮,转动轻便。		
41	麻醉车	1、规格:850mm*480mm*970mm(±30mm)。 2、采用高强度铝合金型材,采用厚度为 $\geq 4\text{mm}$ 的工业铝塑板。 3、台面及台面底座一次性注塑成型,台面上方带不锈钢围栏。 4、急救车后方输液架为可调式,可360°自由旋转。 5、抽屉带有拉手,抽屉滑槽采用静音滑槽。 6、抽屉内部配置标准的标识牌。 7、整车配置 ≥ 4 层抽屉,抽屉整体带排锁控制。 8、整车配置静音脚轮,脚轮配置刹车。	4	台
42	虚拟化服务器	1、2U标准机架式服务器; 2、处理器: ≥ 2 颗,参数($\geq 2.3\text{GHz}/20$ 核/30MB/150W)CPU模块;国产化处理器。 3、内存: $\geq 8*32\text{GB}$ DDR4 3200内存; 4、硬盘: ≥ 3 块600GB 10K SAS硬盘; 5、RAID卡:独立RAID卡,支持硬盘直通,支持RAID0、1、5、10、6等,缓存 $\geq 2\text{G}$; 6、网络: ≥ 4 个GE电口, ≥ 2 个万兆光口(含模块); 7、HBA卡: ≥ 1 块双端口16Gb HBA卡。	3	台
43	虚拟化软件	1、虚拟化产品支持安装在通用的x86、ARM架构服务器,支持业界主流CPU服务器,支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理。国产化操作系统。 2、虚拟机支持市场上主流的国产操作系统。 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能,如具有自己的资源(内存、CPU、网卡、存储),可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 4、虚拟机之间可以做到隔离保护,其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行,每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内,以保障系统平台的安全性。 5、支持虚拟机规格的在线和离线调整,包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源,在虚拟机操作系统本身的前提下,热添加的CPU/内存可以即时生效。 6、支持虚拟机在不停机的状态下在不同物理机或存储之间迁移,并保留虚拟机迁移历史记录,记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息,便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 7、虚拟化平台提供统一的虚拟机管理界面,在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、	1	套

		备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。 8、支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡，降低能耗。 配置：3 * 虚拟化管理系统标准版软件 License 费用-管理2个物理 CPU； CAS 集成部署服务扩展包(1台)； CAS 集成部署服务(2台)； 软件技术支持服务(三年)		
44	存储配置扩容	1、集中式存储硬盘扩展柜； 2、磁盘：配置 14 块$\geq$2.4TB SAS 10K 硬盘； 3、支持 RAID6/60 及以上 RAID 级别。 4、国产化硬盘、磁盘。	1	台

二、其他要求

1. 交货期：合同签订后 30 日内完成供货安装并达到使用要求；
2. 交货地点：绥德县中医医院（榆林市绥德县名州镇名州街 3 号）；
3. 付款方式：若中标人所投的产品全部为中小企业生产的，合同签订后，预付款 40%；若中标人所投的产品不是全部为中小企业生产的，无预付款。合同签订后，按照规定日期交货，设备运行正常，验收合格后一次性支付全额货款。

三、包装、运输要求：

- 1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何 损失造成的责任或费用。
- 2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死 在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

四、质量保证

- 1、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策及招标文件的要求。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，满足采购要求。
- 2、若质量不合格，甲方有权拒付所有货款；若产品因运输等原因造成质量问题，一

切损失由乙方承担。

五、对供方的售后服务要求

1. 供方应随货提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），技术保障服务。合同内所购设备必须能够和医院现有设备以及信息系统相匹配相链接，科室有需求的所购设备入医院所有网络端口费用均由供方承担。
2. 供方应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格、技术、指标等要求，并在质保期内、外应对于产品设计、工艺的缺陷而产生的质量问题负责。
3. 保修期内供方接到需方仪器故障报修后，须在 2 小时内做出回应，24 小时内到达需方医院。
4. 保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏，卖方负责免费维修，设备材料成本费用由买方承担。
5. 保修期后，卖方必须在接到买方维修通知后 1 天内派人至买方现场维修。设备的维修、更换，买方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
6. 供方负责对需方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备 保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使买方人员正常地使用、维修保养设备。承诺对使用科室有需求培训的设备，其厂家或经销商负责培训医护人员，不计次数，直到熟练掌握为止。
7. 验收合格起，所有产品原厂保修一年，质保期结束后免费原厂延保两年。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称
投 标 文 件

（资格证明文件）

投 标 人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）2024 年或 2023 年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码），或递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附基本存款账户信息表（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件 6-9）

要求：1. 以上资格证明文件须提供加盖投标人公章。

2. 《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 经审计的财务报告

2023 年或 2024 年度任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附基本存款账户信息表

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前六个月中任意一个月的纳税证明或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

6-6 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1. 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理公司现场查询）；

2. 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3. 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证或备案凭证。

二、商务及技术文件

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、投标方案或技术方案
- 8、业绩一览表
- 9、投标信用承诺书

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档____份。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- (1)按照招标文件的规定,我公司投标总价为:人民币(大写)_____元(¥:_____元)。
- (2)已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如有),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (3)按照招标文件的规定,在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
- (4)按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资料,我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件,且尊重评标结论和定标结果。
- (5)本投标有效期为自投标截止之日起_个日历日,若我方中标,投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (6)完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(盖公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

邮箱: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

_____年_____月_____日

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

标段（若有）	投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
	大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	单位	数量	规格型号	单价(元)	总价(元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

合计人民币(大写)：_____ 整(小写：¥_____元)

产品制造商属于中小微企业提供的产品总价共计_____元；在本项目投标总报价中占比_____%

注：务必完整填写本表，拟投产品的制造商属于中小微企业的，统计该部分产品总价，并计算在投标总价中的占比(占比=产品制造商属于中小微企业的产品总价/投标总价×100%)。

投标人(盖公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	招标要求	投标响应		完全响应	偏离	说明	备注
			技术参数	制造厂家/品牌				

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	付款方式			
	...			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

投标方案或技术方案

（格式自拟）

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

（投标文件格式九）

第六部分 投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；

附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和

在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事项通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。


联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



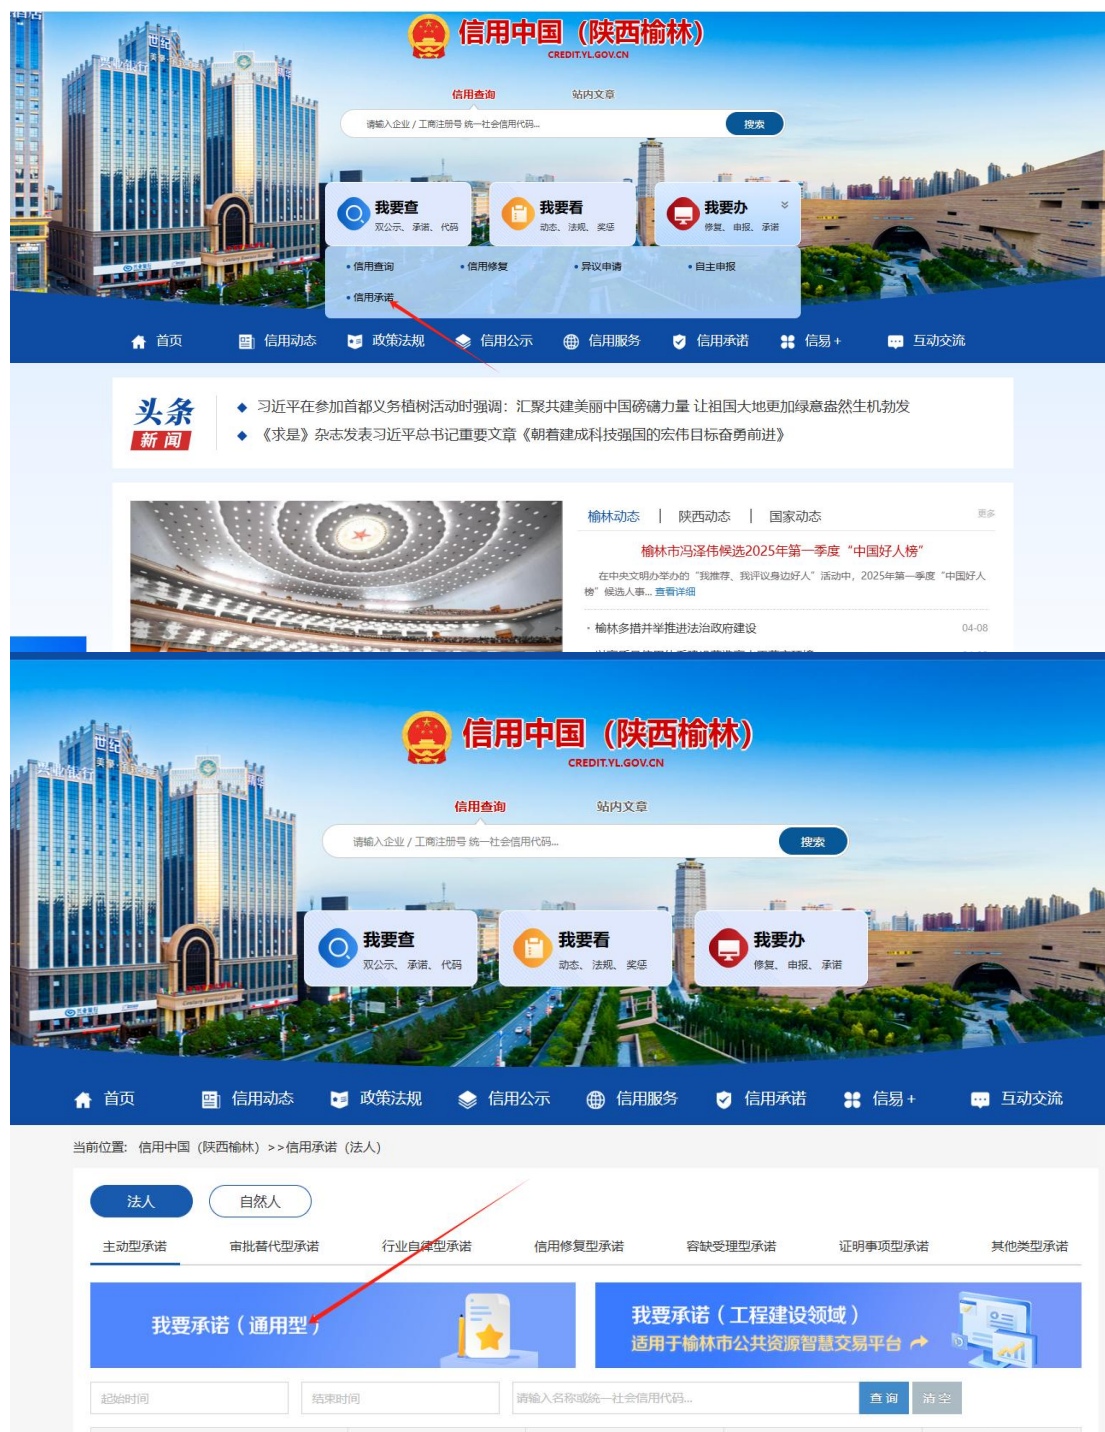

全国一体化在线政务服务平台

陕西省

国家政务服务平台 | 陕西省人民政府 | 秦务员APP | 秦务员公众号

注册 登录

首页

个人办事

法人办事

一件事 (试运行)

特色创新

阳光政务

效能监督

好差评

统一支付

登录说明:

账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看[常见问题](#)或拨打陕西省政务服务网技术支持电话: 029-87382893
若有业务咨询等方面问题, 请拨打政务热线: 12345, 或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话, 也可点击[部门业务咨询电话](#)。
登录陕西省政务服务网的用户, 可激活成为国家政务服务平台用户, 欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。
陕西政务服务网个人账户除支持账号密码登录、手机短信登录外, 还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录; 法人账号除支持账号密码登录外, 还可通过电子营业执照进行快速登录, 欢迎大家使用。
新版全国统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题, 您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们, 工作人员将及时为您解答处理。给您带来的不便, 敬请谅解!

常见问题解决办法

个人登录

法人登录

法人账号

请输入用户名/统一社会信用代码

请输入密码

国家政务服务平台账号登录 找回密码

登录

还没有账号? 立即注册

电子营业执照

秦务员

信用承诺申请

*承诺主体:

*身份证号码

*承诺人类别:

--请选择--

*承诺事项:

--请选择--

*承诺书内容:

*违约责任内容:

*承诺做出日期:

20250410

承诺有效期:

请选择承诺有效期

*承诺事由:

承诺事由

*承诺受理单位:

承诺受理单位

*承诺受理单位代码:

承诺受理单位代码

备注:

*承诺书:

未选择文件

上传文件

附件支持上传jpg,pdf文件,大小在2M以内。

根据项目要求, 自主填报

提交

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报