

采购项目编号：HXXS2025-034

吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目（二次）

招标文件

采 购 人：吴堡县卫生健康局

采购代理机构：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司
日 期：二零二五年十二月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	6
第三章 评审办法	29
第四章 采购内容及要求	41
第五章 商务要求	305
第六章 合同条款	307
第七章 投标文件构成及格式	312
第八章 政府政策扫描件	343

第一章 招标公告

项目概况

吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目(二次)招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台 (陕西省) 使用CA锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2025年12月30日 13时30分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXXS2025-034

项目名称：吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：2,050,000.00元

采购需求：

合同包1(吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目)：

合同包预算金额：2,050,000.00元

合同包最高限价：2,050,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他信息化设备	区域心电智慧平台系统，处方审核等智能软件系统，智能心电图机及相关应用服务器，心电诊断中心电脑等一批设备	1(元)	详见采购文件	2,050,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号) ;

2.《环境标志产品政府采购实施意见》(财库〔2006〕90号) ;

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定;

5.根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号) ;

6.根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号) ;

7.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)等有关规定、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>);

8.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号) ;

9.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) ;

10.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号) ;

11.其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新文件执行)

。

3.本项目的特定资格要求:

合同包1(吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目)特定资格要求如下:

(1) 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024年度企业年检报告;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;

- (2) 投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证，并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
- (3) 社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
- (4) 税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
- (5) 财务状况报告：提供2024年度赋码的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn/>) 可查询并提供网页截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
- (6) 信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、严重失信主体名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供相关网页截图（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）；
- (7) 投标信用承诺书（保证金）；
- (8) 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；
- (9) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
- (10) 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

注： (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

时间： 2025年12月10日至2025年12月16日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:30:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年12月30日 13时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省公共资源交易平台CA锁上传

开标地点：榆林市公共资源交易中心不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：（1）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www--sxggzyjy--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。（2）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。（3）电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148。（4）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。（5）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。（6）本项目非专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：吴堡县卫生健康局

地址：吴堡县三星小区迎宾路2号楼

联系方式：15353166567

2. 采购代理机构信息

名称：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市榆阳区陕西省榆林市高新技术产业园区蓝岛路与建业大道交叉北口北160米高新华府西门二层1号商铺

联系方式：13992251447

3. 项目联系方式

项目联系人：陈震

电话：13992251447

陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

2025年12月09日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	具体信息
1	招标人	名称：吴堡县卫生健康局
2	招标代理机构	名称：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司
3	采购项目名称	吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目(二次)
4	采购项目编号	HXXS2025-034
5	项目概况	吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目具体内容详见招标文件第四章采购内容及技术标要求。
6	资金来源	财政资金
7	采购预算	<p>采购预算：大写：贰佰零伍万元整 小写：（¥2,050,000.00 元）</p> <p>投标人的投标报价超出采购预算，作为不实质性响应招标文件，按无效标处理。</p>
8	采购内容	具体要求详见招标文件第四章“采购内容及要求”。
9	交货期、质保期	交货期：合同签订后90日内。 质保期：验收合格后12个月，有特殊约定的在清单中注明
10	资格证明文件	<p>(1) 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；</p> <p>(2) 投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证，并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；</p> <p>(3) 社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证</p>

	<p>明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>（4）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>（5）财务状况报告：提供2024年度赋码的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）可查询并提供网页截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；</p> <p>（6）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、严重失信主体名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供相关网页截图（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）；</p> <p>（7）投标信用承诺书（保证金）；</p> <p>（8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；</p> <p>（9）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；</p> <p>（10）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。</p> <p>注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；</p>
--	---

		注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理。
11	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
12	现场踏勘及答疑	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 投标人可自行安排勘察现场，由此产生的费用、不良后果、相关责任均由投标人自行承担。
13	投标人提出询问和质疑的时间	已经购买招标文件的投标人对招标文件有询问或者质疑的，可以在本项目公开公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式（陕西省政府采购网上政府采购投标人质疑函范本）向招标代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，招标代理机构不予受理。
14	招标代理机构答疑的时间	对于投标人在规定时间内依法提出的询问和质疑，招标代理机构将在 3 个工作日内答复询问，7 个工作日内答复质疑。若对投标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。
15	投标有效期	90 个日历日（从提交投标文件截止之日算起，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标投标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。）
16	转包与分包履约	不允许。
17	投标保证金	依据《榆林市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（榆政财采发[2023]8 号）文件规定，本项目采用信用承诺代替投标保证金，具体详见投标文件格式。
18	备选投标方案	本项目不接受备选投标方案。
19	开标时间及开标地点	开标时间：2025 年 12 月 30 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）。 开标地点：榆林市公共资源交易中心不见面开标大厅
20	投标文件提交地点及截止时间	（1）电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

		<p>(2) 纸质版投标文件在开标时无需提交, 待开标结束后, 成交供应商须在开标结束后 5 个工作日内将正本壹份、副本贰份、电子版(签章后导出版)贰份投标文件文件邮寄或送至指定地点(备案用);</p> <p>备注: 投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件, 投标文件正、副本须各自装订成册, 统一编码(要求胶装、不得出现活页)。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。</p>
21	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成: 5人组成。</p> <p>评标专家确定方式: 开标前在政府采购评审专家库中, 通过随机方式抽取 4名评审专家, 1名采购人代表。</p>
22	采购代理服务费	<p>招标代理费由: 采购人向代理公司交纳本项目采购代理服务费。</p> <p>招标代理服务费: 依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)计取。</p> <p>本项目项目属性: 货物类招标。</p>
23	履约担保	无
24	支持中小企业发展	<p>支持中小企业发展:</p> <p><input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目:</p> <p>本项目专门面向中小企业采购, 故不参与价格扣除。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目, 货物、服务类(价格扣除): ①对小型和微型企业的产品给予 10%-20%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为: 小型企业扣除 20%, 微型企业扣除 20%。</p> <p>②项目接收联合体投标的, 若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的, 可给予联合体 4% -6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为: 6%。</p>

		<input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目，工程类（价格扣除）：①对小型和微型企业投标的价格给予 3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 5%，微型企业扣除 5%。②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 1% -2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：2%。
25	支持监狱企业 发 展	<input type="checkbox"/> 专门面向监狱企业采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 6%。
26	本项目所属行业	据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本项目采购标的所属行业为工业：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
28. 适用于本投标人须知的额外增加的变动：		
28.1	投标人须在陕西省政府采购网（ http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购投标人库，否则由此引发的一切后果由应商自行承担。	
28.2	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见公告	
28.3	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	
28.4	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与投标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1. 开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址：http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHa</p>	

	<p><u>11/bidhall/dqxianyang/login;</u></p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省 · 榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器。</p> <p>2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会或采购人可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要评标委员会或采购人询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按评标委员会或采购人要求进行有关澄清答复说明的评标委员会或采购人可以否决其投标；请各投标人保持在线直到评审结束。</p> <p>3. 不见面开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。</p> <p>注：系统默认解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>5. 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>6. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省 · 榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
28.5	<p>1. 本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 · 榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。</p> <p>2. 关于制作电子投标文件，投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>3. 提交电子投标文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子投标文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。</p>

28. 6	<p>投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程 → 答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*. SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*. SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p>
28. 7	<p>本招标文件最终解释权归招标代理公司。</p>
28. 8	<p>信用承诺公示要求：</p> <p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。</p> <p>自主上报信用承诺书具体要求事项如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》；承诺事由：填写“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：按招标文件第七章投标文件构成及格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 承诺事项名称：选择《投标信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称”；承诺附件：按招标文件第七章投标文件构成及格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称”；承诺附件：按招标文件第七章投标文件构成及格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 承诺事项名称：《投标人法定代表人（委托代理人）信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称”；承诺附件：第七章投标文件构成及格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 <p>注：不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实时验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p> <p>附件：信用承诺上报操作指南</p>

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述项目采购活动。

1.2 本次采购属货物类政府采购，招标人，招标代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、名词解释

- 2.1 “招标人”系指吴堡县卫生健康局。
- 2.2 “招标代理机构”系指陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司。
- 2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
- 2.4 “工程”系指投标人为完成本项目所做的基础建设、辅助工程等建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- 2.5 “货物”系指投标人按投标文件规定，须向招标人提供的满足投标文件要求的产品、设备、机械、仪器仪表、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件和材料。
- 2.6 “服务”系指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。
- 2.7 节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
- 2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）。
- 2.9 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。
- 2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 2.11 残疾人福利性单位是指符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库{2017}141号）的企业。

2.12 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.13 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

3、合格的投标人

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

(1) 具备且满足“招标公告”第二条要求的；
(2) 在全国公共资源交易中心平台（陕西省）报名并下载招标文件的；
(3) 一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

(4) 有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；
(6) 遵守国家、陕西省有关的法律、法规和规范性文件要求；
(7) 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司、招标人及用户）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标过程中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标过程中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

3.4 本项目不允许联合体投标。

3.5 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止日前已列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。

4、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5、保密

参与采购招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、踏勘现场

8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

9、投标答疑会

9.1 投标人须知前附表规定召开投标答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，答复投标人提出的问题。

9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间答复。

9.3 招标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要通知所有购买招标文件的投标人。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

10、分包

本项目不允许中标后另行转包或者分包。

11、招标文件的解释权

招标文件的解释权归招标代理公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

二、招标文件

12、招标文件的组成

12.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加开标会议的依据，同时也是评审的重

要依据。招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购投标程序、评审办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评审办法
- 第四章 采购内容及要求
- 第五章 商务要求
- 第六章 合同条款
- 第七章 投标文件构成及格式
- 第八章 政府政策扫描件

12.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评审结果，其风险由投标人承担。

13、招标文件的澄清和修改

13.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

13.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15个工作日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。。

13.3 各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页 • > 市县区公告 • > 更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页 • > 交易大厅 • > 政府采购】。

13.4 招标文件澄清或修改内容将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有

约束力。

三、投标文件

14、投标文件的组成

14.1 本项目采用电子投标文件的形式。

14.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（1）电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 ·> 电子交易平台 ·> 企业端】后，在【采购公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 ·> 服务指南 ·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 ·> 服务指南 ·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼E18、E19 窗口或下载手机 APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148（029-88661298 或 4006-369-888 陕西 CA 联系电话）。

14.3 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

15、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

16、证明投标人资格的证明文件

投标人必须按附件要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和入选后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

16.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和能力；

16.2 投标人应提供能满足本项目所配备的人员、专业以及服务承诺等资料。

17、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应对招标文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.2 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

18、享受政府采购政策

18.1 所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

18.2 符合政府采购优先采购政策的，所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”中品目的产品，该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上查找；采购的产品属于品目清单范围的，投标人应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

18.3 投标人享受支持中小型企业政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动时，视同中小企业。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

（1）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见投标文件格式），不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

（2）组成联合体的大中型企业与联合体中的中小企业之间不得存在投资关系；

（3）参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供的不视为中小企业。

（4）参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（详见文件格式）不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

19、投标保证金

依据《榆林市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（榆政财采发[2023]8号）文件规定，本项目采用信用承诺代替投标保证金。

20、投标有效期

21.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

21.2 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式，投标人可以拒绝上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

四、投标文件的递交

21、纸质投标文件的递交

纸质版投标文件在开标时无需提交，待开标结束后，成交供应商须在开标结束后5个工作日内将正本壹份、副本贰份、电子版（签章后导出版）贰份投标文件文件邮寄或送至指定地点（备案用）；

邮寄地址：

收件人：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

收件电话：17749200027

收件地址：陕西省榆林市高新技术产业园区蓝岛路与建业大道交叉北口北160米高
新华府西门二层1号商铺

备注：投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。

22、电子投标文件的递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

23、投标文件的补充、修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

22.2 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

24、投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

- (1) 逾期提交电子投标文件；
- (2) 提交的投标文件与本项目不相符；
- (3) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密；
- (4) 因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

(5) 上传的电子投标文件无法打开。

五、开标

25、开标时间和地点

25.1 招标代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间和地点组织开标会议。投标人不足3家的，不予开标。

25.2 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标相关工作人员签字确认，并存档备查。

25.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

26、开标

26.1 开标会议由招标代理机构主持；

26.2 资格审查；开标时，由采购代理机构或采购人单独或共同依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。（资格审查文件内容包括招标公告中特定资格要求中的全部内容）

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

26.4 投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标文件。

26.5 开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的各投标人代表应按时签到，参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

26.6 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

26.7 投标投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.8 特殊情形下的应急处置：在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

26.8 上述程序，根据实际情况，有权在开标会现场临时调整。

六、评审

27、评标委员会

27.1 评标委员会严格按《中华人民共和国政府采购法》等规定的程序和招标文件规定的评审办法及标准对各投标人的投标文件进行评审。

27.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，招标人授权的评审专家，不得担任评审组长。

27.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

27.4 招标文件和投标文件是评审的依据。在评审中，不得改变招标文件中规定的评审标准、方法和中标条件。投标人不得在投标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

27.5 在评审期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.6 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评审。

27.7 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评估和比较，并推荐出3名中标候选人。

28、评审原则

评审原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

29、评审

29.1 评标委员会严格按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的程序和招标文件规定的评审办法及标准对各投标文件进行评审。

29.2 评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

（2）以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容及有关事项做出解释或者澄清，并提供相关材料；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（4）配合招标人、招标代理机构答复各投标人提出的质疑；

（5）向招标人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

29.3 评审过程严格保密

（1）评标委员会成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

（2）在评审过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评审人、招标人和招标代理机构施加任何影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（3）中标人确定后，招标人和代理机构不对未中标人就评审过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

七、中标

30、中标原则

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

31、中标程序

31.1 评标委员会根据评审办法的规定对投标人进行评审排序，推荐中标候选人，形成评审报告。评审报告由评标委员会全体成员签字确认。

31.2 招标代理机构应在评审结束后 2 个工作日内，将评审报告送招标人确认。

31.3 招标人在收到评审报告后 5 个工作日内，根据评审报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人，同时复函招标代理机构。招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

31.4 招标代理机构在接到招标人的中标复函之日起 2 个工作日内，根据招标人确

定的中标人，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

31.5 招标人不解释中标或落标原因，未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。不退回投标文件和其他投标资料。

31.6 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的投标报价人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

31.7 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32、中标通知书

32.1 中标人确定之后，陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司将发出《中标通知书》。

32.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的重要组成部分。

32.3 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

32.4 中标人在接到招标代理机构通知之日起 3 日内领取《中标通知书》。如果已中标的投标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，招标人有权取消其中标资格。

33、告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

八、废标

34、废标的情形

投标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 投标人的投标报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (3) 评标委员会三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；
- (4) 有证据证明有《中华人民共和国财政部令第87号》第37条串标情形的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的；

九、合同授予

35、签订合同

35.1 招标人应当自《中标通知书》发出之日起 10 日内，按照投标文件和中标人投标文件（包括投标评审中形成的最后报价等补充文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括投标评审中形成的最后报价等补充文件）作实质性修改。

35.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，或重新招标。

35.3 招标人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36、合同实施

36.1 中标人应在合同签订后 7 个日历日内安排人员与招标人就交货工作进行安排、部署。

36.2 若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对招标人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

36.3 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

36.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

37、转包与分包

本项目不允许采取转包、分包方式履行合同。

十、质疑、投诉

38. 质疑

38.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及相关政府采购规定办理。

38.2 潜在投标人对招标文件条款或技术、商务要求有异议的，应当按招标文件 10 条之规定向招标代理机构提出。

38.3. 潜在投标人或投标人对采购事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

38.4 潜在投标人或投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

潜在投标人或投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.5 提出质疑的潜在投标人或投标人应当是参与所质疑项目采购活动的潜在投标人或投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

38.6 质疑的提出与答复，执行财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》。

38.7 质疑人须在质疑书和相关证明材料每一页上加盖公章原件送至质疑函递交地址。

38.7.1 质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理。

38.7.2 质疑函递交地址：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司（陕西省榆林市高新技术产业园区蓝岛路与建业大道交叉北口北160米高新华府西门二层1号商铺）

38.7.3 联系人：陈浩

38.7.4 联系方式：17749200027

39、投诉

质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向吴堡财政局提起投诉。

39.1 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

39.2 投诉人应当根据财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

- (2) 投诉书内容符合财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定;
- (3) 在投诉有效期限内提起投诉;
- (4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理;
- (5) 财政部规定的其他条件。

39.3 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

39.4 投诉的提出和处理，执行财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》。

十一、其他

40、招标代理服务费

40.1 不论投标结果如何，投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的全部费用。

40.2 采购人应向招标代理机构交纳招标代理服务费。

40.3 招标代理服务费的交纳方式：采购人向招标代理机构交纳招标代理服务费，采用银行转账方式一次性交纳。

40.4 招标代理服务费：依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）计取。

40、落实政府采购信用融资政策

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

第三章 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及的规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

1、评审程序

1.1 本采购项目评审按照下列工作程序进行：

1.1.1 投标文件初审；

1.1.2 澄清有关问题；

1.1.3 比较与评价；

1.1.4 推荐中标人名单；

1.1.5 编写评审报告。

1.2 投标文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

1.2.1 投标文件的资格性审查：采购人按照本章附件一资格性审查内容进行审查；

1.2.2 投标文件的符合性审查：评标委员会按照本章附件二符合性审查进行审查；

1.2.3 经过对投标人及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标文件处理。

（1）投标人未经过正常渠道购买投标文件或投标人的名称与网上报名下载招标文件单位的名称不符；

（2）投标文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证件）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的；

（3）投标人资质的有效性或符合性不符合要求的；

（4）投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章，或由投标人委托代理人签字的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（6）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

（7）投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

（8）无投标技术方案或投标技术方案不符合要求；

- (9) 设备技术指标达不到招标文件要求;
- (10) 投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（交货期、付款等项），或附加了招标人难以接受的条件;
- (11) 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争;
- (12) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚;
- (13) 投标人在境内参与政府采购活动中有违法违规行为的;
- (14) 投标报价超出招标最高限价的;
- (15) 其他法律法规规定的情况。

1.2.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

资格性审查表（附件一）

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	<p>供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；</p> <p>评审依据：以加盖单位公章的证明材料复印件为准。</p>
2	资质要求	<p>投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证，并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；</p> <p>评审依据：以加盖单位公章的证明材料复印件为准。</p>
3	社会保障资金缴纳证明	<p>提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>评审依据：以加盖单位公章的证明材料复印件为准。</p>
4	税收缴纳证明	<p>提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>评审依据：以加盖单位公章的证明材料复印件为准。</p>

5	财务状况报告	提供2024年度赋码的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（ http://acc.mof.gov.cn/ ）可查询并提供网页截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任一时段的现金流量表、资产负债表和利润表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； 评审依据： 以加盖单位公章的证明材料复印件为准。
6	信用记录	对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、严重失信主体名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供相关网页截图（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）； 评审依据： 以加盖单位公章的网站查询截图复印件为准。
7	投标保证金	本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现项目名称，承诺公示日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前）； 评审依据： 以加盖单位公章的信用承诺网页查询截图为准。
8	信用承诺书	榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书； 评审依据： 以加盖单位公章的信用承诺网页查询截图为准。
9	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 评审依据： 以加盖单位公章的书面声明为准。
10	其他声明	本项目不接受联合体投标。 评审依据： 以加盖单位公章的书面声明为准。

注：以上资质均需提供复印件，如有资质证明文件提供电子证照的，电子资质证书应包含验证二维码、颁发机构电子签章，且必须为近期下载打印件。以上内容有一项不合格，将视为评审结果为不合格且不通过，该投标人文文件无效，不再进入后续评标阶段。

符合性评审前附表（附件二）

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照或事业单位法人证书信息一致。
2	投标函	加盖投标人公章，且经法定代表人或其授权代表签字或盖章。
3	投标文件签署、盖章	逐页加盖企业公章，企业法人或委托代理人在相应部位签字。签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	投标文件组成	符合招标文件的要求（没有私自篡改招标文件中规定的投标文件格式及相关内容，按招标文件中规定的投标文件格式填写相关内容的）。
5	实质性条款响应	对招标文件做出了实质性响应没有重大缺项漏项，无明显不符合技术规格、技术标准的要求的。
6	投标有效期	符合招标文件要求。
7	投标信用承诺书	按照招标文件的要求，投标文件中提供了投标信用承诺书，并在信用榆林网站进行了信用承诺公示，投标文件中提供了符合招标文件要求的承诺截图。
8	投标报价	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
9	交货期、质保期	符合招标文件要求。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定过的其他被视为“无效投标”的情形。

1.3 投标文件的比较和评价

1.3.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。最低报价不作为中标的唯一条件。

1.3.2 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

2、评标办法

2.1 综合评分法

本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选单位并依次排序。

2.2 评标细则及标准：

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知前附表”规定的投标人资格条件。

评标因素及权重分值表

评标因素	评审内容	分值(分)
投标报价 (30分)	<p>价格评分满分为30分，以实质性满足招标文件商务和技术要求的最低投标价格为基准值，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。</p> <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30
技术指标 评审 (15分)	<p>1、投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度。</p> <p>完全满足招标文件要求的计10分；</p> <p> 标“▲”参数为产品的重要参数，标“▲”技术参数一项不满足要求，扣分分值为1分，非“▲”标技术参数一项不满足要求，扣分分值为0.5分，扣完为止。</p> <p>2、标“▲”参数，每提供一份佐证材料得0.5分，不提供不得分。最高得5分。</p> <p> 注：佐证材料包括但不限于产品的彩页/检测报告/功能截图等，予以证明其技术参数的响应性。</p>	15
培训方案 (8分)	<p>培训方案包括：①培训方案、②培训内容、③培训计划、④培训措施。</p> <p>每提供一项计2分，每有一项内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供的，得0分。</p> <p>缺陷是指以下任意一种情形：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误；或前后矛盾；或存在与采购情况无关的内容；或涉及的内容与本项目要求不一致；或提供方案与采购需求存在相互矛盾；或照搬其他内容里存在与本项目执行无关的内容；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。</p>	8

供货实施方案（12分）	<p>供应商提供的本项目实施方案应包含以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供货配送方案：包括供货计划、产品运输、供货配送等方案措施。 2. 运输保管方案：包括在运输过程中，对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案。 3. 进度保障措施：包括进度安排计划、进度保障措施等方面的内容。 4. 安装保障措施：包括安装技术、安装调试、安装工具、安装人员保护保障措施等方面。 <p>每提供一项计3分，每有一项内容有缺陷的扣1.5分，扣完为止，未提供的，得0分。</p> <p>缺陷是指以下任意一种情形：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误；或前后矛盾；或存在与采购情况无关的内容；或涉及的内容与本项目要求不一致；或提供方案与采购需求存在相互矛盾；或照搬其他内容里存在与本项目执行无关的内容；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。</p>	12
人员配置（6分）	<p>人员配置方案：包括人员构成、人员工作经历或经验、工作分工分配等三部分内容。</p> <p>每提供一项计2分，每有一项内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供的，得0分。</p> <p>缺陷是指以下任意一种情形：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误；或前后矛盾；或存在与采购情况无关的内容；或涉及的内容与本项目要求不一致；或提供方案与采购需求存在相互矛盾；或照搬其他内容里存在与本项目执行无关的内容；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。</p>	6
质量保证（6分）	<p>供应商的质量保证：质量目标、质量管理体系、质量管理制度三部分内容。</p> <p>每提供一项计2分，每有一项内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供的，得0分。</p> <p>缺陷是指以下任意一种情形：数据、名称、专业术语及符号、</p>	6

	文字表述错误；或前后矛盾；或存在与采购情况无关的内容；或涉及的内容与本项目要求不一致；或提供方案与采购需求存在相互矛盾；或照搬其他内容里存在与本项目执行无关的内容；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。	
验收试验 计划方案 (6分)	<p>验收试验计划方案内容包含：验收试验计划安排、制定验收标准及验收方案、验收不合格后的处理措施三部分内容。</p> <p>每提供一项计2分，每有一项内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供的，得0分。</p> <p>缺陷是指以下任意一种情形：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误；或前后矛盾；或存在与采购情况无关的内容；或涉及的内容与本项目要求不一致；或提供方案与采购需求存在相互矛盾；或照搬其他内容里存在与本项目执行无关的内容；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。</p>	6
售后服务 方案 (12 分)	<p>售后服务包含：售后服务机构情况、售后服务人员安排、售后服务响应时间与处理时间、售后服务内容及方式四部分内容。</p> <p>每提供一项计3分，每有一项内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供的，得0分。</p> <p>缺陷是指以下任意一种情形：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误；或前后矛盾；或存在与采购情况无关的内容；或涉及的内容与本项目要求不一致；或提供方案与采购需求存在相互矛盾；或照搬其他内容里存在与本项目执行无关的内容；或只有简单复制粘贴需求内容而无描述。</p>	12
类似业绩 (5分)	<p>提供投标人 2022 年 10 月至今类似项目的业绩证明材料（中标通知书或完整合同），每提供一项计 2.5 分，累计不超过5 分。</p> <p>注：业绩认定必须包含合同关键页（含首页、签字页及采购明细清单页等）或中标通知书，否则不得分。合同时效以合同签订日期或约定的合同生效日期为准。</p>	5

3、评审结果

评委单独打分，汇总上述得分，按总分由高至低的顺序确定中标候选人。若出现两个投标人综合得分相同的情况，则依比较投标报价、方案响应、承诺、类似业绩确定排序。

4、政府采购政策

4.1 本项目非专门面向中小型企业采购。残疾人福利性单位、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参与时应出具属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位参与时应出具残疾人福利性单位声明函。不提供证明文件或声明函评审时不予认定。

4.2 中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②)投标人须提供中小企业声明函，以此为依据享受政府采购政策。

4.3 监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

4.4 残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库(2018)141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

②)投标人须按照财库(2018)141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并

对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。（4）投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4.5 节能产品、环境标志产品政策

①节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

②环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

③投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

④若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

⑤同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

⑥节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

⑦获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.6 价格优惠比例

①投标企业优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 20%的扣除（不重复优惠，最高为 20%），用扣除后的价格参与评审。

②投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予 6%的扣除（不重复优惠，最高为 6%），用扣除后的价格参与评审。

5、特殊情况的处理

5.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；
- (3) 投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；
- (4) 投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；
- (5) 投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；
- (6) 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；
- (7) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

5.2 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（核心产品指各投标人所投相同产品的价格总和均超过各自投标总价 60% 的产品。）

5.3 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
- (6) 评审委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评审委员会应当书面要求投标人在规定

的时间内予以澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

5.4 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

5.5 评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，各种数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

5.6 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- (1) 资格性检查认定错误；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 评标委员会对客观评审因素评分不一致的；
- (5) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报本级财政部门认定。

5.7 中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第四章采购内容及要求

区域心电业务平台及心电图设备				
序号	工程名称	工作内容	工程数量	单位
1	区域心电 智慧平台 系统	<p>一、平台系统</p> <ul style="list-style-type: none">1. 系统采用BS/CS混合架构，充分利用不同架构的优势，提升系统稳定性和交互性。2. 系统支持：公有云，私有云，混合云等多种性质服务器环境。3. 系统支持国产操作系统、国产数据库。4. 系统具备优秀的操作体验，提供UI风格、字体大小、主题颜色等自定义配置。5. 系统对功能调试、数据追溯、问题定位等应用提供技术支撑，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理。6. 能够与医院现有的信息系统(如HIS、PACS、EMR、体检、CA、集成平台等)进行对接和数据交互，支持≥ 7种对接方式，至少包括：视图、表、存储过程、Webservice、API、DICOM、HL7等。7. 为实现数据应用拓展和二次利用，软件可接收、传输和处理DAT、FDA-XML、DICOM、PDF、ECC、JSON、ANB等格式的数据文件。8. 系统提供多样化的消息提醒，包括弹窗、语音提醒等，并支持历史消息查看、查询，便于信息追溯消息提醒可自定义配置，用户可以结合实际需求调整消息提醒方式。9. 为保证系统平台的整体性和扩展性，心电网络系统应能接入静息心电、动态心电、动态血压、动态心电/动态血压二合一、运动心电、实时心电、监护心电、胎儿心电等设备，具有对应检查特点的专业分析工具，实现设备原始数据在同一套系统的分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片段数据。10. 避免因检查端与诊断端时间不一致导致医疗纠纷，系统应具备时间同步管理机制，支持一体化设备、客户端与服务器自动保持时间同步，并提供时间管理二次判别进行双重保障。11. 心电网络系统具备可持续优化的分析算法和深度学习模块等。 <p>二、网络安全</p> <ul style="list-style-type: none">1. 系统具备信息安全管理保障体系中最高级别保护措施，保障信息系统机密性、完整性和可用性。	1	套

	<p>2. 系统支持对数据库的备份还原操作，防止因计算机故障而造成的数据丢失及损坏。</p> <p>3. 系统具备完善的安全管理策略，权限管理功能包含重要操作权限设置，角色权限自定义等。</p> <p>4. 系统支持多种加密传输方式，包含HTTPS、SFTP等，保证数据传输安全及有效。</p> <p>5. 系统提供界面可视化的安全设置，包括连续登陆失败锁定、在线时效、长时间无操作自动退出软件等，保护账户安全性，方便用户安全管理。</p> <p>6. 支持患者敏感隐私信息管理，严密保护患者隐私信息。</p> <p>三、病例管理模块</p> <p>1. 支持按照登记时间、上传时间、诊断时间、审核时间、发起会诊时间、发送危急时间、下发采集盒时间检索申请单。</p> <p>2. 支持申请单锁定功能，避免不同医生同时操作同一份数据。</p> <p>3. 支持在登记患者信息时快速选择临床症状，供诊断医生参考。</p> <p>4. 针对胸痛患者，在录入时可以勾选胸痛，自动启动胸痛紧急优先流程，诊断医生可以收到胸痛患者到达提醒，便于优先处理：系统可针对特殊患者做优先处理。</p> <p>5. 支持在病例申请单管理界面快速查看申请单测量值以及诊断信息，不需要进入波形分析界。</p> <p>6. 支持选择已采集的病例生成分享二维码，通过手机扫码即可打开波形原始数据查看分析。</p> <p>7. 支持检查、诊断自定义置顶设置，针对紧急病人可以设置为优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识。</p> <p>8. 支持申请单手动加急处理，针对加急申请单可特殊标识便于识别。</p> <p>9. 系统支持自定义病例列表，支持自定义保存多组申请单筛选条件，可以快速在不同预设条件之间切换，并支持将筛选条件设置为科室公共条件，便于共享。</p> <p>10. 支持病例列表字段名称自定义配置，满足医院特定需求。</p> <p>11. 支持导出病例申请单详情，导出字段可自定义配置。</p> <p>12. 支持按照患者来源、科室、检查项目等配置诊断超时时间，针对超时诊断申请单，具有标识提醒。</p> <p>13. 支持同时显示不同状态申请单的数量(至少包括配戴中、危急、未检查、未诊断、未匹配、待审核、已审核等)，便于直观了解各个环节工作状态。</p> <p>四、消息提醒</p> <p>1. 具备消息类型，消息模板，消息提醒自定义配置能力，通过站内信方式告知对应责任人，且支持对过往消息集中存储和维护。</p> <p>2. 具备院内公告和系统通知能力，可实现院内重要信息及时告知对应的医护人员，并做好归档查看，便于后续追溯。</p> <p>3. 具备消息提醒自定义配置能力，至少包括消息类型，消息紧急程度，消息推送方式，消息提醒频次，</p>		
--	---	--	--

	<p>消息提醒对象，消息提醒方式：便于灵活适配不同类型的用户群体。</p> <p>4. 具备根据医生职责自定义配置消息提醒内容及提醒方式的能力，以防医生遗漏申请单，提高申请单处理效率。</p> <p>5. 具备未读消息和已读消息区分，且未读消息应有明显标识提醒医生。</p> <p>6. 具备未读消息一键已读力，已读消息根据消息类型及时间检索查看。</p> <p>五、数据采集</p> <p>1. 提供多种导联体系可选，包括标准Wilson单极胸前导联体系、Cabrera双极肢体导联体系。</p> <p>2. 系统兼容广泛的心电检查设备，支持≥ 10种静态心电设备采集类型，至少包括节律心电、心率变异、心电向量、晚电位、药物试验及同步九导、十二导、十五导、十六导、十八导等。</p> <p>3. 系统支持特殊人群的心电检查，支持≥ 9种导联模式，至少包括正常、幼儿、S5、位置性Q 波、上移一肋间、上移两肋间、右心、下移一肋间、下移两肋间等。</p> <p>4. 系统提供灵活简捷的18导心电检查方案，支持使用标准12导心电设备生成18导数据，至少包括合并、续检、推算方式，以减少临床负担。</p> <p>5. 系统具备心电信号质量检测功能，可通过弹窗、波形变色、结论描述等方式，提醒医生了解导联连接状况。</p> <p>六、数据分析模块</p> <p>1. 提供丰富的测量分析值显示、打印，基本测量值至少包括HR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV6/SV2振幅；详细测量值包括HR、Pa、P' a、Qa、Ra、R' a、Sa、S' a、Ta、T' a、Pd、P' d、Qd、Rd、R' d、Sd、S' d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STi、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80。</p> <p>2. 提供≥ 5种QTc计算公式，以适应临床针对心率、种族、性别等因素选择合适QT校正公式。</p> <p>3. 提供多项算法自定义设置，至少包括心动过速、心动过缓、P波时限阈值设置，电轴计算方法和算法灵敏度，满足医院本地化人群特性设置。</p> <p>4. 提供多种分析工具，至少包括：梯形图生成技术、平均模板分析、单心搏分析等，以辅助医生分析诊断。</p> <p>5. 提供ST段专用分析工具，可以利用ST-MAP、ST-VIEW等工具通过横切面、柱状图分析诊断 ST段的异常改变。</p> <p>6. 为满足科室各项业务开展需求，系统支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异等高级分析诊断功能，并打印对应报告。</p> <p>7. 系统应提供可以同时获取间期、振幅、心率等信息的测量工具，方便医生分析测量。</p> <p>8. 方便医生判别，当心率大于心动过速判断上限及小于心动过缓判断下限时，心率值应以标红、加粗等方式提醒。</p> <p>9. 方便医生对配戴起搏器的病人进行精准分析，软件应支持起搏分析。并显著标识起搏信号。</p> <p>10. 提高医生工作效率，系统具备自动预诊断及高级功能分析自动预诊断。</p>		
--	--	--	--

	<p>11. 提高医生书写速度, 系统满足但不限于记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、附带常用 符号小键盘等快捷录入方法。</p> <p>12. 便于医生在书写报告时规范、标准、灵活、快捷简便, 系统提供: 心电常用诊断模板、心 电常用诊断术语、诊断术语库可自定义修改应用。</p> <p>13. 支持公共术语库模板和个人术语库模板自定义维护</p> <p>14. 系统支持电极反转。且支持反转后数据重新分析, 导联接错不需要重采集, 减轻医生负担。</p> <p>15. 减少人工分析时间, 系统具备重新诊断、任意选取波形重新分析、手动修改测量参数自动 进行结果修正等。</p> <p>16. 系统支持同一病人历史检查同屏调阅与对比。</p> <p>17. 波形分析界面支持包括纵向和横向模式等多种排版设置, 满足不同用户个性化需求。</p> <p>18. 提供多种打印报告模板, 具有12*1、3*4、6*2、3*4+1、3*4+3、6*2+1、6*1、6*3、6*3+1、6*2+6*1、6*2+1+6*1、12*1+6*1、15*1、3*5、3*5+1、3*5+3、6+6+3、6+6+3+1、6+9、6*1、长导联(一节律), 长导联(三节律)等20种以上的报告格式, 并支持节律导联报告的打印。</p> <p>19. 提供心电图报告自定义设置, 支持报告模版自定义, 生成的报告可以支持诊断医生单签名 或双签名 , 至少包括: 添加特征描述显示、添加医院logo信息, 支持网格、波形背景、波形 颜色、彩色打印等设置。</p> <p>20. 支持动态心电、动态血压二合一分析, 在同一分析界面可以同时查看心电、血压数据, 通过点击血压数据可以快速定位到对应时间点的心电数据, 便于心电血压关联分析。</p> <p>七、危急值管理</p> <p>1. 系统支持危急值参数自定义设置, 危急值自动预警, 紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能。</p> <p>2. 系统具备危急值闭环管理, 经诊断医生确认的危急, 可推送危急信息至临床提醒关注。</p> <p>3. 支持心电数据自动分析, 针对危急申请单, 可以采用弹窗、语音等不同方式提醒。</p> <p>4. 支持危急值接收以及接收超时提醒。</p> <p>八、会诊</p> <p>1. 支持多种类型的远程会诊, 至少包括静息心电、动态心电、动态血压、动态心电/动态血压 二合一、运动心电、实时心电、监护心电、胎儿心电等。</p> <p>2. 支持多种场景远程会诊, 至少包括多级会诊、多个会诊医院选择等。</p> <p>3. 在心电数据中心的基础上建立远程诊断中心, 支持基层医院与诊断中心医院的心电远程诊断、远程会诊业务流程, 诊断中心可以接受所管理的区域内的疑难心电会诊请求。</p> <p>九、质控管理</p> <p>1. 检查类型、数据采集、报告诊断、超时提醒、统计分析、生成质控报告等全流程质控管理。</p> <p>2. 系统具备采集质量智能分析功能, 对心电图采集质量进行自动评判, 至少包括: 优秀, 良好, 差等等级判定, 并可对系统智能评判结果进行调整, 满足临床对心电采集质量管理需求。</p>		
--	--	--	--

	<p>3. 避免时间错误导致可能的医疗纠纷，系统提供时间校验方式。内容至少包括系统检测到设备时间与当前时间不符给予提醒，在系统内可修改正确时间，时间校验支持多款医疗设备。</p> <p>4. 申请单超时提醒，可根据不同患者来源(如门诊，住院，体检，急诊，其他)、不同检查项目(如静态心电，动态心电，动态血压，动态心电血压二合一，胎儿心电，实时心电，运动心电，电生理项目)区分配置超时提醒时间，避免紧急申请单延误诊断，符合时间质控管理要求，可在病例列表显著显示超时病例。</p> <p>5. 具备多维度质控统计分析，至少包括数据质控、时间质控、报告质控，可输出质控报告，科室根据质控报告及时发现问题，解决问题，促进科室质控管理高质量发展。</p> <p>6. 可配置质控数据抽样库，包括报告结论与自动结论不符的阳性病例，报告结论与术语库不一致的阳性病例，阳性病例及正常病例等。</p> <p>7. 可配置质控数据抽样方式，至少包括抽取比例和抽取数量等，针对病例比较多的情况下，采用抽查方式，质控管理更加灵活，利用抽样方式运用大数据分析原理，减轻质控管理的工作量，又保证质控管理的质量。</p> <p>8. 对于质控病例可进行专项管理，方便质控病例查询，调取，导出等相关操作。</p> <p>9. 系统可合理利用各类数据进行统计分析，输出各类统计报表，至少包括工作量统计、质控统计、危急值统计或其他医院自定义数据分析统计。</p> <p>十、数据统计</p> <p>1. 为管理者依据统计数据优化资源配置，人员绩效评估，提高运营效率，保障医疗服务质量。系统统计分析模块，可以分别查看科室、医生、设备的检查量、诊断量等数据。</p> <p>2. 系统统计分析模块可以根据检查时段、诊断时段等类型进行工作量统计，并可按小时、日、周、年等周期统计出工作量分布情况，便于管理者合理安排工作。</p> <p>3. 支持多种检查类型的危急值相关信息统计，至少包括静态心电、动态心电、动态血压、运动心电等，并提供正常、危急的占比数据。</p> <p>4. 具备多维度的心电质控数据分析，至少包括采集质量质控，上传时效质控，超时报告质控，报告质量质控，质控比例，数据统计分析等。</p> <p>5. 为方便科室管理，统计分析结果可用EXCEL等文档形式导出。</p> <p>十一、教学收藏</p> <p>1. 系统支持对病例进行收藏和管理，并可以对收藏病例进行类别筛选、可查看原始波形及诊断信息、报告打印等操作。</p> <p>2. 病例收藏功能支持按照公共、科室、个人等多个级别进行收藏，满足不同场景和需求下收藏病例的维护和管理。</p> <p>3. 可根据心电图诊断结论进行收藏，包括起搏、房颤、室早、房早、心率不齐等常用结论或用户自定义，方便用户按不同病例类型进行科研教学。</p>		
--	--	--	--

	<p>4. 可根据不同检查类型, 如静态心电、动态心电、动态血压、动态心电/动态血压二合一、运动心电、实时心电、监护心电、胎儿心电等进行分类数据收藏。</p> <p>十二、数据驾驶仓</p> <ol style="list-style-type: none"> 利用大数据可视化系统, 通过对医院心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘, 为院内的业务开展和资源分配提供数据支撑。 支持根据机构、诊断中心查看报告检查量、诊断、诊断来源、危急值, 支持饼状图、柱状图、曲线图等多种方式展示。 通过曲线展示诊断病例历年诊断趋势, 阳性/危急占比统计直观展示。 可根据医院使用需求自定义配置其他监测模块。 <p>十三、电生理模块</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持接入多种电生理设备/工作站。接收多份电生理报告。生成规范的电子化报告, 进行数据统一管理, 电子报告支持多级审核及双签名, 且支持自动归档到病例归档系统。 支持角色访问控制管理功能, 具备有效控制不同类型用户访问行为和权限的一体化集中管理方式, 且角色权限可自定义。 支持检查项目权限管理控制, 可按照科室/用户不同级别控制不同用户可查询操作的检查申请单类型。 支持通过机读设备自动获取门诊患者检查申请及基本信息、诊断信息、检查要求, 支持自动获取HIS住院患者检查申请信息。 患者信息一键注入第三方电生理工作站能力, 支持自定义多种注入规则, 灵活适配多厂家。 支持接入多种电生理设备/工作站, 至少包括动态心电、动态血压、脑电图、肺功能、骨密度仪、经颅多普勒(TCD)等。 支持同时接收多份电生理报告进行归档。并支持多种方式查询电生理报告进行浏览和打印, 至少包括客户端和web端。 支持自定义多种检查项目的电生理报告格式。 术语库具备自定义能力, 每一种电生理检查项目均支持自定义术语库。 具备悬浮窗功能, 快速进行患者信息登记。 具备数据统计能力。至少包括工作量统计, 阳性率统计, 报告质控统计, 危急值统计, 并支持输出完整的统计报表。 支持自定义列表字段显示及顺序, 提供申请单多条件组合搜索并保存为公共搜索条件。 <p>十四、云诊</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持移动终端上进行分析诊断, 便于医生随时随地进行心电图的诊断或会诊。 具备消息弹窗, 便于医生及时收到待处理申请单。 具备分析诊断常用工具及设置, 至少包括: 波形放大、波形测量、增益调整、走速调整、导联布局等。 		
--	---	--	--

		<p>4. 可对病例进行标记，至少包括采集质量、阳性、危急、胸痛等类型。</p> <p>5. 内置诊断术语库，包含心律不齐、QRS轴转、心室肥厚、房室传导阻滞、室内传导阻滞、心肌损伤、心肌梗死等≥7种分类200多条常用诊断术语。</p> <p>6. 支持心电数据重分析功能。</p> <p>7. 支持12导心电采集设备通过续检或加做导联，全面观察患者右胸及后壁心电波形。</p> <p>8. 具有导联接错的修复功能，无需重新采集心电。</p> <p>9. 提供小程序二维码的方式快速分享报告，方便医生协助诊断或远程会诊。</p> <p>10. 可获取同一病人历史心电检测记录，方便医生对比分析。</p> <p>十五、实时心电</p> <p>1. 平台端可实时查看采集盒设备状态，至少包括电量、网络信号等便于后台监护人员，及时联系患者，避免监护数据中断风险，降低外在因素对检测结果造成不良影响。</p> <p>2. 支持实时预警，检测到心律失常等异常时报警提醒，同时系统可通过弹窗、语音等方式通知医生，并可查看分析异常片段图。</p> <p>3. 支持采集盒数据自动摘机功能，将采集数据自动导入转化为动态心电进行分析。</p> <p>4. 支持云摘机功能，医生可在设备归还之前使用云端数据分析出具动态心电报告。</p> <p>5. 系统支持接受设备上传的SOS信息，可将紧急情况采用短信方式通知到医生和紧急联系人。</p> <p>6. 支持在移动端查看实时心电波形及片段图回顾。</p> <p>7. 支持在实时心电监护过程中，对过往监护数据进行整体回顾。</p> <p>8. 可以实时查看配戴状态，如剩余佩戴时长、患者体位、导联连接状态等。</p> <p>9. 支持实时传输、定时间隔、自动触发、手动触发等不同工作模式。</p> <p>10. 提升临床工作效率和避免病人信息匹配出错，系统应支持登记患者信息到采集盒，采集盒于数据采集结束后连接电脑，系统自动接收心电数据，完成数据匹配。</p> <p>11. 支持用户配置同一消息类型在设定时间内不重复提醒。</p> <p>12. 支持储存单个病人监护过程中的全部实时心电数据，便于医生查看与诊断。</p> <p>13. 平台支持多参数实时监测，至少包括心电、血氧、血压、呼吸等。</p>		
2	智能心电图机	<p>1. 幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控。</p> <p>2. 高清分辨率，显示像素≥1920*1200。</p> <p>3. 外部接口：USB接口x2, 18导接口x1, Type C接口x1, 有线网络接口x1。</p> <p>4. 无线传输，蓝牙4.2. 无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac</p> <p>5. 移动通信：需内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。</p> <p>6. 内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登录、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。</p> <p>7. 机器需便携，(含热敏打印)重量≤2.5kg。</p> <p>8. 整机需配置标准化台车或便携箱，满足病房巡检。</p>	3	台

	<p>9. 心电采集器内置在主机里, 不接受外置采集盒的方式。</p> <p>10. 内置热敏式点阵打印机, 可以打印3x6、9x2、6x3+1R、18x1等心电波形和报告。</p> <p>【硬件参数】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 导联模式: 18导联同步采集, 支持wilson和cabrera两种导联体系。 2. 输入阻抗: $\geq 100\text{MQ}$。 (10Hz) 3. 频率响应: $0.01\text{Hz} \sim 500\text{Hz}$, -3dB。 4. 定标电压: $1\text{mV} \pm 2\%$。 5. 耐极化电压: $\geq \pm 900\text{mV}$ ($\pm 5\%$) 6. 内部噪声: $\leq 12.5 \mu\text{Vp-p}$。 7. 时间常数: $\geq 5\text{s}$。 8. 共模抑制比: $\geq 140\text{dB}$。 9. 除颤保护: 具有抗除颤电击保护功能。 10. A/D转换: 24位。 11. 心电波形采样率: $\geq 60,000 \text{ Hz}$, 每导联: 具有起搏检测功能, 起搏采样率: $\geq 70,000\text{Hz}$, 每节律导联。 12. 灵敏度/增益: (1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5mm/mV, 10mm/aV, 20mm/mV, 10/5 mm/mV, AGC) $\pm 5\%$。 13. 设备内置存储器: $\geq 32\text{GB}$内存, 存储病历不小于100000例(10秒静态心电)或20000例(60秒静态心电)。 14. 外部扩展: 支持外接U盘扩展存储空间, 支持SD卡存储。 15. 交流电源: 交流100V~240V, 50Hz/60Hz, 直流电源: 锂电池, 电池额定电压$\geq 12\text{V}$ 16. 内置可充电锂离子电池, 额定容量$\geq 50\text{Wh}$, 额定电压$\geq 15\text{V}$, 充足后可正常工作时间$\geq 8\text{小时}$, 充分保证出诊和查房使用。 		
3	<p>基层医疗机构智能网络心电图机</p> <p>1. 导联数量: 标准12通道同步采集。</p> <p>2. 采集模式: 支持12导联静态心电、动态心电、运动心电和远程实时监测四种模式。</p> <p>3. 采集时间: 常规模式支持10秒/15秒/30秒/60秒可选, 动态模式支持24小时/48小时记录, 采集时间和采集模式均以记录器屏幕设置。</p> <p>4. 采样率: 最高可达$\geq 60000\text{Hz}$/每通道。</p> <p>5. 起搏采样率: 最高可达$\geq 60000\text{Hz}$。</p> <p>6. 具备A/D转换功能: 24位; 频率响应: $0.01\text{Hz} \sim 500\text{Hz}$, 7. 耐极化电压: $\geq 960\text{mV}$。</p> <p>8. 内部噪声: $\leq 12.5\mu\text{Vp-p}$。</p> <p>9. 彩色触摸显示屏, 显示终端≥ 10英寸, 至少支持单点触摸、单击、长按操作, 实时显示心电波形和工作状态。</p> <p>10. 通讯方式: 支持USB通讯电缆、WIFI、4G、蓝牙等三种以上通讯方式。</p> <p>11. 锂电池工作时间: 连续记录时间$\geq 48\text{小时}$。</p>	10	台

		12. 联网自带WIFI模块连接医院局域网，数据直接传输到医院系统中。 13. 分析软件具有WORKLIST、导联纠错、危急值提醒功能。 14. 分析软件具有十二导联同步心电图的采集、频谱心电、高频心电、QT离散度、心率变异性、起搏心电、向量心电、时间向量、心室晚电位功能。 15. 软件提供联网功能，可实现数据实时采集并传入网络，实现数据远程实时传输、存储共享。 16. 配备专用推车，支持推车或便携工作模式。		
4	现有设备接入系统	支持原有心电设备接入系统	4	套
5	心电网络系统应用服务器	1. 操作系统：国产操作系统 2. 数据库：国产数据库 3. 处理器：国产芯片 4. 内存：≥64G DDR43200内存 5. 硬盘：≥3块4TSATA企业级硬盘 6. 网卡：双口千兆 7. 阵列卡：支持RAID 0.1.5 8. 电源：800W冗余电源	1	台
6	区域远程心电系统前置服务器	1. 处理器：≥10核16线程 2.0GHz 2. 内存：≥16G 3. 可用磁盘空间：≥200G 4. 互联网带宽：≥20M 5. 操作系统：国产服务器操作系统V20 6. 浏览器：>Google Chrome80 7. 网络端口设置：Inter_Nginx(9545) ImdoPatient-Nginx(9001)、微信对接（80或者443端口） 8. 其它软件：7-ZIP压缩软件 9. IP设置：固定IP，一般不允许修改	1	台
7	心电诊断中心电脑	CPU主频：3.0GHz CPU线程数：16 CPU核数：8核 CPU缓存：L3 内存频率：3200MHz 内存类型：DDR4 内存总容量≥16GB 固态硬盘总量≥512CB	25	台

		显卡类型: 独立显卡 显存容量 $\geq 2G$ 显示器尺寸(英寸) ≥ 23 最大分辨率(垂直) : 1080 最大分辨率(水平) 1920 色深: 8bit 刷新率 $\geq 75Hz$ 显示屏分辨率:1920*1080		
8	多功能一体机	1. 支持打印、复印(可自动单面复印)、扫描 2. 支持无线打印, 扫码打印, 漫游打印, 云打印 , 打印分辨率和扫描分辨率都为1200*1200dpi 3. 额定功率 $\geq 946W$ 4. 打印速度 ≥ 23 页每分钟 5. 内存128MB 6. 纸张容量 ≥ 150 页 7. 耗材鼓粉一体可打印3500页 8. 纸盒可放: A4, A5, A6, B5, B6 9. 接口: 支持无线直连和对等网络	1	台
9	区域心电 数据展示 大屏 (85 寸)	1. 产品尺寸: 85 寸 2. 产品特色: 4K 全面屏、双重护眼认证、远场语音、远程开关机、蓝牙、低蓝光认证 3. 电压输入范围 220V 4. 额定功率: 220V~ 2A 5. 待机功率 : <0.5W 6. 屏占比 : 96.4% 7. 分辨率: 3840*2160 8. 整机亮度(典型值) : 300nits 9. 亮度均匀性 $\geq 55\%$	1	台

区域审方中心

序号	工程名称	子项	详细要求	工作数量	单位
1	区域合理用药检测系统	处方审核	系统应能监控各医疗机构系统审查出的不合理用药问题的发生情况，应能按照问题类型和严重程度进行分类统计。		
		药师审方	系统应能监控区域、各医疗机构处方审核干预情况，应能追踪干预效果，实现当日动态监测		
		处方点评	系统应能监控各医疗机构门诊、急诊、出院点评率与合格率		
		用药指标	系统应能监控各医疗机构用药指标，包括抗菌药物使用率、抗菌药物使用强度、I类切口手术抗菌药物预防使用率、特殊使用级抗菌药物使用量占比、微生物送检率、基本药物处方占比、基本药物使用率、基本药物使用占比、国家基本药物配备使用金额比例、中药饮片使用率、门诊中药处方比例、门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例	1	套
		可视化大屏	系统应支持可视化大屏展示		
2	区域共享患者档案系统	共享档案	系统应提供区域患者共享档案，包括患者在各医疗机构的个人信息、健康摘要、医嘱、检验、检查等信息		
		处方（医嘱）用药审查功能	▲系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN 处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药（重复成分、重复治疗）审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、监测指标审查、越权用药审查、围术期用药等审查，并提示医生。		
		药品信息提示功能	可快捷查看药品相关重要信息；药品厂家说明书；查询相应药品的中药材专论信息。	1	套
		质子泵抑制药专项管控	医生开具质子泵抑制剂药品时，需填写用药评估单。提供评估单专项统计分析。 系统可评估患者病症状态，若存在应激性溃疡风险，提供质子泵抑制剂用药建议。 围术期不合理使用质子泵抑制剂时，系统可警示医生。		
		协定方专项管控	系统提供医院中药协定方证型适宜性审查。		

		经验性用药专项管控	系统提供抗肿瘤药物过敏反应预处理用药合理性审查。		
		抗菌药物专项管控	医生开具预防用抗菌药物时,需填写用药物评估单,评估单区分非手术预防用药和手术预防用药。 系统提供抗菌药物用药物指征审查。医生开具抗菌药物必须有用药指征,否则系统将予以警示。		
		审查提示屏蔽功能	▲系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、不良反应、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药等审查项目进行审查提示屏蔽,支持分门诊、住院、急诊屏蔽,屏蔽后不再对相同问题进行提示。		
		审查规则 自定义功能(医院专家 知识库)	系统可以提供多种自定义方式: (1) 基于系统审查数据自定义方式,节省药师工作量。 (2) 可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。 用户可自定义药品警示、拦截规则,被拦截的问题处方必须返回修改,否则不可进行下一步操作。用户可设置已执行的长期医嘱是否拦截。 规则复制功能:系统支持将其他药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。 豁免对象:可根据药品、医生、科室等条件设置特定对象不参与某些模块审查,并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。 自定义规则查询:可查询药品、科室以及各模块的自定义规则。		
		统计分析功能	问题处方(医嘱)保存、查询,以及不合理问题统计分析。 用药理由统计		
		区域合理用药审查	支持结合多个机构的历史处方做审查,结合病人在不同机构的过敏信息进行药物过敏审查。 支持区域内共用一套审查规则,无需各机构分别制定审查规则。		
3	区域药师审方干预系统	审方时机和过程	系统可以为药师提供专门的审方工作平台,帮助门诊药师在患者缴费前完成门诊处方实时审查、住院药师在护士领药前完成住院医嘱审查。系统先自动审查出问题处方(医嘱),再由药师人工审查,审查过程中药师可以与医生实时互动,直到处方(医嘱)通过。必要时,药师可同时接收门诊、住院任务。	1	套
		审方干预功能	1. 系统可主动分配任务给药师,任务来临时可用弹框提醒药师,点击弹框后即可跳转至审方页面。 2. 药师审查时,可在审查界面一体化查看当前处方(医嘱)历史干预记录,如医生操作、用药理由等。 3. 药师审查时可查看当前处方(医嘱)历史修改版本信息。		

			<p>4. 药师可以根据不同任务情况选择医生处方（医嘱）直接双签通过还是需要药师复核。</p> <p>5. 系统支持根据医生提交至药师处的中药处方智能检索近似经典方剂供药师参考。</p>		
		质量评价功能	<p>1. 系统提供多种筛选方案设置功能，进行待评价任务筛选。评价人可对每个任务输入审核意见并打分。系统可自动生成任务评分表，并可导出到 Excel。</p> <p>2. 评价人可评估历史审核任务并设置问题推荐处置方案，供审方药师审核同一问题时参考。</p>		
		审方干预自定义功能	<p>1. 可将任意科室、医生、患者、疾病、药品设置为重点关注，可按科室、医生、患者、疾病、药品、问题类型、警示级别多条件组合设置重点关注，包含重点关注信息的处方由药师进行全面审查。</p> <p>2. 用户可根据使用习惯进行个性化设置，如任务提示音（支持上传），处置按钮顺序及样式，审方界面字体及颜色，发送给医生的常用语等。</p> <p>3. 用户可设置自动干预模式，并设置医生填写用药理由的模式。药师不在岗时，系统自动干预，医生填写用药理由后方可执行，支持全院和分科室设置。</p>		
		患者信息查看	<p>1. 药师审方界面：可查看患者基本信息、患者过敏史、手术信息、检验检查信息、会诊信息，检验结果异常项可单独显示。可链接 EMR 系统查看患者详细信息。</p> <p>2. 可标记门诊特殊病人。</p> <p>3. 可标记慢病处方。</p> <p>4. 药师审查时可查看当前患者的其他处方。</p>		
		系统审查	系统审查项目、规则等应与医生端审方系统保持一致，并能实现无缝对接，即药师端可查看医生端审方系统的详细审查结果信息，同时药师审核问题标准可按医生端审方系统的审查项目和问题级别进行设置。		
		统计分析	可以分别统计门诊、住院任务的审核率、干预率、合格率等重要指标，并可提供统计图。可按照科室、医生、药品、药师、药物类进行干预情况分类统计。		
		区域审方	<p>1. 支持审方中心的药师收到多家机构的处方/医嘱，进行集中审方。</p> <p>2. 药师审方时，可查看患者在区域内其他机构就诊的处方，并且可查看到审方处置意见推荐。</p> <p>3. 可对区域内药师审方结果进行质量评价和一致性评价。</p> <p>4. 支持区域审方情况数据合并统计，也支持分机构单独统计。</p>		
4	区域处方点评系统	处方点评	<p>1. 系统应结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。</p> <p>2. ▲系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互</p>	1	套

		<p>作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN 处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提供审查规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。</p> <p>3. 系统应能实现从抽样、分配、求助、专家复核、反馈医生、医生申述、药师审结的点评闭环管理，并在点评求助、复核完毕、反馈医生、医生申述的环节进行消息提示。</p> <p>4. 系统应支持点评任务随机分配、按管辖科室、药品分配，点评人只能查看自己相关的任务，无权查看他人的任务信息。</p> <p>5. 系统应提供双盲点评，在需要时隐藏医生、药师的姓名。</p> <p>6. 系统应提供逾期设置，规定医生处理点评结果的时间期限。</p> <p>7. 系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。</p> <p>8. 系统应能自动生成住院患者用药联用图，直观查看药品使用（联用）情况，联用图支持自定义。</p> <p>9. ▲系统应能自动生成住院患者时序图，包括患者体征（体温、脉搏、呼吸、疼痛评分、血糖、出/入量、血压）、用药、手术和检验信息，时序图支持自定义。</p> <p>10. 系统应能高亮显示被点评药品，当选择某一（类）药品时，将其成组药品一并显示。</p> <p>11. 系统应支持处方（医嘱）批量点评，应能将点评结果反馈医生或科主任，医生（工作站）可直接填写申述理由或确认，无需登录系统查看点评结果。</p> <p>12. 系统应支持增补处方或病人，将需要的处方或病人批量添加至点评任务中。</p> <p>13. 系统应能自动生成点评工作表、点评结果统计表、存在问题统计表、点评结果差异明细表、点评问题明细表。点评相关报表支持自定义显示和导出字段。</p> <p>14. 系统应能自动生成个人任务完成情况表、点评任务完成情况表、医生反馈统计表、点评结果汇总统计表等管理报表。</p> <p>15. ▲系统应包含以下点评模块：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 全处方点评 (2) 全医嘱点评。 (3) 门急诊/住院抗菌药物专项点评，含药物选择不合适、无适应症、药物选择不符合抗菌药物分级管理、联合用药不适宜、更换药物不适宜、用药效果欠佳等点评点。 (4) 围手术期抗菌药物专项点评，含选药不合理、预防药物更换不合理、术前给药时机不合理、术中用药不合理、手术预防用药疗程不合理等点评点。 (5) 门急诊/住院专项药品点评，可点评任意（类）药品。 	
--	--	--	--

		<p>(6) 门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评，含医师超权限使用抗肿瘤药、用药顺序错误、化疗方案不合理等点评点。</p> <p>(7) 住院病人特殊级抗菌药物专项点评。</p> <p>(8) 住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评，应能针对适应证、品种选择、用法用量及配伍、病原学及疗效评估、用药权限与会诊等评价项目进行人工评价及自动扣分。</p> <p>(9) 住院病人人血白蛋白专项点评。</p> <p>(10) 门（急）诊/住院中药饮片专项点评，含超过规定味数、未按照君臣佐使顺序书写、用药与辨证不符、中药配伍禁忌、联用不适宜或者不良相互作用、未按要求标注药物调剂和煎煮特殊要求、开具毒麻饮片未执行国家有关规定等点评点。</p> <p>(11) 门（急）诊中成药处方专项点评。</p> <p>(12) 用药排名医嘱点评，应能对门急诊/住院使用金额、数量或 DDDs 排名前 N 位的科室和医生开具的处方（医嘱）进行点评。</p> <p>(13) 住院用药医嘱点评。</p> <p>(14) 出院带药医嘱点评。</p> <p>(15) 门（急）诊基本药物专项点评，含用药方案与《国家基本药物临床应用指南》不一致等点评点。</p> <p>(16) 住院病人肠外营养专项点评，可自动计算热量、补液量、氮量、糖/脂肪乳/氨基酸总量、氨基酸供给量、糖脂比、热氮比、丙氨酰谷氨酰胺用量占比、钠/钾/钙/镁/磷/电解质一价及二价阳离子浓度、渗透压摩尔浓度等指标。</p> <p>(17) 住院病人自备药专项点评。</p> <p>(18) 门（急）诊外延处方点评。</p>		
		区域处方点评	系统应支持全区共用一套规则，系统应可抽取单个医疗机构或多个医疗机构的处方或医嘱点评，也可抽取专项药品进行专项化点评；点评过程中系统应可将点评任务分配给区域中不同医疗机构的药师，系统应支持点评人在遇到点评问题时可向上级医院的药师进行求助；点评完成后，系统可以按照区域中的医疗机构生成点评结果的统计。	
5	区域药品使用指标分析系统	统计分析	<p>系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，提供对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。</p> <p>系统利用图文并茂的形式，通过趋势分析、构成分析、主从分析、排名分析等分析手段，提供了大量统计分析报表。</p> <p>系统应提供常用报表收藏及报表人工填写功能。系统应提供报表示例模板，在生成报表前了解统计内容。</p> <p>系统应提供自定义显示和导出报表功能。</p> <p>系统应提供关键字检索功能，便于快速查询指标。</p>	1套

		<p>1. ▲合理用药指标</p> <p>(1) 指标统计</p> <p>1) 系统应提供合理用药相关指标的统计，包括：平均用药品种数、注射剂使用率、特殊级抗菌药物使用率、预防使用抗菌药物病人的百分率、治疗使用抗菌药物病人的百分率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率、X类切口手术患者预防用抗菌药物时间<24h、>24h且≤48h、>48h且≤72h、>72h百分率等。</p> <p>系统应能将上述合理用药指标重新组合并生成新的报表。</p> <p>2) 系统应能按全院、大科室、科室、医疗组、医生分别进行统计。</p> <p>(2) 趋势分析</p> <p>系统应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比分析。</p> <p>2. ▲自定义合理用药指标</p> <p>系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数。</p> <p>3. 药品使用强度统计</p> <p>(1) 药品使用强度统计</p> <p>系统应分别按出院时间（费用使用量）、收费时间（费用使用量）和出院时间（医嘱使用量）统计使用强度。可选择排除结核用药、特殊病人。</p> <p>(2) 药品使用强度趋势变化分析</p> <p>系统应能分别按月度（自然月或非自然月）、季度、半年和年度统计药品使用强度及浮动率。</p> <p>4. ▲药品金额、数量、DDDs统计</p> <p>(1) 药品金额、数量及DDDs使用量统计</p> <p>(2) 药品金额、数量及DDDs趋势变化分析，系统应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品金额、数量、DDDs及浮动率，应能分别提供药品金额、数量、DDDs同比环比分析</p> <p>(3) 药品金额、数量统计并排名</p> <p>5. 药品使用人次统计</p> <p>6. 注射剂/大容量注射液统计</p>	
--	--	--	--

		<p>7. 药品种种/费用构成统计</p> <p>8. 门（急）诊大处方分析</p> <p>可实现超 N 种处方、超 N 元处方、超 N 天处方、超 N 次就诊患者统计</p> <p>9. 抗菌药物使用清单及统计</p> <p>可实现门（急）诊/出院病人及围术期抗菌药物使用情况、送检率（可自定义送检项目）、越权用药情况、抗菌药物使用情况分析等统计</p> <p>10. 基本药物使用清单及统计</p> <p>可实现基药品种数、基物品种总数所占比例等统计</p> <p>11. 麻精药品管理处方登记表</p> <p>12. 国家三级公立医院绩效考核</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 国家三级公立医院绩效考核评价指标 (2) 国家三级公立医院绩效评价指标科室统计表 (3) 国家三级公立中医医院绩效考核评价指标 (4) 剔除药品使用情况统计表 (5) 罕见病用药情况统计表 <p>13. 药事管理专业医疗质量控制指标</p> <p>14. 全国抗菌药物临床应用管理</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况统计 (2) 医疗机构含酶抑制剂复合制剂抗菌药物使用情况统计 (3) 抗菌药物临床应用管理评价指标及要求统计 <p>15. ▲国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 医疗机构一般情况调查 (2) 临床科室指标持续改进情况统计表 (3) 全院使用量排名前十位抗菌药物 (4) 抗菌药物分级管理目录 (5) 临床微生物标本送检率 (6) 医疗机构药品经费使用情况调查表 (7) 医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表 (8) 医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表 (9) 医疗机构 I 类切口手术用药情况清单表 (10) 医疗机构 I 类切口手术用药情况调查表 	
--	--	--	--

			<p>16. 全国合理用药监测系统</p> <p>(1) 药物临床应用监测信息（西药、中成药） (2) 处方监测信息（门、急诊处方） (3) 处方监测信息（医嘱）</p> <p>17. 抗肿瘤药物临床应用情况调查表</p> <p>18. 住院患者静脉输液使用情况抽样</p>		
		区域用药数据分析	系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，并通过接口从HIS系统提取药品、费用等相关信息，在此基础上实现对全区域或单个医疗机构合理用药指标及药品使用情况的信息化统计和分析。		
6	抗菌药物临床应用监测系统	高级填报	▲系统应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，完成抗菌药物临床应用监测网要求的抗菌药物使用情况统计及上报工作。系统应提供手术/非手术抗菌药物使用情况调查表、门诊/急诊/住院患者抗菌药物使用情况统计报表的离线上报功能，可直接上传文档至监测网完成填报工作，避免二次填写。	1	套
		普通填报	系统应提供非手术抗菌药物使用情况调查表、手术抗菌药物使用情况调查表、门(急)诊处方用药情况和住院病人抗菌药物使用情况的数据生成和人工上报功能。		
7	电子药历系统	教学药历	系统应提供教学药历的书写功能，帮助用户快速生成电子化的教学药历；同时，系统应提供教学药历的审阅功能。 教学药历应提供导出功能，方便用户导出电子化文档进行存档。 系统应提供教学药历的模板自定义功能，用户可根据管理需要进行开启、关闭、新增、删除相应字段。	1	套
		工作药历	系统应提供工作药历的书写功能，帮助用户快速生成电子化的工作药历；同时，系统应提供工作药历的审阅功能。 工作药历应提供导出功能，方便用户导出电子化文档进行存档。 系统应提供工作药历的模板自定义功能，用户可根据管理需要进行开启、关闭、新增、删除相应字段。		
		查房记录	系统应提供查房记录的书写功能，帮助用户快速生成电子化的查房记录；同时，系统应提供查房记录的审阅功能。 查房记录应提供导出功能，方便用户导出电子文档进行存档。 系统应提供查房记录的模板自定义功能，用户可根据管理需要进行开启、关闭、新增、删除相应字段。		
		工作量统计	系统应提供教学药历、工作药历、查房记录的书写工作量和审阅工作量的统计功能。		

审方中心硬件

智慧药学服务平台服务器

智慧药学服务平台服务器配置需求		
	2U机架式, 12*3.5"机箱	
CPU	≥2颗国产C86处理器, ≥16C 2.5GHz 135W CPU	
内存	≥2*32GB DDR4 3200MHz, ≥16个内存插槽	
硬盘	≥3块1.2TB 10K SAS 热插拔硬盘	
阵列卡	独立阵列卡, ≥2GB缓存, 支持RAID 0/1/10/5/50/6/60;	
网络	≥双口千兆RJ45网卡; 支持标准 PCIe 1G/10G/25G/40G/100G/200G 网卡	
PCIe插槽	≥4个半高 PCIe 4.0 插槽和 1 个 OCP 3.0 插槽	
电源	≥2*550W电源模块; 2个1.5M国标电源线	
配件	滑轨	

1 台

数据库服务器

数据库服务器配置需求		
日门诊量 (X)	6000>X>2000	
配置	2U机架式, 12*3.5"机箱	
CPU	≥2颗国产C86处理器, ≥16C 2.5GHz 135W CPU	
内存	≥2*32GB DDR4 3200MHz, ≥16个内存插槽	
硬盘	≥3块2TB 7.2K SATA HDD 热插拔硬盘	
阵列卡	独立阵列卡, ≥2GB缓存, 支持RAID 0/1/10/5/50/6/60	
网络	≥双口千兆RJ45网卡; 支持标准 PCIe 1G/10G/25G/40G/100G/200G 网卡	
PCIe插槽	≥4个半高 PCIe 4.0 插槽和 1 个 OCP 3.0 插槽	
电源	≥2*550W电源模块; 2个1.5M国标电源线	
配件	滑轨	

1 台

产品部署服务器

产品部署服务器配置需求		
	2U机架式, 12*3.5"机箱	
CPU	≥2颗国产C86处理器, ≥16C 2.5GHz 135W CPU	

内存	$\geq 2*16GB$ DDR4 3200MHz, ≥ 16 个内存插槽	1	台
硬盘	≥ 3 块1.2TB 10K SAS HDD 热插拔硬盘		
阵列卡	独立阵列卡, $\geq 2GB$ 缓存, 支持RAID 0/1/10/5/50/6/60		
网络	\geq 双口千兆RJ45网卡; 支持标准 PCIe 1G/10G/25G/40G/100G/200G 网卡		
PCIe插槽	≥ 4 个半高 PCIe 4.0 插槽和 1 个 OCP 3.0 插槽		
电源	$\geq 2*550W$ 电源模块; 2个1.5M国标电源线		
配件	滑轨		

前置服务器

前置机配置需求			
	2U机架式, 12*3.5"机箱	1	台
CPU	≥ 1 颗国产C86处理器, $\geq 16C$ 2.5GHz 135W CPU, 支持2颗国产C86处理器		
内存	$\geq 1*16GB$ DDR4 3200MHz, ≥ 16 个内存插槽		
硬盘	≥ 3 块480GB SATA SSD 热插拔硬盘		
阵列卡	独立阵列卡, $\geq 2GB$ 缓存, 支持RAID 0/1/10/5/50/6/60		
网络	\geq 双口千兆RJ45网卡; 支持标准 PCIe 1G/10G/25G/40G/100G/200G 网卡		
PCIe插槽	≥ 4 个半高 PCIe 4.0 插槽和 1 个 OCP 3.0 插槽		
电源	$\geq 2*550W$ 电源模块; 2个1.5M国标电源线		
配件	滑轨		

医生工作站服务器

PC端医生工作站服务器配置需求			
处理器	2颗国产C86 处理器, 单颗处理器 $\geq 12C$ 2.5GHz	1	台
内存	$\geq 2*16GB$ 以上		
磁盘空间	硬盘可用空间480G以上*3 (配置硬盘三块, 做阵列)		
操作系统	国产操作系统		
使用设备	仅支持台式电脑/笔记本电脑, 不兼容平板电脑、智能手机、 surface 等无线移动终端		
浏览器	支持IE8.0及以上		

其他	Super VGA (1024 x 768) 或更高分辨率的视频适配器和监视器。		
移动端医生工作站配置需求（适用于互联网审方）			
处理器	8核2.0GHz及以上		
运行内存	4G及以上		
存储内存	64G及以上		
操作系统	支持: Android10以上、IOS		
使用设备	智能手机		
分辨率	1920x1200及以上		

二、其他要求

- 1、投标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。
- 2、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成责任或费用。
- 3、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、 二次倒运费、吊装费等费用。

第五章 商务要求

条款号	内 容
1	项目名称：吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目（二次）
2	交货地点：甲方指定地点
3	交货期：合同签订后 90日内。
4	<p>1、投标报价：合同价即中标价，投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品（设备）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、验收费用等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>2、付款方式和程序：</p> <p>（1）由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。</p> <p>（2）付款方式：合同签订后预付合同金额的 40%，根据设备运抵交货地点情况最多支付不超过 80%，安装调试完毕，并经甲方验收合格后，完成支付审批手续后，甲方支付乙方剩余的货款。</p> <p>3、履约情况：供货安装完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。</p>
5	<p>质量保证：</p> <p>1. 所供产品必须是经过国家法定质检机构检测的合格产品。并符合国家相关标准。</p> <p>2. 包装要求：符合招标文件中规定的包装要求。</p> <p>3. 供应商提供的货物必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，货源合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供货物工艺质量应严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。</p>
6	<p>验收：</p> <p>由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及货物质量是否达到现行国家有</p>

	<p>关验收规范“合格”标准进行逐项检查。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织验收可邀请省、市专家库专家进行验收，验收期间发生的相关费用均由供应商承担； 2. 所验货物的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应无条件免费退货。 3. 若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。 4. 验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 5. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 6. 验收依据： <ol style="list-style-type: none"> a) 合同文本； b) 投标文件及澄清函、招标文件； c) 国家和行业制定的相应的标准和规范。 <p>货物验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。</p>
7	<p>知识产权：</p> <p>供应商应保证所提供的货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。</p>
8	<p>违约责任：</p> <p>按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>未按合同或招标文件要求提供产品（货物）或供应的产品（货物）质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。</p>

第六章 合同条款

采 购 合 同

甲 方：

乙 方：

年 月

采购合同

(采购人) (全称) : _____ (甲方)

(供应商) (全称) : _____ (乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

1. 概述

项目名称:

1. 1项目地点:

1. 2项目范围: 详见采购清单。

2. 合同采购内容: 附采购清单

3. 合同总价

合同总价款为人民币 (大写) _____ 元。 (小写) _____ 元。本合同总价款包括货物、备件、工具、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、安装、保险、税金，验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 交货条件

4. 1 交货期: _____。

4. 2 交货 (安装、调试、服务) 地点: _____。

4. 3 交货方式: 现场交货，乙方负责办理运输和保险，将设备运抵交货地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

5. 付款方式: 合同签订后预付合同金额的 40%，根据设备运抵交货地点情况最多支付不超过 80%，安装调试完毕，并经甲方验收合格后，完成支付审批手续后，甲方支付乙方剩余的货款。

6. 各方的责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

- (1) 按照合同规定及时足额拨付合同款。
- (2) 负责组织验收。

6.2 乙方的责任和义务

- (1) 按照甲方的规定要求供货。
- (2) 按照规定时间、地点交货。
- (3) 对设备的质量及技术稳定性负责，安装调试及人员培训费用由乙方承担。

7. 质量验收

7.1 乙方应严格按照甲方技术要求和有关标准提供设备，确保产品质量。详细技术指标以招标文件和投标文件。

7.2 甲方按验收规程做出厂抽检验收，这种验收不能降低乙方的责任。

7.3 产品的到货验收工作由甲方负责，验收内容包括：数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（产品说明书、产品出厂合格证等）及包装完整无破损。产品应完好无损。

7.4 设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造单位、名称、型号规格、出厂日期等）。

7.5 设备制造质量出现问题，乙方应负责无偿修理、退换，费用由乙方负责；由此而造成工程进度延误，由乙方承担直接责任。

7.6 乙方需提供安装验收评估报告，并由甲方组织人员会签通过后，视为验收通过。

8. 发货、包装、运输标志

8.1 发货标志。在包装箱上其明显部位做如下标志：

- (1) 出厂编号：
- (2) 设备型号：
- (3) 总共箱（件）数及箱号、台站名：

- (4) 发货单位:
- (5) 收货单位:
- (6) 发货站:
- (7) 到货站:
- (8) 体积: 长×高 (米)
- (9) 毛重及净重 (吨)
- (10) 出厂或装箱日期:

8.2 运输、包装标志: 设备的包装应符合颠簸道路运输要求, 运输标志应按国家规定或部颁标准执行。

9. 技术服务与保修责任

9.1 设备在安装调试及保修期内 (自出厂验收合格后 12 个月) 如发现质量问题, 乙方收到甲方的最终用户函电后, 4 小时内作出答复, 72 小时内排除故障。被服务方向乙方现场人员提供食宿条件, 费用由乙方负责。

10. 违约责任

10.1 乙方延期发货, 除人力不可抗拒的因素外, 乙方应向甲方偿付延期违约金, 每套按设备价格每日 0.2% 支付。

10.2 甲方延期付款时 (有正当拒付理由者除外) 应向乙方偿还延期付款违约金, 每日按滞付金额的 0.2% 计算。

11. 合同生效及其他

11.1 合同经甲乙两方代表签字并加盖公章 (或合同章), 立即生效。

11.2 合同签订后甲乙两方即直接产生权利与义务的关系, 合同执行进程中出现的问题应按照经济合同法等有关规定办理。合同在执行过程中, 如有争议, 协商解决。协商仍未解决, 请仲裁机构裁决。

11.3 未尽事宜, 两方协商解决。协商结果以书面形式签字盖章记录在案, 作为本合同的附件, 与本合同有同等效力。

11.4 本合同一式 6 份，具有同等法律效力，双方各执 2 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。
(合同的服务承诺长期有效)。

甲方

单位名称（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表（签章）：

开户银行：

账号：

乙方

单位名称（公章）：

地址

法定代表人（签字）：

或授权代表签字：

开户银行：

账号：

第七章 投标文件构成及格式

项目编号：
(正本/副本)

吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目（二次）

投标文件

投 标 人：_____ (单位公章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

年 月 日

目 录

(需引用二级目录)

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

一、投标函

二、投标报价表

三、法定代表人身份证明和法定代表人授权书

四、技术规格响应偏离表（格式）

五、商务条款响应偏离表（格式）

六、投标人性质及其概况

七、信用承诺书

八、投标人认为需要补充的其他资料

第三部分 投标方案

一、技术方案

二、同类业绩统计样表

三、投标人认为需要补充的其他资料

第一部分 资格证明文件

一、投标人资格证明文件（见投标人须知前附表）

二、招标文件中要求提供的其他资格证明材料

备注：投标人应按照竟招标文件第三章评审方法“资格评审标准”逐一提供全部资格证明证明材料加盖单公章的复印件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，文件中给定格式的，须按下文给定格式填写。

附件 1:

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称:

证件类型: 统一社会信用代码

证件号码:

法人代表:

承诺有效期限: 年 月 日 — 年 月 日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺: _____

。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案

和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1. 法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
2、投标人参与投标，需在投标截止时间前在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），并后附信用中国（陕西榆林）信用承诺网上公示截图。

附件 2:

无重大违法记录书面声明

参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我公司郑重声明在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

日期：____年____月____日

附件 3:

投标信用承诺书

项目标段: _____

投标人: _____

统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____

在本项目标段招投标活动中,我公司(单位)自愿作出以下投标信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项,即被视为失信企业(法人),依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号),自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人(签章):

投标人(盖章):

承诺时间: _____年_____月_____日

注: 1、本承诺书效力和作用等同投标保证金,其有效期与投标有效期一致。
2、投标人参与投标,需在投标截止时间前在信用中国(陕西榆林)网站进行注册、登陆,自主上报信用承诺书(网址: <https://credit.yl.gov.cn/>),并后附信用中国(陕西榆林)信用承诺网上公示截图。

附件 4:

其他声明

致: (采购人名称)

我公司作为本次招标项目的投标人, 根据招标文件要求, 现郑重声明如下:

我公司参加本项目投标为非联合体。

我公司参加本项目投标, 不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假
, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章) : _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 5:

投标人控股管理关系承诺书

1、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1. 1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1. 2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1. 3 单位负责人：_____

2、其他与本项目有关的利害关系说明：_____我

单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

第二部分 符合性证明文件

一、投标函

致: 采购人名称

根据贵方_____项目(项目编号:_____)的招标文件,经详细研究,我们决定参加本次项目招标活动并投标。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求,向采购人提供所需所有货物(设备)及相应服务。

二、按招标文件的规定,我公司的投标总报价为:(大写:_____)人民币(小写:¥_____元)。

三、我方提交的投标文件数据和材料真实、准确。否则,愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件,完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况和技术资料,若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定,保证在获得中标资格后:

(1)按照招标文件确定的事项签订合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务;保证合同签订生效后____个日历日内完交付并经采购人验收、使用;

(2)投标文件有效期延长至合同履行完毕。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件,并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

八、其他:_____。

十、有关于本投标文件的函电,请按下列地址联系:

投标人全称(印章):_____

法定代表人或被授权人:_____ (签字)

地 址:_____

开户银行: _____

账 号: _____

电 话: _____

传 真: _____

邮 编: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

二、投标报价表

1. 开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标总报价 (元)	大写: 小写: ¥
交货期	
质保期	
其他声明	
注: 1. 报价总报价以元为单位, 保留2位小数。大小写不一致时, 以大写为准。 2. 除可填报项目外对本开标一览表(唱标报告)的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。	

投标人名称: _____ (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

2. 投标分项报价表（格式）

项目名称：

共 页，第 页

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计（元）：								
投标报价		小写： 大写：						
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。								

注：如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称：_____（加盖单位公章）_____

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

三、法定代表人身份证明和法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: ____年____月____日

经营期限: _____

姓 名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证正反面复印件

(法定代表人身份证人像面)	(法定代表人身份证国徽面)
---------------	---------------

投标人(公章) : _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章) : _____

日期: ____年____月____日

2、法定代表人授权书

陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、职务）授权本公司的（被授权人姓名、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号： ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书有效期为 天。

委托单位：（公章）

法定代表人（签字并盖章）：

签发日期：_____年_____月_____日

附：被授权人姓名：_____性 别：_____

职 务：_____联系电话：_____

法定代表人/被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（人像面）	被授权人身份证复印件（人像面）
法定代表人身份证复印件（国徽面）	被授权人身份证复印件（国徽面）

四、技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

序号	名称	招 标 要 求 技术 指 标	投 标 响 应 技术 指 标	偏 离 情 况	备 注

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款要求，其**投标无效**。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

投标人名称：_____ (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

五、商务条款响应偏离表（格式 ）商务条款响应偏离表

序号	商务条款	招标文件 商务要求	投标文件 商务响应	偏离 情况	备注

- 注：1. 如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。
。偏离情况填写：优于、等于或低于。
2. 声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：_____ (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日期：_____年_____月_____日

六、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、客户评价证明、获得奖励及证书等。

附件

中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

不是可不填写

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、监狱企业证明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

七、信用承诺书

1. 投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。
2、投标人参与投标，需在投标截止时间前在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），并后附信用中国（陕西榆林）信用承诺网上公示截图。

2. 投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）： 投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：1、承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

2、投标人参与投标，需在投标截止时间前在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），并后附信用中国（陕西榆林）信用承诺网上公示截图。

3. 投标人法定代表人（委托代理人）信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

注：1、承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

2、投标人参与投标，需在投标截止时间前在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），并后附信用中国（陕西榆林）信用承诺网上公示截图。

4. 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。
- 7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址： 邮编：

电话：

年 月 日

承诺书II

致：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书 V

致：陕西泓祥兴顺工程项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

八、投标人认为需要补充的其他资料

第三部分 投标方案

一、技术方案

参照招标文件第三章评审方法中的评审标准评分标准各条款的要求，结合第四章《采购内容及要求》编制技术方案。

二、业绩统计样表

项目编号: _____

序号	采购项目名称	项目内容	合同金额(万元)	签订日期	备注	业主名称
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注: 1、投标人应如实列出以上情况, 如有隐瞒, 一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、后附符合招标文件评审要求的业绩证明材料。

三、投标人认为需要补充的其他资料

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



The image shows two screenshots of the Credit China (Shaanxi Yulin) website. The top screenshot displays the 'Credit Commitment' section, which is highlighted with a red arrow. The bottom screenshot shows the same section, but the '通用型承诺' (General Commitment) button is highlighted with a red box.

信用中国 (陕西榆林)

信用查询 站内文章

我要查 (公示、承诺、代码)

我要看 (公告、法规、承诺)

我要办 (投资项目、资质、事项)

首页 信用动态 政策法规 信用公示 信用服务 信用承诺 信用+ 互动交流

当前位置: 信用中国 (陕西榆林) >> 信用承诺 (法人)

法人 自然人

主动型承诺 商社替代型承诺 行业自律型承诺 信用修复型承诺 行政受理型承诺 证据事项型承诺 其他类型承诺

我要承诺 (通用型) 我要承诺 (工程建设领域)
适用于榆林市公共资源智慧交易平台

查询 取消

信用中国 (陕西榆林)

信用查询 站内文章

我要查 (公示、承诺、代码)

我要看 (公告、法规、承诺)

我要办 (投资项目、资质、事项)

首页 信用动态 政策法规 信用公示 信用服务 信用承诺 信用+ 互动交流


当前位置: 信用中国 (陕西榆林) >> 信用承诺 (法人)

法人 自然人

主动型承诺 商社替代型承诺 行业自律型承诺 信用修复型承诺 行政受理型承诺 证据事项型承诺 其他类型承诺

我要承诺 (通用型) 我要承诺 (工程建设领域)
适用于榆林市公共资源智慧交易平台

查询 取消

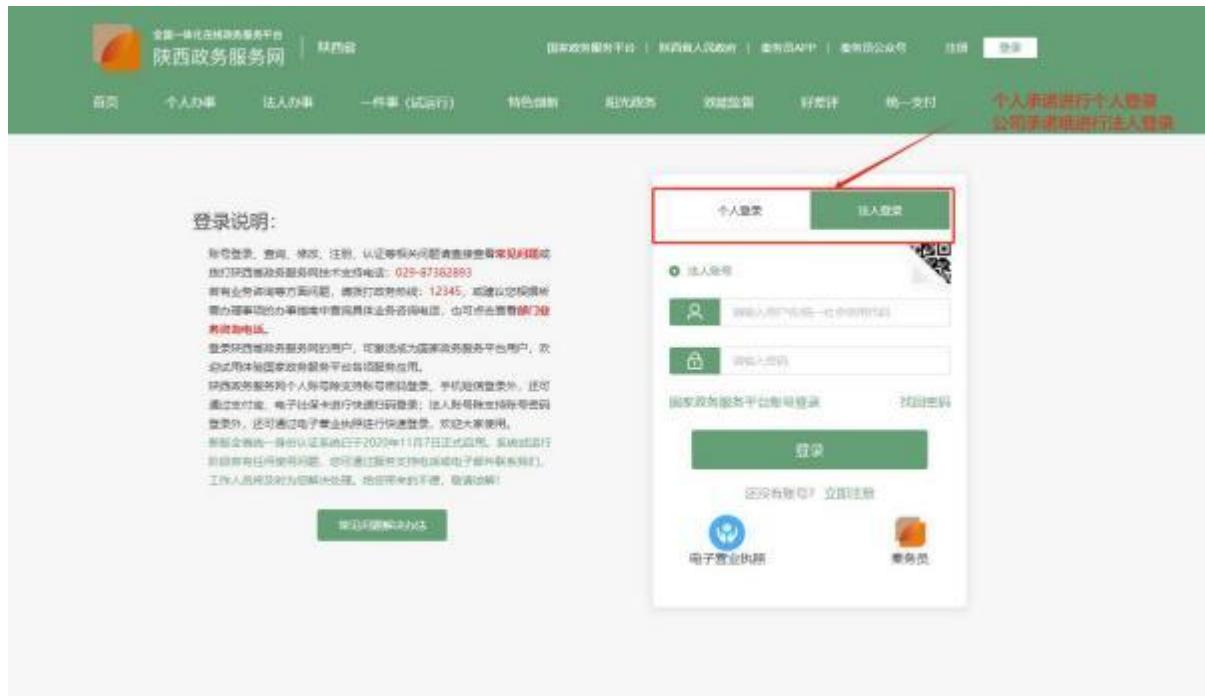



谢 谢

诚 信 社 会 让 生 活 更 美 好

吴堡县卫生健康局心电一张网及审方中心设备采购项目
磋商文件审核意见表

采购人（公章）：		2025年11月10日
法定代表人 或项目负责人：		
采购代理机构（公章）：		2025年11月10日
法定代表人 或项目负责人：		