

政府采购项目

采购项目编号：SCZC2025-ZB-0551-001

千阳县人民医院新院区功能完善能力提升项目
医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年四月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	1
第三章	评标方法和标准	35
第四章	拟签订的合同文本	46
第五章	采购需求及要求	52
第六章	投标文件格式	65

第一章 招标公告

千阳县人民医院新院区功能完善能力提升项目医疗设备采购项目招标公告

项目概况

新院区功能完善能力提升项目医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站【首页】电子交易平台陕西政府采购交易系统企业端获取招标文件，并于2025年05月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZC2025-ZB-0551-001

项目名称：新院区功能完善能力提升项目医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：14,654,000.00 元

采购需求：

合同包1（数字减影血管造影系统）

合同包预算金额：12,000,000.00 元

合同包最高限价：7,600,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	医用 X 线诊断设备	数字减影血管造影系统	1（套）	详见采购文件	12,000,000.00	7,600,000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：60 日历天内

合同包2（电子腹腔镜系统、电切镜系统）

合同包预算金额：2,500,000.00 元

合同包最高限价：2,500,000.00 元

品	品目名	采购标	数量（单	技术规格、	品目预算（元）	最高限价（元）
---	-----	-----	------	-------	---------	---------

目号	称	的	位)	参数及要求		
2-1	医用内窥镜	电子腹腔镜系统	1 (套)	详见采购文件	1,500,000.00	1,500,000.00
2-2	医用内窥镜	电切镜系统	1 (套)	详见采购文件	1,000,000.00	1,000,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60 日历天内

合同包 3（空气波压力循环治疗仪、超声脉冲电导治疗仪、半导体激光治疗仪、无影灯、可视喉镜）

合同包预算金额：154,000.00 元

合同包最高限价：154,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
3-1	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	空气波压力循环治疗仪	1 (台)	详见采购文件	20,000.00	20,000.00
3-2	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	超声脉冲电导治疗仪	1 (台)	详见采购文件	10,000.00	10,000.00
3-3	医用激光仪器及设备	半导体激光治疗仪	1 (台)	详见采购文件	60,000.00	60,000.00
3-4	手术器械	无影灯	2 (台)	详见采购文件	16,000.00	16,000.00
3-5	手术器械	可视喉镜	1 (台)	详见采购文件	48,000.00	48,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60 日历天内

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(数字减影血管造影系统) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 2(电子腹腔镜系统、电切镜系统) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 3(空气波压力循环治疗仪、超声脉冲电导治疗仪、半导体激光治疗仪、无影灯、可视喉镜) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(数字减影血管造影系统) 特定资格要求如下：

3.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

3.4 投标人为生产厂家须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证同时须提供生产厂家医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；

3.5 投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.6 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包 2(电子腹腔镜系统、电切镜系统) 特定资格要求如下：

3.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

3.4 投标人为制造厂家须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证同时须提供制造厂家医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；

3.5 投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.6 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包3(空气波压力循环治疗仪、超声脉冲电导治疗仪、半导体激光治疗仪、无影灯、可视喉镜)特定资格要求如下：

3.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

3.4 投标人为制造厂家须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证同时须提供制造厂家医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；

3.5 投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.6 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2025 年 04 月 16 日 至 2025 年 04 月 22 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00。（北京时间，法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 05 月 20 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕上传电子投标文件

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

项目概况：千阳县人民医院新院区功能完善能力提升项目医疗设备采购项目，具体参数详见招标文件。

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、其他

2.1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2.2、请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。2.3、电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。2.4、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）【《首页》不见面开标】在线参与开评标过程，详见交易平台【首页》服务指南》下载专区】中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：千阳县人民医院

地址：宝鸡市千阳县文化路西段

联系方式：0917-4241844

2. 采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八层

联系方式：029-85257505

3. 项目联系方式

项目联系人：田婧、王莉

电话：029-85257505

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：千阳县人民医院 地 址：宝鸡市千阳县文化路西段 电 话：0917-4241844
1.2	采购代理机构： <u>陕西省采购招标有限责任公司</u> 地址： <u>西安市高新二路2号山西证券大厦八层</u> 联系人： <u>田婧、王莉</u> 电话： <u>029-85257505</u>
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见招标公告
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品：否
1.4	是否允许联合体投标：否
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业： <u>工业（制造业）</u>
2.2	项目预算金额： 合同包1：12,000,000.00 元 合同包2：2,500,000.00 元 合同包3：154,000.00 元
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>/</u> 包
12.1	本项目须提供投标保证金 合同包1：人民币 <u>壹拾万</u> 元整（人民币 100000.00 元）； 合同包2：人民币 <u>伍万</u> 元整（人民币 50000.00 元）；

	合同包 3：人民币叁仟元整（人民币 3000.00 元）； 保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号：(80602000142101980612943) 备注： 1、在汇款时务必注明所投标项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担； 2、请各投标人在投标文件递交截止时间前，按文件的要求向招标代理机构递交投标保证金； 3、投标保证金有效期同投标有效期。
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起 90 个日历日
14.1	投标人需在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA 锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。
16.1	投标截止时间：2025 年 05 月 20 日 09 时 00 分
18.1	开标时间：同投标截止时间 开标地点：本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）【《首页》不见面开标】在线参与开评标过程，详见交易平台【首页】服务指南】下载专区】中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.4	本项目涉及的政府强制采购产品： <u> / </u> 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品： <u> / </u>
20.5	本项目核心产品： 合同包 1：数字减影血管造影系统 合同包 2：电子腹腔镜系统

	合同包 3: 半导体激光治疗仪
23.2	评标方法: 适用综合评分法
27.1	推荐中标候选人的数量: <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: <u>否</u>
31.1	是否提交履约保证金: <u>是</u> (是、否)
32.1	预付款比例为: <u>30%</u> (若中小企业中标预付款比例为 40%)
33	中标单位在领取中标通知书前, 须向采购代理机构支付招标代理服务费, 招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定: 参照原国家计委计价格(2002)1980 号文和国家发改委发改办价格(2003)857 号文的计算方法按标准下浮 20%按标段收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息: 银行户名: 陕西省采购招标有限责任公司 开户银行: 中国光大银行西安友谊路支行 账 号: 78560188000095264 联 系 人: 财务部 联系电话: 029-85263975
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数: 一次性提出
37.4	联系单位: 陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人: 综合办公室 联系电话: 029-85235014
适用于本投标人须知的额外增加的变动:	
1	根据本项目特点, 投标人应提交的其他资格证明文件(特定资格条件)为: 详见公告
2	电子投标注意事项: 1、本项目采用电子化投标的方式投标, 投标人须使用数字认证证书(CA 锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时如因投标人自身原因数字认证证书(CA 锁)造成无法解密投标文件, 按无效投标对待。 2、制作电子投标文件

	投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
--	---

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。
- 2. 资金来源**
- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 3. 投标费用**
- 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
- 4. 适用法律**
- 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知

前附表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

- 9.1 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标复制。

11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

- 12.1 投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交

- 纳投标保证金), 投标保证金须在投标截止时间前到账。
- 12.2 投标保证金应用人民币, 采用支票、汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳, 投标人须按本章附件1格式和内容开具保函, 并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交, 否则视为**无效投标**。投标人违约, 开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的, 可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金, 以一方提交投标保证金的, 对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的, 采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金, 并在项目财政主管部门备案; 情节严重的, 由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报, 在一至三年内禁止参加政府采购活动:
- (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的;
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的;
 - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外, 中标人不与采购人签订合同的;
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购人同意, 将中标项目分包给他人的;
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金, 自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 个日历日, 投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标, 其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因, 采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前, 要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求, 且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应按投标人须知前附表中的规定,在投标截止时间前上传电子版投标文件。
- 14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”,并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改,则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件,其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“投标文件格式”编制。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的加密和递交

15. 投标文件的加密

- 15.1 加密要求:投标人应按照国家公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)的要求对响应文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前,将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后,将记载投标文件的送达时间和密封情况,并向投标人出具回执。
- 17.3 递交投标文件以后,如果投标人要进行修改,须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点,投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收,并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后,如果投标人要进行撤回的,须提出书面申请并在投标截止

时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失

信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为**投标无效**。

- 20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

- 22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：
- （1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- （2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31. 履约保证金

- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

- 32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

- 34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直

接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。


中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

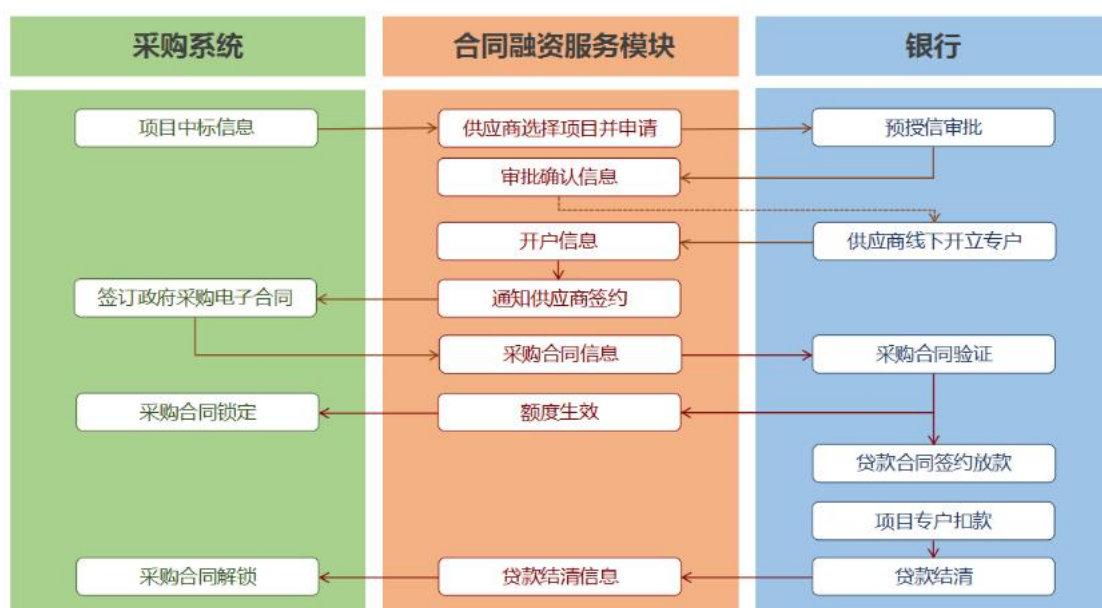

未签订采购合同申请流程

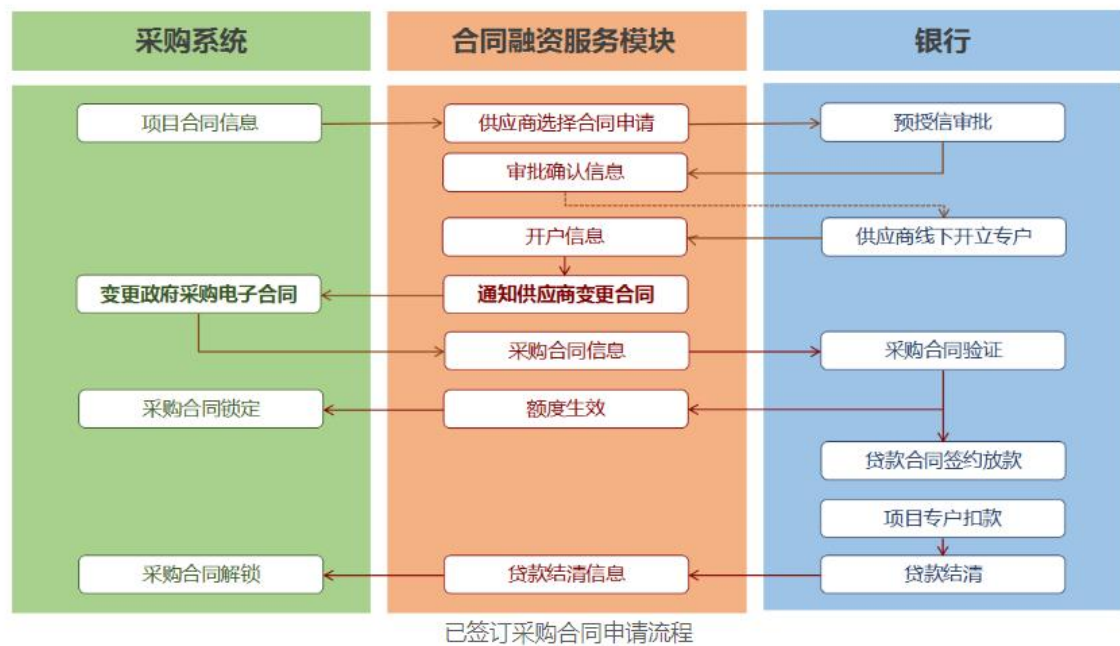

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街 38 号	白玉皓	13201603166
西安莲湖路支行	西安市莲湖路 35 号	刘 冲	17702902131
西安曲江支行	西安市雁塔南路 2216 号	樊理君	18691568151
西安高新区支行	西安市高新路 42 号	卞斯超	15191075651
西安经开区支行	西安市未央路 125 号	惠 媛	17792256100
西安南大街支行	西安市南大街 15 号	乔 鉴	18089136919
西安和平路支行	西安市和平路 101 号	陈 歆	18691816821
西安兴庆路支行	西安市兴庆路 61 号	李 妍	13892880386
西安新城支行	西安市南新街 29 号	朱子君	18629286269
西安长安区支行	西安市长安区青年街 2 号	王淑芸	13572289603
咸阳分行	咸阳市西兰路 4 号	邵 洋	13299079906
宝鸡分行	宝鸡市红旗路 36 号	李 倩	18629019817
铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636
榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275
延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557
汉中分行	汉中市石灰巷 21 号	王晨旭	15319375850
安康分行	安康市育才路 102 号	张少帅	13165762680
商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭 杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518
西安高新开发区支行	梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597
西安曲江文创支行	蒋超	室经理	029-65667366	15891737329
西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	范凯	副行长	029-68717760	13991315609
长安西长安街支行	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660
泾渭工业园支行	杨奕	室经理	029-68213773	15934802021
北客站科技支行	周洁	副行长	029-61828129	18629518636
解放路支行	王莉	行长助理	029-61828185	15802966196
延安分行	奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777
宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262
安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663
铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832
延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933
汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453
渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006
咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506
商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305
商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280
西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行（政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407	魏敏	18681897602
咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859		
宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976		
渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳		18191815559	
榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556		
汉中分行	汉中市汉台区西二环路劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068		

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨欢	0917-3451055	18329677163
榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126
延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500
咸阳分行	侯佳	32100021	15229500088
营销一部	李敏	87236311	13772031109
营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078
营业部	张翔琮	87236306	18829235568
电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787
明德门支行	王晨	85350770	13991249430
东大街支行	刘林	87438914	15029673754
经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397
凤城九路支行	宋宜	89155022	18966911622
兴庆路支行	司洋	83290033	18629251819
长乐西路支行	张超	82566208	15877390201
友谊路支行	贡程敏	88422067	18792795210
边家村支行	王鹏	85251673	15309223048
北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661
西关正街	马 瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185
雁塔路支行	闫梓闻	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983
南二环支行	刘 超	88362861	18192080396
曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行（政采 e 贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586
宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816
宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926	13909176381
渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166
咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983
------	----	----	--------------	-------------

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
 联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行（政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路 259 号	曹金辉	18710993980
------	-----------------	-----	-------------

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行	联系人：任瑾；85438988
----------	-----------------

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号
 联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

序号	单位名称	联系人	联系电话
----	------	-----	------

1	建设银行	郭煜庆 田宇	13892535580 17797059890
2	浦发银行	孙哲龙 蒙波	13892383911 15249035320
3	中信银行	杨洋 耿浩	18191815559 13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张剑 张欢	18191356300 15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	张萱	13028431555 18091365182

延安市政府采购贷款银行信息：

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	徐欣蕾	15891686951
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222
4	邮储银行延安分行	宝塔区枣园路志丹大厦	刘凯	18691114222
5	光大银行延安分行	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500
6	交通银行延安分行	延安市宝塔区北大街 95 号	王瑶	13389119518
7	延安农商行	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦	段田瑞	18700166012
8	甘泉农商行	甘泉县中心街 019 号	白晶晶	15129872940
9	延长联社	延长县七里村镇街道城区中街	白永卿	18109119635
10	延川联社	延川县大禹街道北关信用合作联社	张沛兴	15129756920
11	子长农商行	子长市长兴街	王莉	13992153010
12	安塞农商行	延安市安塞区富民街 22 号	王平	15991569027
13	志丹联社	延安市志丹县保安街 134 号信合大厦	李倩	18792408171
14	吴起农合行	陕西省延安市吴起县北苑东路 26 号	李娜玲	15591103321
15	洛川农商行	陕西省延安市洛川县中心街	史云云	15291172848
16	富县农合行	富县富城镇正街 8 号	逯其玲	18091126065

序号	银行	地址	联系人	电话
17	黄陵联社	黄陵县桥山大厦	曹涛	13772255164
18	宜川联社	宜川县党湾街 65 号	毛永良	15009118628
19	黄龙联社	黄龙县石堡镇广场大街 40 号	郑国强	15991595662

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

- 37.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

- 37.3 投标人提交质疑函的要求

- 37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明

代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号：

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）：

鉴于____（下称被保证人）将于____年__月__日参加贵方招标编号为____（采购项目编号）的____（项目名称）的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）____元（小写）____元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_____

单位地址： _____

电话： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件2：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后

按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

时间：_____年_____月_____日

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- 1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
- 1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的或单价最高限价。
- 1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。
- 1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。
- 1.5 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符。
- 1.6 本项目为专门面向中小企业的项目，投标人未提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获

得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； (2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； (3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； (4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； (5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； (6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2	财务状况报告：提供(1)或提供(2)	(1) 提供递交 2023 年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		(2) 提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3	依法缴纳税收的相关材料	(1) 投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 (2) 缴纳税凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 (3) 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	(1) 投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 (2) 凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 (3) 依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。	
7	信用信息	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的，不得参加投标； （以采购代理机构于递交投标文件截止时间当	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）。	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
10	已向采购代理机构获取招标文件	需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。	
11	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明	（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
12	特定资格要求	1、投标人为制造厂家须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）； 投标人为代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证同时须提供制造厂家医疗器械生产许可证或备案凭证（投标产品须在其生产范围内）； 2、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；	
13	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	
3	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价或单项最高限价	
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
5	投标内容	投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量不符合招标文件规定情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审标准

(采用综合评分法时适用)

评标要素	分值	评标标准
价格	30 分	满足招标文件要求且评审价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。 本项目非专门面向中小企业采购，符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的制造商，投标人的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 (价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/投标总报价)×价格分值)
业绩	10 分	提供 2022 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)本项目核心产品的业绩，每提供 1 个有效业绩得 2 分，最高得 10 分。 注：以上业绩需提供完整合同复印件。
技术参数响应	35分	技术参数全部满足要求得 35 分，★项技术参数为重要参数，一项负偏离或未响应扣 2 分；非★项技术参数为一般参数，未响应或负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。 投标人需提供技术白皮书、检测报告、彩页和铭牌等证明材料，并标注页码，否则该项视为不响应。
货源渠道	5 分	产品货源渠道正规、可靠、有保障，附相关来源渠道证明材料。内容完整、可靠性强且有针对性得 5 分，内容存在瑕疵扣 1 分，扣完为止。
质量保障	5 分	投标人提供的产品性能稳定，具有良好的使用效果，产品质量保障方案内容完整且有针对性得 5 分，内容存在 1 处瑕疵扣 1 分，扣完为止。
设备安装及调试方案	5 分	设备安装及调试方案完善可行，测试手段齐全，能够提供详细的调试、测试报告。方案完善、科学合理、可操作性强得 5 分，内容存在 1 处瑕疵扣 1 分，扣完为止；
培训方案	5 分	提供针对该产品的现场培训，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理。培训方案完善、科学合理、

		可操作性强、实施效果好得 5 分,内容存在 1 处瑕疵扣 1 分,扣完为止;
售后服务	5 分	针对采购需求,投标人提供售后服务方案,包括但不限于①售后服务承诺和服务范围②售后服务流程制度和措施③售后响应时间④退换货方案⑤售后服务团队配置等。方案完善、科学合理、可操作性强得 5 分,内容存在 1 处瑕疵扣 1 分,扣完为止;
满分		100 分
备注:本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。		

第四章 拟签订的合同文本

甲方（采购人）：千阳县人民医院

乙方（成交供应商）：

甲方委托陕西省采购招标有限责任公司按照公开招标方式（项目编号：SCZD2025- ）采购医疗设备，根据 2025 年 月 日招标结果乙方为千阳县人民医院医疗设备采购项目中标供应商，经双方协商签订以下设备购销合同：

一、合同内容及金额：

合同包___： ；合计金额：人民币（大写）_____元整（¥ _____元）。

二、产品技术规格、数量：

序号	名称	规格型号	制造厂家	数量 (台)	单价 (元)	金额 (元)	备注
1							
2							

三、知识产权：即成交供应商应保证采购单位在使用应标货物时，不承担任何设计知识产权法律诉讼的责任。

四、交货时间及要求：

1、双方自签订合同之日起，乙方应在签订合同后 60 日内将所采购医疗设备送到甲方指定位置、并负责完成安装调试。

2、包装标准及要求、费用：乙方根据设备的特性，应满足运输要求包装，确保产品的质量及完整性并符合国家有关标准或规定，设备合法资料齐全。包装费用由乙方承担。

成交供应商未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明原由、拖延的期限等；采购单位、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、运输方式及费用：

1. 运输方式：铁路或汽车运输。

2. 运杂费：包括从货物供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费及其它一切费用均包含在设备价格内，由乙方承担。

3. 运输过程中出现意外及不可抗力造成的一切损失由乙方负责。

4. 在设备到达甲方指定交货位置后，乙方接到甲方安装通知后，在双方人员在场的情况下开箱清点货物，并由乙方负责安装、调试、与医院信息系统对接、人员培训、启用，并承担由此发生的一切费用。

5. 设备安装调试合格后，甲乙双方共同进行质量验收，产品资料齐全，签字确认。

六、付款方式及期限：

1. 合同签订后，乙方向甲方支付合同总价款的 5%作为履约保证金，待合同事项完成后一次性无息付清。

2、合同签订后支付 30%预付款（若乙方为中小企业支付比例为 40%），计人民币元整（¥ 元），合同签订后 60 日内，乙方负责设备到场，安装调试，甲方初验合格后 30 日内支付至乙方设备总货款 70%，计人民币 元整（¥ 元）；乙方在规定的时间内将设备安装调试完毕、正式验收合格、人员操作培训完成，无故障运行满三个月后，甲方支付至乙方设备总货款 100%。

2. 结算方式：银行转账。

3. 结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人，采购人见票付款，无票有权拒付。如遇财政云系统故障，财政资金政策性拨付延迟，双方可签订补充协议或口头协议适当延迟付款时间。

七、质保期限、售后服务及技术培训：

1. 质保期：自正式验收合格启用之日起整套设备原厂质保叁年（超过叁年的按厂家质保期承诺书时间为准）。负责终身维修，并以优惠价格提供配件。在质保期间，所有维修费（包括零部件费用）由乙方负担。

2. 售后服务：在设备调试试用期以及正式交付使用后，质保期内如设备出现故障，乙方须在接到通知后不论节假日与否 2 小时内作出响应，24 小时内到达故障现场进行维修处理，确保设备正常工作。乙方每年至少进行 4 次回访和设备保养、维护，培训设备使用人员。同一部位发生 2 次以上故障且性能恢复不到出厂时的技术标准，甲方可要求供应商更换整机或退货。设备发生故障，乙方在 3 天内不能修复，影响甲方的正常工作，乙方要向甲方无偿提供备用机至发生故障的设备修复为止。

3. 技术培训：乙方应对甲方设备使用人员进行免费培训，培训内容包括设备基本结构原理、操控注意事项；遵循说明书，正确使用及维护的基础知识和技能及其它必备的知识，直至操作人员完全掌握。

八、违约责任：

1. 乙方供应设备必须符合合同约定的质量、参数、数量要求，乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，并承担由此产生的一切费用。如果在甲方发出索赔通知后 15 日内，乙方未作答复，上述索赔应视为被接受。

2. 乙方没有按照合同规定的时间交货、安装、调试、人员培训、启用，甲方可以从设备款中扣除违约赔偿金，违约金以周为单位按每周（7 天）扣除违约货款总金额的 2% 计算。

3. 设备验收合格后，甲方未按合同及时支付货款时，每迟付 1 周按违约货款金额的 2% 赔付违约金给乙方。

4. 乙方或甲方不履行合同者，由违约方赔偿另一方由此而产生的全部损失。

九、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：

1. 培训内容：乙方应对甲方设备使用人员进行免费培训，培训内容包括设备基本结构原理、操控注意事项、简单故障排除；遵循说明书，正确使用及维护的基础知识和技能及其它必备的知识，直至操作人员完全掌握。

2. 培训地点：甲方指定地点或乙方安排地点

3. 培训时间：不少于壹周。

4. 培训人数：不少于 3 人。

5. 培训费用：参训人员的资料费、耗材费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、质量保证

1. 成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2. 在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不

符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3. 保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、**检验：**在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，成交供应商、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十五、**验收：**产品达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、**合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十七、不可抗力致合同无法正常履行，双方另行商定应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、**违约责任：**依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式肆份，甲方、乙方各执壹份，监督部门、财政局各备案壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、招标文件、投标文件均属本合同内容。其它未定事宜双方友好协商解决。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：千阳县人民医院

乙方名称（盖章）：

地址：千阳县南关路12号

地址：

法 人（签字）：

法 人（签字）：

电话：0917-4241844

电话：

开户银行：中国农业银行股份有限
公司千阳县支行营业部

开户银行：

帐号：26330101040006071

帐号：

年 月 日

年 月 日

合同附件

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）		使用单位验收意见：（盖章）	
签字： 年 月 日		签字： 年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第五章 采购需求及要求

合同包1:

数字减影血管造影系统

一.用途：主要用于心、脑及周围血管疾病的诊断和治疗。

二.组件：C臂机架、导管床、高压发生器、球管、非晶硅数字化探测器、能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统，控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。

★三.投标厂商需提供投标机型的“国家医疗器械注册认证”，首次注册时间在2022年1月1日后。

四.各厂家需提供最新低剂量平台和相关认证。

★五.为确保整机稳定性要求高压发生器、X线球管与整机为同一品牌。

六.技术要求与参数。

1.机架系统：

1.1落地式全自动单向C型臂

1.2全自动系统机械轴 ≥ 6 轴

1.3具有自能床旁控制系统可以控制机架和导管床

1.4 $CRA \geq 55^\circ$ $CAU \geq 45^\circ$ $RAO \geq 130^\circ$ $LAO \geq 130^\circ$

1.5 SID范围：90cm—120cm

1.6 落地C臂头足位旋转速度 ≥ 20 度/秒

1.7落地C臂左右位旋转速度 ≥ 20 度/秒

1.8 C臂旋转采集速度 ≥ 30 度/秒（正位）

1.9 C臂旋转采集速度 ≥ 30 度/秒（侧位）

1.10准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转。

★1.11 C型臂弧深 ≥ 100 cm

2.X线高压发生装置：

2.1发生器功率 ≥ 100 KW

2.2最大管电流支持 ≥ 1000 mA

2.3最小管电流 ≤ 10 mA

2.4高频逆变频率 ≥ 100 KHz

2.5最小管电压 ≤ 40 KV

2.6最大管电压 ≥ 125 KV

2.7最短曝光时间 ≤ 1.0 ms

3.X线球管：

3.1最大连续透视功率 ≥ 3000 W

3.2最大透视管电流 ≥ 140 mA

★3.3球管阳极连续高速旋转，转速 ≥ 7000 转/分，包括透视及采集

3.4阳极热容量 ≥ 3.3 MHU

- 3.5管套热容量 $\geq 4.8\text{MHU}$
- 3.6阳极最大散热功率 $\geq 5500\text{W}$
- ★3.7球管焦点 ≥ 3 个
- 3.8最小焦点 $\leq 0.3\text{mm}$
- ★3.9最小焦点功率 $\geq 19\text{KW}$
- 3.10中焦点 $\leq 0.6\text{mm}$
- 3.11中焦点功率： $\geq 40\text{KW}$
- 3.12最大焦点 $\leq 1.0\text{mm}$
- ★3.13最大焦点功率 $\geq 100\text{KW}$
- 3.14球管带有防碰撞保护装置
- 3.15球管采用油冷加水冷或油冷冷却方式
- 3.16球管采用液态金属轴承技术
- 4. 数字化平板探测器：
 - 4.1采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术
 - 4.2为满足综合介入需求与剂量管理间的平衡，要求平板为长方形或正方形平板；
 - 4.3平板有效探测面积 $\geq 38\text{cm} \times 29\text{cm}$ 或 $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$
 - 4.4平板分辨率 $\geq 2.5\text{LP/mm}$
 - 4.5平板像素尺寸 $\leq 200\text{ }\mu\text{m}$
 - 4.6系统采集： $\geq 1500 \times 1500$ 矩阵
 - 4.7动态灰阶 $\geq 14\text{bit}$
 - 4.8视野 ≥ 4 视野
 - 4.9最小视野 $\leq 12 \times 12\text{cm}$
 - 4.10具备独立的平板探测器液态冷却系统
 - 4.11 采集DQE $\geq 75\%$
- 5. 图像采集及处理系统：
 - 5.1标准DR模式，速率：0.5-7.5帧/秒
 - 5.2标准DSA模式，速率：0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能
 - 5.3数字脉冲透视0.5-30幅/秒
 - 5.4数字脉冲透视 ≥ 9 档
 - 5.5透视图像存储量 ≥ 450 幅
 - 5.6最大透视图像储存时间 $\geq 60\text{s}$
 - 5.7图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能
- 6. 导管床：
 - 6.1床长 $\geq 280\text{cm}$ （不包含延长板的长度）
 - 6.2床宽 $\geq 46\text{cm}$
 - 6.3床的最大病人承重 $\geq 200\text{Kg} + 100\text{Kg}$
 - 6.4床的最大物理承重 $\geq 300\text{Kg}$
 - ★6.5床的纵向运动范围 $\geq 125\text{cm}$
 - ★6.6床面的垂直升降范围 $\geq 30\text{cm}$
 - ★6.7床面的旋转 $\geq 270^\circ$
 - 6.8床面的横向运动 $\geq \pm 14\text{cm}$
 - 6.9导管床手臂支架，床垫，输液支架
- 7. 图像显示系统：
 - 7.1采用医用高分辨率TFT显示器

7.2检查室 ≥ 3 台（19英寸）TFT监视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室 ≥ 1 台（19英寸）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示

7.3（19英寸）TFT监视器亮度 $\geq 400\text{ cd/m}^2$

7.4可视角度（水平及垂直可视角度） $\geq 170^\circ$

7.5监视器分辨率 $\geq 1280 \times 1024$

7.6配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾

7.7监视器悬吊架可纵向及旋转运动

8. 图像存储及图像分析系统：

8.1主机硬盘图像存储： 1024×1024 矩阵，容量 ≥ 25000 幅

8.2主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

8.3自动回放采集序列

8.4回放序列的速度及方向可调

8.5可进行减影及非减影切换

8.6后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

9. 实时旋转DSA（脑血管及外周血管造影）：

9.1侧位机架旋转采集范围 ≥ 180 度

9.2最快采集速率 ≥ 50 帧/秒

10. 低剂量防护技术：

10.1低剂量技术 提供AutoRight平台，或Clarity平台，或CLEAR+CARE平台等。

10.2采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预。

10.3自动插入铜滤片数 ≥ 3 片

10.4透视图像存储功能

10.5透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间 $\geq 64\text{s}$ ，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上；

10.6具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

10.7提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关

11. 高级三维图像后处理工作站：

★11.1具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供）

11.2 3.2GHz以上CPU，四核

11.3 RAM： $\geq 128\text{GB}$

11.4图像硬盘容量： $\geq 1\text{TB}$

11.5光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析

11.6控制室： ≥ 19 英寸高分辨率LCD彩色监视器一台

11.7最短重建时间： ≤ 30 秒

12. 临床医用必须具备

12.1 三维/三维融合功能

12.2二维/三维融合功能

12.3冠脉分析功能（2D血管分析）

12.4 CBCT

12.5具备支架精显功能

13. 技术服务

13.1提供对机房及电源的要求

- 13.2 开机率 $\geq 95\%$
- 13.3 现场免费培训操作人员
- 13.4 负责设备的安装调试（达到正常运作要求，保证设备正常使用）
- 13.5 如设备出现故障，接到通知后24小时内响应，48小时内工程人员应到达现场
- 13.6 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应
- 13.7 供应商提供必须得技术资料给客户，对设备使用人员进行现场培训不小于2次
- ★13.8 提供原厂质保 ≥ 3 年。（提供原厂质保证明材料）
- 14. 高级图像后处理工作站
 - 14.1 CPU $\geq 8\text{GHz}$ ，四核；硬盘 $\geq 1\text{TB}$
 - 14.2 液晶彩色监视器 ≥ 19 英寸（一台），用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理；
 - 14.3 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统
 - 14.4 心室功能分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等
 - 14.5 血管定量分析软件。测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、长度及面积测量功能；
 - 14.6 动态图象显示，速率 ≥ 30 幅/秒
- 15. 其他
 - 15.1 悬吊高压注射器 1 台（单筒、双屏 LCD 触摸式、具有造影成像接口、手动开关、具有自动吸药、注射速率 0.1-50ml/s、注射压力 10-1200psi）；
 - 15.2 原装双向对讲通话系统 1 套；
 - 15.3 手持式辐射剂量检测仪 1 台；个人辐射剂量报警仪 4 台；
 - 15.4 负责与医院信息系统连接；
 - 15.5 心电监护（含插件）：1 台（12 导联类型、无创血压（自动模式、手动模式、连续模式、运动干扰）、血氧饱和度、有创血压、Etco2、体温、尺寸 ≥ 15 寸、与导管室 DSA 和高压注射器兼容、双屏）
 - 15.6 自动除颤仪 1 台（工作模式：手动除颤、AED 自动模式、起搏功能；监护与辅助功能：心电监护、CPR 辅助、呼吸末 CO2 监测、电池续航时间 ≥ 8 小时，待机 ≥ 30 天）；
 - 15.7 提供分体式无铅铅衣（铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ）、铅帽、铅脖、铅眼镜：6 套；
 - 15.8 铅衣架：2 个（至少可挂 6 套铅衣）
 - 15.9 铅屏风（2个）

合同包2:

电子腹腔镜系统

一、4K 摄像系统主机

1. 前面板具备烟雾去除、录像、拍照、白平衡、特殊摄像按键等功能。
2. 分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ 像素（宽高比 16:9）。
3. 图像色彩空间标准：BT.2020 标准。
4. 视频输出接口：HDMI $\times 2$ （4K 超高清输出）、3G-SDI $\times 4$ （4K 超高清输出）；3G-SDI $\times 1$ （全高清输出）。
5. 电子放大功能： ≥ 2 倍电子放大。
6. 具有烟雾去除功能。
7. 具有血管增强功能。
8. 具有过度曝光、暗处修正强化功能。
9. 具有特殊成像功能，包括但不限于黑白成像、荧光成像、电子染色成像等。
10. 主机自带 USB 接口，直接连接 U 盘可以录像和照相，存储格式：图片为 JPEG、视频为 MPEG-4。
11. 可拓展同品牌电子软镜。
12. 电气安全级别：I 类 CF 型（提供检验报告）。

二、4K 摄像头

1. 分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ 像素的图像采集。
2. 光电耦合器：4K 超高清 CMOS 图像传感器。
3. 标准 C-Mount 接口更换光学物镜卡口。
4. 摄像头功能按键： ≥ 4 个，可设置烟雾去除、白平衡、宽动态、血管增强等。
5. 摄像头重量 $\leq 180\text{g}$ 。

三、医用内窥镜 LED 冷光源

1. 使用时间： ≥ 60000 小时。
2. 亮度调节：前面板 LED 指示灯显示 ≥ 18 档。
3. 对溢流、液体泼洒、泄露、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌有足够的防护能力。
4. 色温：3000-7000K。
5. 光照均匀性 ≤ 0.22 。
6. 具备待机按键。
7. 300nm~1700nm 波长范围内的辐通量和光通量比值 $\leq 0.4\text{mW/lm}$ 。

四、4K 腹腔内窥镜

1. 成人直径 10mm，儿童直径 5mm。
2. 工作长度 $\geq 300\text{mm}$ 。
3. 视向角： 30° 。
4. 视场角 $\geq 80^\circ$ 。
5. ★景深 3~200mm。
6. ★可高温高压、低温等离子消毒灭菌。
7. 与摄像系统同一品牌。

五、导光束

1. 有效直径 $\geq 4.8\text{mm}$ 。
2. 工作长度 $\geq 3\text{m}$ 。

六、气腹机技术参数

1. 压力控制范围：1 mmHg-30 mmHg。

2. 流量可调：1-50L/min。
3. 具有儿童模式、成人模式、肥胖模式等。
4. 气体总量：可读取腹腔压力、流速。
5. 与影像链成像系统为同一制造商。
6. 多重过压保护。

七、4K 液晶医用监视器

1. 尺寸 ≥ 32 英寸。
2. 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。
3. 背光为 LED。
4. 亮度（标准） $\geq 850\text{cd/m}^2$ 。
5. 响应时间 $\leq 18\text{ms}$ 。
6. 对比度 $\geq 1500:1$ 。

八、台车

1. 360° 可旋转监视器支架。
2. 无外露螺丝设计，内置固定架，可自由调节活动层板。
3. 收纳抽屉。
4. 集中式多接口插座。
5. 配外接内窥镜支架，能同时使用两副内窥镜。
6. 一体式高承重金属结构底座。
7. 120mm 可自锁静音双轮脚轮。

九、高频电刀

1. 工作频率 $\geq 450\text{KHz}$ ，最大输出功率 $\geq 350\text{W}$ 。
2. 具有纯切一、纯切二两种纯切模式，最大输出功率 350W，（负载 500 Ω ）。
3. 具有混切一、混切二两种混切模式，最大输出功率 350W，（负载 500 Ω ）。
4. 具有三种单极电凝模式：柔和凝（负载 100 Ω ）、强力凝（负载 500 Ω ）、喷射凝（负载 500 Ω ），最大输出功率 120W。
5. 具有双极电凝模式，最大输出功率 100W，（负载 100 Ω ）。
6. 输出功率调节：0-50W 时，1W 步进；大于 50W，5W 步进。
7. ≥ 10 英寸触摸显示屏。
8. 具有手控、脚控两种控制方式。
9. 可同时接入两个脚踏，提供两种三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏四种规格供选择。
10. 具有语音报警和语音提示功能。
11. 具有中性极板粘贴面积实时监测反馈功能，检测电阻 $\geq 120\Omega$ 时发出语音报警并停止输出。
12. 具有双反馈回路功率控制功能。
13. 具有功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗。
14. 开路、短路自动保护。
15. 具有屏幕亮度、报警音量调节功能。
16. 开机自检功能：开机自动检测关键元器件及设置参数。
17. 参数保存功能：支持自定义参数保存，可保存 ≥ 10 种自定义手术模式；断电参数自动保存。
18. 支持单极切凝扩展功能，可根据需要扩展出多个单极接口。
19. 无内置风扇散热功能。
20. 强力凝峰值电压 $\geq 2500\text{V}$ 。

配置清单

4K 超高清医用内窥镜系统			
序号	设备名称	单位	数量
1	4K 医用内窥镜摄像系统（含摄像头）	套	1
2	LED 冷光源	台	1
3	导光束	根	1
4	气腹机	台	1
5	腹腔镜内窥镜（10mm）	根	2
6	腹腔镜内窥镜（5mm）	根	1
7	台车	台	1
8	32 英寸 4K 医用监视器	台	1
9	高频电刀	台	1

电切镜系统

一、4K 内窥镜摄像系统

1. 摄像系统主机可兼 4K 分辨率超高清摄像头，具备 4K 图像处理性能，输出 $\geq 3840 \times 2160$ 和 1920×1080 动态图像。
2. 视频输出格式包括以下格式：HDMI 输出： $\geq 3840 \times 2160p$ 以及 $\geq 1920 \times 1080p$ 。
3. 可以扩展同品牌 4K 和 3D 同步实时显示，无须更换摄像头、摄像系统及镜子。
4. ★具有烟雾去除功能。
5. ★具有血管增强功能。
6. 电气安全级别 CF 型。
7. 具备 USB 接口，支持拍照及录像。
8. 光源：LED 冷光源。
9. 光源使用寿命 ≥ 50000 小时。
10. 色温：3000-7000K。
11. 红外截止性能：300nm~1700nm 波长范围内的辐通量和光通量比值 $\leq 1.0mW/lm$ 。
12. 输出总光通量 $\geq 1100lm$ 。
13. 具有光度调节按键，光亮度 ≥ 20 档可调。
14. 摄像主机及光源一体化设计。

二、4K 摄像头

1. 4K CMOS 图像传感器。
2. 摄像头重量： $\leq 160g$ 。
3. 摄像头按键： ≥ 4 个，可以设置包括白平衡、烟雾去除、血管增强、录像、调节光源亮度等。

4. 视频标准： $\geq 4096 \times 2160p$ 、 $\geq 3840 \times 2160p$ 以及 $\geq 1920 \times 1080p$ 。

三、导光束

1. 有效直径 $\geq 3.5\text{mm}$ 。

2. 工作长度 3m 。

四、等离子电切镜

1. 内窥镜：规格 4mm ，长度 $\geq 300\text{mm}$ ，视像角为 12° 或 25° 。

2. 工作手柄为被动式。

3. 工作外鞘 $\leq 26\text{Fr}$ 。

4. 工作内鞘 $\leq 24\text{Fr}$ ，可 360° 旋转。

5. 支持高温高压灭菌。

五、膀胱镜

1. 外径：成人常见为 16Fr — 22Fr 。

2. 工作长度： $200\text{--}400\text{mm}$ 。

3. 视角：常见为 0° 、 30° 、 70° 。

4. 可高温高压、低温等离子消毒灭菌。

六、能量平台

1. 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD 液晶显示屏。

2. 触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；汽化、切割功率 $\leq 300\text{W}$ ；消融、止血功率 $\leq 100\text{W}$ 。

3. 主机采用全智能数字控制电路：

3.1 全时实施数字智能化程序控制，主机能通过等离子刀头反馈负载的工作信息并自动调整阻抗和能量的输出。

3.2★具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率。

4. 主机设置脉冲电切、连续电切、脉冲电凝、连续电凝功能模式。

5. 主机具有自动检测刀头和附件连接功能，具有报警声音提示。

6. 使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。

7. 电击防护：I 类，BF 型

七、等离子手术刀头（射频电极/消融电极）

1. ★刀头有单独的注册证，注册证名称符合陕西省医疗保障局收费规定。

2. 刀头需有无菌一次性使用和重复使用，两个系列类别可选择。

3. 主机可以自动识别控制刀头的功率、档位。

4. 刀头具有粗环、细环、针状和杆状等多种治疗刀头。

5. 等离子主机与刀头为同一个生产厂家。

6. 提供等离子手术刀头报价（不含在设备总报价中）。

八、液晶医用监视器

1. 尺寸 ≥ 32 英寸。
2. 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。
3. 亮度 $\geq 850\text{cd/m}^2$ 。
4. 对比度 $\geq 1500:1$ 。
5. 响应时间 $\leq 18\text{ms}$ 。
6. 高透防反射保护面板。
7. 支持画面实时增强。

九、台车

1. 360° 可旋转监视器支架，可承重 $\geq 20\text{Kg}$ 。
2. 无外露螺丝设计，内置固定架，单层层板承重 $\geq 20\text{Kg}$ 。
3. 具有收纳抽屉。
4. 集中式多接口插座。
5. 一体式高承重金属结构底座。
6. 120mm 可自锁静音双轮脚轮。

十、配置要求

配置清单

4K 超高清医用内窥镜系统			
序号	设备名称	单位	数量
1	4K 医用内窥镜摄像系统（含摄像头）	套	1
2	LED 冷光源	台	1
3	导光束	根	1
4	气腹机	台	1
5	电切镜	根	1
6	膀胱镜（ 0° 、 30° 、 70° ）	根	各 1 根
7	等离子手术刀头（包括粗环、细环、针状和杆状）	根	各 10 根
8	台车	台	1
9	32 寸医用监视器	台	1
10	低温等离子系统	台	1

合同包 3:

空气波压力循环治疗仪

一、基本参数:

- 1、输出方式: 单路输出, 至多可同时连接 2 个下肢至少 4 腔气囊.
- 2、2、治疗模式: 内置多种治疗模式, 包括 1 种标准模式和至少 5 种扩展模式。

二、功能要求:

- 1、专业手提和床挂或推车两用设计, 可便携, 设备标配推车 1 台。
- 2、标配可充电电池。
- 3、具有彩色触摸显示屏, 可显示使用参数。
- 4、治疗模式: 包括专业 DVT 治疗模式。
- 5、气囊规格: 适配小腿三腔、下肢三腔、下肢至少四腔、上肢至少四腔等气囊。
- 6、压力调节范围: 40-180mmHg 或 40-80mmHg、100-180mmHg 并可调。
- 7、具有实时压力监测系统。
- 8、具有过压保护功能、断电保护功能。
- 9、列出耗材报价清单 (不含在设备总报价中)

超声脉冲电导治疗仪

一、性能指标

1、电致孔

1.1 波形: 指数波。

1.2 输出峰峰值: 10V - 100V (可根据临床需求设定范围, 如 50V), ≥ 50 档调节, 允差 $\pm 10\%$ 。

1.3 脉冲重复频率: 1-1000Hz, 允差 $\pm 10\%$ 。

1.4 脉冲宽度: 0.1-5ms, 允差 $\pm 10\%$ 。

1.5 脉冲数量: ≥ 10 个, 至少正负各 5 个。

2、超声波

2.1 额定输出功率: 0.5-3W, 允差 $\pm 20\%$; ≥ 5 档可调。

2.2 有效辐射面积: 1-20cm², 允差 $\pm 20\%$ 。

2.3 有效声强: 0.5-30W/cm², 允差 $\pm 20\%$ 。

2.4 声工作频率: 1-3MHz, 允差 $\pm 10\%$ 。

2.5 波束类型: 准直型。

2.6 波束不均匀系数: ≤ 8 。

2.7 波形: 脉冲波。

3、调制中频

3.1 基波波形: 方波, 频率: 1-10kHz, 允差 $\pm 10\%$, 脉冲宽度: 50-500 μ s, 允差 $\pm 10\%$ 。

3.2 调制波形: 三角波、方波, 频率: 1-10Hz, 允差 $\pm 10\%$ 。

3.3 调幅度: 100%, 允差 $\pm 5\%$ 。

3.4 输出峰峰值: 30V - 100V, ≥ 5 档调节, 允差 $\pm 10\%$ 。

3.5 输出方式：双路或多路输出。

三、功能要求

- 1、具备多种治疗模式：可针对不同病症设置相应的治疗程序，每个程序可对电致孔、超声波、调制中频等参数进行组合和预设。
- 2、显示与操作：配备显示屏，直观显示治疗参数、剩余时间、电量等信息；具备一键启动、暂停、停止等功能。
- 3、存储功能：可存储治疗记录，方便查询和统计患者的治疗情况。

四、配件与耗材要求

- 1、标配配件：超声治疗探头、电极板等。
- 2、耗材要求：一次性理疗用电极片等耗材，并列报价清单（不含在设备总报价中）。

半导体激光治疗仪

一、适用范围：通过探头发射的弱激光照射能同时满足鼻腔、口咽部和体表照射等部位炎症症状的辅助治疗。间接用于耳部炎症症状的辅助治疗。

二、技术要求：

1. 激光波长：650nm±20nm；
2. 激光介质：半导体材料（GaAlAs）；
3. 功率输出：单只激光输出 5mw±20%，功率稳定≤±5%，输出总功率≥200mW。
4. ★探头输出：可同时治疗≥4 个患者（4 路通道），4 路通道可以任意切换治疗模式，并且治疗时间和治疗功率单独调节；
5. 功率档位：≥3 档可调；
6. 定时设定：15-30 分钟；
7. 显示方式：液晶屏显示；
8. 便携式，配备台车；
9. ★探头激光器数量：≥20 只；
10. ★配套器械：专属鼻腔探头、耳道探头和喉腔探头、体表探头；

五、配置要求：

名称	单位	数量
半导体激光治疗仪	台	1
激光器（鼻腔探头）	支	10
激光器（耳道探头）	支	10
激光器（口腔内探头）	支	2
激光器（体表照射大探头）	支	1
治疗台车	台	1

无影灯

1. 可移动 LED 灯珠数量≥48 个；
2. 中心照度（相距 1M 处 LUX）：100000-130000（可调节）；

3. 色温 (K): 4300 ± 500 (可调节);
4. 显色指数 R_a : $\geq 95\%$;
5. 光斑直径 (mm): 160-300;
6. 光斑分布直径 (mm): 80-150;
7. 光柱深度 (mm): ≥ 1200 ;
8. 辐照度 (W/m^2): ≤ 400 ;
9. 术者头部温升 ($^{\circ}C$): ≤ 1 ;
10. 术野工作区域温升 ($^{\circ}C$): ≤ 2 ;
11. 灯泡平均寿命 (h): ≥ 60000 ;
12. 灯泡功率: 1W;
13. 性能要求:
 - 13.1 采用液晶显示、按键控制,可实现照明的电源开关及对照度、色温模式的调节功能。并配有一键腔镜模式、实时显示照度、色温值功能,满足医院对不同手术照明的快速转换需求。数字记忆功能,自动记忆适合的照明度,再次开启时无需进行调试;多个相同功率多组多路集中控制方法;
 - 13.2 符合净化要求的外形设计:灯盘为整体铝合金材质,灯头全部使用硅胶密封条固定。
 - 13.3 悬挂组件系统:贴合灯头外形设计的弧形双弯管结构,可上下跨 90 度、水平旋转 340 度。(5 万次疲劳测试);全方位设计、各关节均为轴承结构,使用弹性阻尼螺钉。
 - 13.4 具有无级调焦功能;拆卸式无菌手柄,采用耐高温工程塑料 (PPSU) 制成,可做 ($\leq 160^{\circ}C$) 高温灭菌处理。
 - 13.5 灯罩采用光学级亚克力材质;
 - 13.6 底座采用四轮支撑、配重钢板、静音耐磨脚轮。

可视喉镜

1. 适用范围:麻醉及抢救时导入气管插管用。
2. 喉镜由手柄可调节窥视片、含摄像头,护套,电池,液晶显示器组成。插入人体口腔的部件为喉镜片,材料为不锈钢可重复使用。
3. 显示屏尺寸: ≥ 3.0 英寸高清 LED 显示器,直角平面显示屏。
4. 分辨 $\geq 1600 \times 1200$ 。
5. 显示屏旋转角度:上下 $0-130^{\circ}$,左右 $0-270^{\circ}$ 。
6. 摄像头分辨率 ≥ 200 万像素。
7. 喉镜片配三种规格:(成人大号,成人中号,儿童),通过 IPX8 防水等级测试,可浸泡消毒,低温等离子灭菌,环氧乙烷消毒,消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计,所有镜片与支架均与主机兼容匹配。
8. 镜片视场角 $\geq 90^{\circ}$ 。
9. 景深: 5-100mm。
10. 光照度 $\geq 800LUX$ 。

11. 电池：视频喉镜专用大容量锂电池（电池满电待机 ≥ 500 分钟）。
12. 容量 $\geq 3000\text{mAh}$ ，充电次数 ≥ 500 次，充电时间 ≤ 3 小时。
13. 充电器输出 4.2V-12V, 2000mA。
14. 防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。
15. 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离 $\leq 45\text{mm}$ 。
16. 拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能。
17. 镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用防脱落锁扣开关设计。
19. 手柄为防滑设计，材质采用高强度 PC 材料。

第六章 投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（包号： ）

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

第一部分	投标函
第二部分	开标一览表
第三部分	资格证明文件
第四部分	投标人概况
第五部分	投标人参加政府采购活动承诺书
第六部分	投标方案

第一部分投标函

致：____（采购人或采购代理机构名称）____

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档____份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- （1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）_____元（¥：_____元）。
- （2）本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- （3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- （4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- （5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。
- （6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：_____

地址：_____

开户银行：_____

帐号：_____

电话：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

_____年_____月_____日

第二部分 开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

包号	投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
	大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	规格 型号	制造 厂家	数量	单价	小计	备注

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

第三部分 资格证明文件

一、身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：_____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明)

二、资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）2023 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（如“生产许可证”、“经营许可证”或 3C 认证复印件，权威机构出具的投标人所投货物有效的型式试验报告复印件（如提供的货物根据适用法律、法规要求，需有此类认证时或招标文件要求提供型式试验报告时提供）（格式见附件 6-9）

（9）如该采购项目专门面向中小企业，投标人的资格证明文件中应提供中小企业声明函。

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 2023 年度经审计的财务报告

投标人提供 2023 年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：（未提供格式的投标人自行拟定）

第四部分 投标人概况

（一）投标人基本信息

（格式自拟）

（二）投标人性质 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

第六部分 投标方案

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	付款方式			
	质保期			
	投标文件有效期			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
 2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

投标人须知前附表要求的其他文件