合同编号：SXCDC-2026-529

采购合同

签订地点：陕西省疾病预防控制中心

签订时间：2026年9月　　日

采购人（甲方）：陕西省疾病预防控制中心

供应商（乙方）：山东新华医疗器械股份有限公司（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方陕西省疾病预防控制中心鼠布所生物安全柜及洁净工作台采购项目（二次）采购项目（项目编号：TZZB-Z-2026164C.1B1）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条　合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

序号	货物名称	品牌/型号	规格	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	生物安全柜	山东新华、LPS-A2-16B	LPS-A2-16B	台	4	24000.00	96000.00
2	生物安全柜	山东新华、LPS-A2-10B	LPS-A2-10B	台	2	20000.00	40000.00
3	洁净工作台	山东新华、LPC-V-10B	LPC-V-10B	台	1	10000.00	10000.00
合计：（大写）壹拾肆万陆仟元整			（小写）146000.00元 不含税金额：129203.54元 税额：16796.46元 发票税率：13%				

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）壹拾肆万陆仟元整，（小写：146,000.00元）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

甲方验收合格后，乙方提供全额合规发票，甲方自收到发票30日内付全款。

第四条 交货时间

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

第五条 质量保证

1.质保期：验收合格后1年。

2.质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

3.达到国家相关规范标准，满足本次采购要求。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点，货物运输过程中发生的毁损及灭失的一切风险，由乙方承担。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：汽运。

4.乙方负责货物（产品）运输，一切运输事宜皆由乙方负责。

第八条 货物验收

货物到货后，由甲、乙方双方确认货物的产地、品牌、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数进行逐项检查，严格按照招标参数要求进行验收，达到招标要求的通过验收，否则不予验收通过。甲方有权更换或者拒绝接受该批次货物。

2.货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受，且不承担任何责任；

（2）如发现所交付的货物（含零部件、配件等）有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方3次更换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而构成根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方须支付合同总价款30%的违约赔偿金给甲方，违约赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行支付。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 违约责任

1.乙方所提供的货物如不符合国家质量标准和相关法律法规规定、招投标文件要求，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额30%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同书
2. 中标通知书
3. 协议
4. 招标文件（含澄清或者修改文件）
5. 投标文件

第十四条 合同生效及其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同效力一致。
2. 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
3. 本合同一式 柒 份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：陕西省疾病预防控制中心

（盖章）

法定代表人/委托代理人：

经办人：周地佳

户　　名：陕西省疾病预防控制中心（陕西省预防医学科学院）

开户银行：中国银行西安雁塔路支行

账　　号：103660804396

纳税识别号：12610000435203421E

电　　话：029-83239388

传　　真：029-82211952

签约日期：2026 年 10 月 10 日

乙方：山东新华医疗器械股份有限公司

（盖章）

法定代表人/委托代理人：

经办人：

地　　址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

开户银行：兴业银行股份有限公司淄博分行

账　　号：379010100100213364

电　　话：0533-3581115

传　　真：0533-3581115

签约日期：2026 年 10 月 10 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一、技术要求/参数偏离表

四、技术要求/参数偏离表

序号	招标文件 技术要求/参数	投标文件技术响应	正/负偏离或相同	偏离内容及影响	备注
1	不锈钢工作台面：整体式可移动升降，集液槽容量≥4L；工作区内有污水排放控制阀，超载保护的防水插座数量≥2个；	2.技术参数及性能特点 （10）不锈钢工作台面：整体式可移动升降，集液槽容量：LPS-A2-16B为60L左右，LPS-A2-10B为37L左右；台面采用标准304不锈钢材质，强度高、耐腐蚀；工作区内有污水排放控制阀，超载保护的防水插座数量2个。	正偏离	集液槽容量更大，在实验操作中应对液体泼溅等意外时，能提供更高的安全余量和操作便利性，降低污染扩散风险。	投标文件 第13页
▲2	滑动前窗：卷簧悬挂系统（非承载式配重结构）；安全玻璃：厚度≥6mm，可任意定位，免维护，关闭后便于灭菌处理（提供证明文件）；具有移门玻璃可完全下拉实现无死角清洁（提供证明文件）；	2.技术参数及性能特点 （11）滑动前窗：采用配重式升降系统，安全可靠；前窗采用厚度6mm的钢化防紫外线玻璃，可任意定位，免维护，关闭后便于灭菌处理，无反光、防爆、防紫外线，可实现移门玻璃全幅无死角清洁。	正偏离	滑动前窗采用配重式升降系统，相较于传统卷簧悬挂系统，操控手感更稳定、顺滑且耐用，能轻松悬停在任意高度；卷簧悬挂系统核心部件是金属弹簧，成本更低，弹簧长时间受力可能发生弹性减弱、卡死甚至断裂，影响实验人员的操作安全。	投标文件 第13页、第16页
3	实验间隙关闭移门，设备自动低速运行。开启移门至安全线，风机自动恢复至设定风速，柜体自带气流自净流程，可反复启停使用；	2.技术参数及性能特点 （13）智能控制：实验间隙关闭移门，设备自动低速运行。开启移门至安全线，风机自动恢复至设定风速，柜体自带气流自净流程，可反复启停使	相同	/	投标文件 第14页

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		用。			
4	工作区尺寸：≥1600mm×600mm×600mm（宽×深×高）；	3.主要技术参数表 工作区尺寸（宽×深×高）：1600mm×625mm×610mm。	正偏离	生物安全柜工作区深度和高度尺寸更大，增加操作空间，使实验操作更灵活。	投标文件第15页
5	彩色液晶屏：实时显示下降风速、吸入风速；显示过滤器寿命和堵塞报警；风机运行状况和故障报警；实时监测与显示机组运行时间等参数。	2.技术参数及性能特点 （15）控制系统采用彩色液晶屏幕实时显示下降风速、吸入风速；显示过滤器寿命和堵塞报警；风机运行状况和故障报警；实时监测与显示机组运行时间等参数。	相同	/	投标文件第14页
6	具有紫外灯定时预约和远程控制功能。	2.技术参数及性能特点 （16）具有紫外灯定时预约和远程控制功能以及消毒完成自动关机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。	相同	/	投标文件第14页
7	工作窗口吸入风速：≥0.53m/ s；	3.主要技术参数表 工作窗口吸入风速：0.55m/s	相同	/	投标文件第15页
8	不锈钢工作台面：整体式可移动升降，集液槽容量≥4L；工作区内有污水排放控制阀，超载保护的防水插座数量≥2个；	2.技术参数及性能特点 （10）不锈钢工作台面：整体式可移动升降，集液槽容量：LPS-A2-16B为60L左右，LPS-A2-10B为37L左右；台面采用标准304不锈钢材质，强度高、耐腐蚀；工作区内有污水排放控制阀，超载保护的防水插座数量2个。	正偏离	集液槽容量更大，在实验操作中应对液体泼溅等意外时，能提供更高的安全余量和操作便利性，降低污染扩散风险。	投标文件第13页
▲9	滑动前窗：卷簧悬挂系统（非承载式配重结构）；安全玻璃：厚度≥6mm，可任意定位	2.技术参数及性能特点 （11）滑动前窗：采用配重式升降系	正偏离	滑动前窗采用配重式升降系统，相较于传统卷簧悬挂系统，操控手感更稳定、顺滑	投标文件第13页、第16页

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	，免维护，关闭后便于灭菌处理（提供证明文件）；具有移门玻璃可完全下拉实现无死角清洁（提供证明文件）；	统，安全可靠；前窗采用厚度6mm的钢化防紫外线玻璃，可任意定位，免维护，关闭后便于灭菌处理，无反光、防爆、防紫外线，可实现移门玻璃全幅无死角清洁。		且耐用，能轻松悬停在任意高度；卷簧悬挂系统核心部件是金属弹簧，成本更低，弹簧长时间受力可能发生弹性减弱、卡死甚至断裂，影响实验人员的操作安全。	
10	实验间隙关闭移门，设备自动低速运行。开启移门至安全线，风机自动恢复至设定风速，柜体自带气流自净流程，可反复启停使用；	2.技术参数及性能特点 （13）智能控制：实验间隙关闭移门，设备自动低速运行。开启移门至安全线，风机自动恢复至设定风速，柜体自带气流自净流程，可反复启停使用。	相同	/	投标文件 第14页
11	工作区尺寸：≥1000mm×600mm×600mm（宽×深×高）；	3.主要技术参数表 工作区尺寸（宽×深×高）：1000mm×625mm×610mm。	正偏离	生物安全柜工作区深度和高度尺寸更大，增加操作空间，使实验操作更灵活。	投标文件 第15页
12	彩色液晶屏：实时显示下降风速、吸入风速；显示过滤器寿命和堵塞报警；风机运行状况和故障报警；实时监测与显示机组运行时间等参数。	2.技术参数及性能特点 （15）控制系统采用彩色液晶屏幕实时显示下降风速、吸入风速；显示过滤器寿命和堵塞报警；风机运行状况和故障报警；实时监测与显示机组运行时间等参数。	相同	/	投标文件 第14页
13	具有紫外灯定时预约和远程控制功能。	2.技术参数及性能特点 （16）具有紫外灯定时预约和远程控制功能以及消毒完成自动关机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。	相同		投标文件 第14页
14	工作窗口吸入风速：≥0.53m/s；	3.主要技术参数表 工作窗口吸入风速	相同	/	投标文件 第15页

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		：0.55m/s			
15	单人单面垂直单向流；	3.技术参数及性能特点 （14）适合单人单面操作，气流模式：垂直单向流。	相同	/	投标文件第20页
16	工作区尺寸：≥850×650×500(宽×深×高)；	4.主要技术参数表 工作区尺寸（宽×深×高）：850×680×550mm。	正偏离	洁净工作台工作区深度和高度尺寸更大，增加操作空间，使实验操作更灵活。	投标文件第21页
17	过滤能力：对0.3um的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%。过滤器规格≥750×600×50mm（提供过滤器合格证）；	1.产品概述 （3）工作原理 对0.3um的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%。 4.主要技术参数表 过滤器规格：800×610×50mm。	正偏离	过滤器规格更大，增加有效过滤面积，更好地保障操作者的安全。	投标文件第19页、第21页、第22页
18	洁净度：ISO≥5级；	3.技术参数及性能特点 （15）洁净度：ISO 5级。	相同	/	投标文件第20页
19	平均风速：≥0.33m/s±0.03m/s；菌落数：≤0.5个/皿·时(直径90mm培养平皿)；	4.主要技术参数表 平均风速：≥0.2m/s（可调）； 菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）	正偏离	平均风速范围优于技术要求，且可通过调节控制面板，使出风面的平均风速始终保持在理想范围内，可有效地延长高效过滤器的使用寿命。	投标文件第20页
▲20	结构：全钢结构，台面304不锈钢一体成型，无死角；箱体有抗菌防腐涂层（提供检测报告）；	3.技术参数及性能特点 （1）洁净工作台采用全钢结构，设备工作区台面采用304不锈钢一体成型，无死角；箱体体有抗菌防腐涂层，有效抑制细菌、微生物在柜面滋生。	相同		投标文件第19页、第27页
21	高清LCD彩色控制器：实时显示风速、过滤器运行状态、过滤器寿命及异常报警，工作窗开启超规定高度报警；	3.技术参数及性能特点 （3）采用高清LCD彩色控制器：实时显示风速、过滤器运行状态、过滤器寿命及异常报警，工作窗开启超规定	相同	/	投标文件第19页

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		高度报警。			
22	带PAO采样口方便扫描检测高效过滤效率。	3.技术参数及性能特点 （7）设备带PAO采样口方便扫描检测高效过滤效率。	相同	/	投标文件 第20页
23	滑动前窗：卷簧悬挂系统（非承载式配重结构），安全玻璃厚度≥5mm，玻璃可上下滑动任意高度悬停定位，也可完全闭合，便于灭菌处理。	3.技术参数及性能特点 （11）滑动前窗：采用配重式升降系统，安全可靠；前窗采用厚度5mm的钢化防紫外线玻璃，无反光、防爆、防紫外线，玻璃可上下滑动任意高度悬停定位，也可完全闭合，便于灭菌处理。	正偏离	滑动前窗采用配重式升降系统，相较于传统卷簧悬挂系统，操控手感更稳定、顺滑且耐用，能轻松悬停在任意高度；卷簧悬挂系统核心部件是金属弹簧，成本更低，弹簧长时间受力可能发生弹性减弱、卡死甚至断裂，影响实验人员的操作安全。	投标文件 第20页

注：对第四章中的参数要求做出响应，并按要求提供相关证明材料。

投标人：山东新华医疗器械股份有限公司（公章）


法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日　　期：2026年09月02日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件二、偏离表证明材料

安全玻璃厚度证明文件

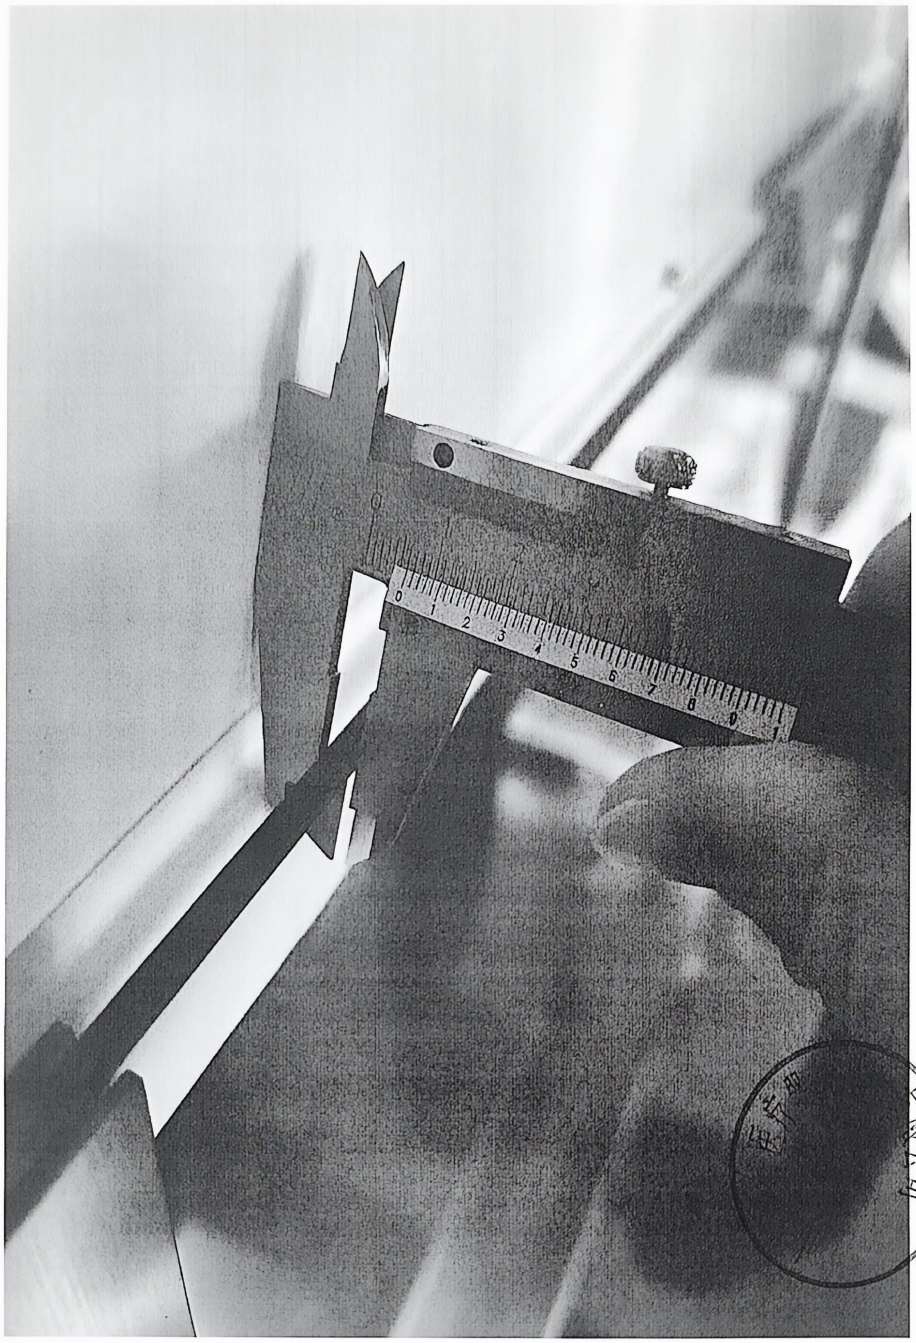

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

洁净工作台过滤器合格证

KINGLANDCLEAN

广州金田瑞麟环境科技有限公司

检 测 报 告

产品名称	普通无隔板过滤器	产品规格	高610*宽800*深50
订单编号	FSLW260112	订单数量	30台
产品代码	K67.1.H14.1.1.A.3.3.ST.00337		
检测依据：1.Sampling Rate（抽样标准）：AQL II 0.65 2.GB-T 13554-2020 高效空气过滤器国家标准 3.GB-T 14295-2019 空气过滤器			
检测项目	检测结果		判定
外观	无刮花、变形		合格
滤芯	H14		合格
密封胶	无气泡、异物		合格
密封条	无破损		合格
尺寸（mm）	高610*宽800*深50		合格
效率	99.995%@0.3μm		合格
风量（m^3/h）	800m3/h@0.45m/s		合格
阻力（Pa）	130±10 Pa		合格
综合批准	检测合格 准予出厂		

广州金田瑞麟环境科技有限公司 KINGLANDCLEAN 质检员：QC.03

检验日期： 2026.01

说明：1.报告无“广州金田瑞麟环境科技有限公司”品质部章无效；

2.未经本公司书面批准，不得复制此报告；

3.本报告最终解释权归广州金田瑞麟环境科技有限公司所有；

广州金田瑞麟净化设备股份有限公司

电话：020-84554218 传真：020-84554318
地址：广州市番禺区石楼镇湖田工业区华山路11号
网址：http://www.gdklc.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App