

西北妇女儿童医院 “五健”促进行动医疗车租赁服务项目合同

甲方：西北妇女儿童医院

乙方：陕西天信元盛软件科技有限公司



“五健”促进行动医疗车租赁服务项目合同

甲方：西北妇女儿童医院

乙方：陕西天信元盛软件科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

第一条 服务内容

乙方租赁给甲方一辆可搭载专用医疗仪器设备的大型医疗车。

（一）车辆基本要求（见附件1）

1. 车辆品牌：厦门金龙
2. 长×宽×高（m）： $\geq 12 \times 2.55 \times 3.7$
3. 发动机要求：功率 $\geq 240\text{kw}$ ，排放标准：国六，燃油种类：柴油
4. 变速器：六档变速箱，气助力两软轴操纵器
5. 制动系统：ECE 标准双回路气制动，前盘后鼓式
6. 轮胎：国产真空胎
7. 车身主要配置：
 - 7.1. 车身结构：半承载式
 - 7.2. 内饰：成型内饰
 - 7.3. 乘客门及门泵：气动单扇外摆门（右前门、右后门各1）
 - 7.4. 空调系统：顶置式非独立空调
 - 7.5. 视听系统：车载电脑终端专业版二代（新标准行驶记录仪功能、彩色触摸屏、卫星定位车载终端、收音机、MP3 U盘/SD卡播放，电影U盘/SD卡播放、故障诊断，支持高清播放，司机独立功放）
 - 7.6. 地板革：高级耐磨地板革，平地板

（二）车内其它配套附件及安装要求

1. 乙方提供平面布局图进行说明，以甲方要求的平面布局图和车内配置为准。
2. 车内空间必须能够完成以下检查项目：足底足弓检查、脊柱侧弯检查、人体成分分析检查、超声骨密度检查、身高体重检查、裂隙灯检查、电脑验光检查、生物测量检查、牙科检查等。
3. 驻车温度控制设备： ≥ 3 台，规格：1.5P。

4. 车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用。

5. 车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高。内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。

6. 车内地板：地板采用耐酸、碱及防火、防滑、防静电地板革；地板革禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合 GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求。

7. 车内使用的线缆禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合 GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求；线缆的阻燃测试需符合标准 UL94。

8. 车内电线束：医疗舱电路部分需使用汽车专用电线束。端子与电线连接、橡胶件防水性能、耐振动性能、耐盐雾性能符合 QC/T 29106-2014 汽车电线束技术条件。

9. 甲方负责车辆日常管理、司机、加油、过路费等，乙方提供送车服务并负责车辆保险、维修保养。

(1) 乙方必须为车辆购买交通强制险、特种车损失险、特种车第三者责任保险、车上人员责任险（司机）、车上人员责任险（乘客），所有保单随验收交付。若发生交通事故或意外事件，乙方应立即通知保险公司并协助处理。

(2) 在租赁期间，因车辆本身质量问题或设备故障导致的事故由乙方全权负责。

(3) 若车辆发生故障，乙方应在接到通知后 0.5 小时内响应，1 小时内到达现场维修；若 48 小时内无法修复，乙方应提供同等级别替代车辆，否则按日扣减租金。

(4) 若因设备故障导致患者病情恶化或受损，乙方需承担全部赔偿责任。

10. 根据甲方需求给整车设计制作安装“五健”促进行动活动标识。

第二条 合同价款

(一) 合同总价款为¥290000.00/年，（大写：人民币贰拾玖万元整/年）。付款方式：合同签订后，乙方开具符合税法规定的增值税发票，甲方一次性银行转账。

(二) 合同总价包括：合同期内服务实施费用、人工费、材料费、按约定的所有维修费用、交通费、住宿费、管理费、税费以及国家按现行税率征收的一切税费等所有费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

第三条 项目实施地点、工期及服务期限

(一) 项目实施地点：甲方指定地点。

(二) 服务期限：计划服务期 3 年，合同一年一签，每年合同期满后根据服务质量考核评价，确定是否续签。本次为第一年度，服务期自 2026 年 9 月 8 日起至 2027 年 9 月 7 日

止。

(三) 工期: 合同签订后, 在 60 天内按甲方需求完成车辆安装布置等并交付 (车辆要求上西安牌照)。

第四条 售后

乙方对其所提供的医疗车负责一切相关售后事宜。

(一) 服务承诺: 售后 24 小时在线服务 (服务电话: 18813681876)。

(二) 培训方案: 租赁服务自交付验收起, 提供操作及维护培训; 为甲方培训 3 名技术人员, 保证操作者完全熟悉设备的全部功能, 并提供设备的操作手册和维修手册。确保全员培训以及培训合格率 100% 达标。

1. 培训方式: 面对面讲解、实操。

2. 培训工程师人员安排: 1 名工程师。

3. 培训对象: 医护人员、操作人员、日常维护工程师等, 由甲方确定。

4. 培训时间: 车辆送达目的地, 开始使用前。

5. 培训内容: ①操作人员现场培训: 车辆的使用方法, 配套设施开机、关机、操作流程, 接地电源的操作流程, 安全注意事项; ②设备维护人员现场培训: 设备常规的保养、维护、清洁, 电路原理图的培训等。

第五条 验收

验收依据: 单证齐全, 应有产品合格证、质量证明、使用说明、保修保质证明、合同、响应文件及其他应当具有的单证, 并符合国家法律、法规对该产品规定的国家标准的要求。

双方对验收情况签字确认。若验收不达标, 乙方需在 2 日内整改, 整改后仍不达标的, 甲方有权单方解除合同, 乙方须按照合同总金额的 10% 支付违约金。

第六条 知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。若因乙方提供的车辆或设备侵犯第三方知识产权导致甲方被诉, 乙方应负责解决并赔偿甲方因此遭受的全部损失 (包括但不限于诉讼费、律师费等)。

第七条 违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求的提供技术服务不能满足要求, 甲方有权终止合同, 甚至对乙方违约行为进行追究。

(三) 因乙方原因未按合同、招标文件规定的要求及期限完成上线工作, 每逾期一日向甲方支付 1% 合同金额作为违约金, 最多不超过合同金额的 20%。

(四) 如乙方拒绝配合安全合规工作或因其行为导致安全事件, 甲方有权单方解除合同, 并要求退还剩余租金及赔偿损失。

第八条 争议解决

本合同在履行过程中发生争议时, 甲乙双方应及时协商解决, 协商或调解不成时, 任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

第九条 其他事项

(一) 本合同(含附件)一式肆份, 甲方叁份, 乙方壹份, 具有同等法律效力, 自双方法定代表人签字或盖章, 并加盖公章之日起生效。

(二) 招标文件、响应文件也是合同的组成部分, 具有同等法律效力, 合同中未约定的以招标文件、响应文件为准。

甲方: (盖章)
西北妇女儿童医院

地址: 西安市雁塔区雁翔路 1616 号

法定代表人:

联系人: 李林蒿

电 话: 029-89551148

开户银行: 中国银行西安莲湖区支行

账 号: 103208712015

纳税人识别号: 126100000881820988

签订时间: 2026 年 7 月 10 日

签订地点: 西安市

乙方: (盖章)

陕西天信元盛软件科技有限公司

地址: 陕西省西安市雁塔区沈家桥二路 228
号金地未来域 1 幢 1 单元 1805 室

法定代表人:

联系人: 陈汉钊

电 话: 18813681876


开户银行: 交通银行股份有限公司西安西稍
门支行

账 号: 6113 0107 7013 0003 4785 2

纳税人识别号: 91610138MA6TTQYC8Q

附件：车辆配备情况

1、“五健”促进行动医疗车平面布局图、外观图

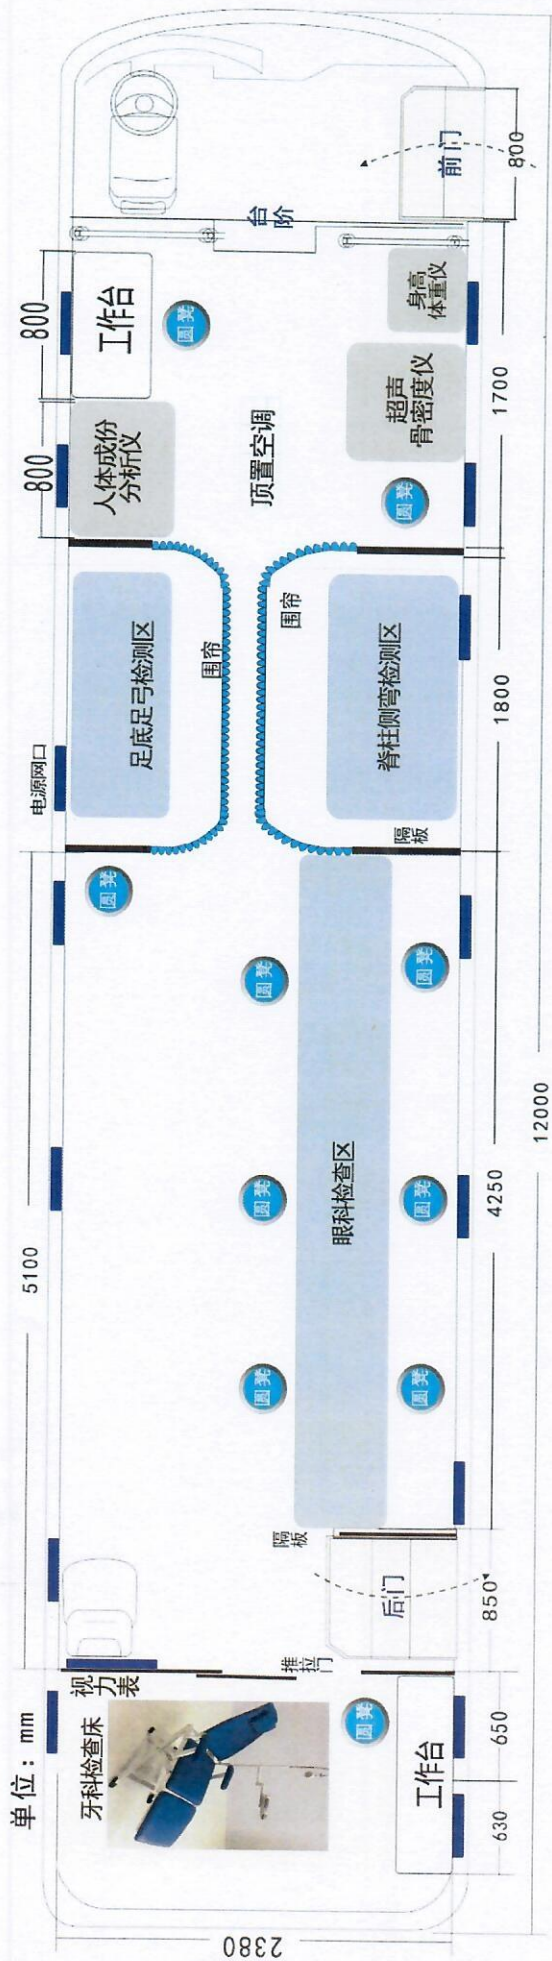

备注：

- 1、乙方按照以上布局施工装潢。车内甲方外使用的大型、重型设备发至乙方所在地，由乙方在车内完成固定安装。
- 2、本项目首年交付时乙方提供的车辆为全新车辆，车辆上西安牌照（车辆上牌后提供给甲方车辆行驶证以及相关手续）。

2、医疗车外观图



备注:

1、该外观图为车辆出厂底色，最终车辆外观根据医院确定方案为整车设计制作安装“五健”促进行动活动标识。

3、医疗车内饰参考效果图



4、医疗车基础配置清单

名称	技术参数描述	数量
医疗车	车辆型号：XMQ5186XYL 品牌：厦门金龙 规格：12000×2550×3960mm（长×宽×高）	1 辆
工作台	根据实际需求定制	1 批
市电暖风	保证在行程和驻车都有暖风供应。	1 套
紫外线消毒系统	在相应操作区域，功能检查区域安装紫外线消毒灯。	4 盏
座椅	随车座椅（含司机座椅）2 把，操作圆凳 12 把	/
驻车空调	品牌：海尔，冷暖空调。	3 台
支撑装置	配备机械支撑架 4 个，用于驻车体检时稳定车身平衡，不会因为体检人员上下引起车辆剧烈晃动。	1 套
网线	全车配备局域网络。	1 套
配电系统	配电柜 1 个，拖线盘 25 米 4 个，外接 220V 电源插座 4 个，接地钎 1 个，工具箱 1 个。	1 套
UPS 电源	保证车内电脑断电时应急用电	1 个

5、医疗体检车技术参数表

医疗体检车型号：XMQ5186XYL（厦门金龙）

长度：12 米

整 车 参 数	总长 (mm)	12000
	总宽 (mm)	2550
	总高 (mm)	3740, 3810, 3880, 3960 (mm)
	轴距 (mm)	6000
	前悬/后悬 (mm)	2600/3400
	接近角/离去角 (°)	9/9(°)
	最高车速 (km/h)	100
	厂定最大总质量 (Kg)	18000
	整备质量 (Kg)	14000, 14800, 15500, 15900, 16100 (Kg)
	额定乘员数 (人)	2-9
发 动 机	发动机型号	YCK08330-60 (广西玉柴)
	发动机型式	直列、六缸、四冲程、增压中冷柴油机
	额定功率 (kw)	243
	排放标准	国六
	排量	7698 ml
底 盘	变速箱	六档变速箱
	离合器	Φ 430 (推式)
	悬架	多片簧 (10/12, -/-)
	轮胎	国产真空胎 (295/80R22.5)
	缓速器	国产电涡流缓速器
	制动	前盘后鼓制动器
车 身 主 要 配	车身结构	半承载式
	内饰	成型内饰
	乘客门及门泵	气动单扇外摆门 (共 2 个, 分别是右前门, 右后门)
	车窗、风挡	全封闭粘接式钢化玻璃, 左右最前一扇、最后一扇侧窗玻璃的推拉窗, 窗口高度与车门上沿平齐

置	视听系统	龙翼车载车载电脑终端专业版二代（新标准行驶记录仪功能、彩色触摸屏、卫星定位车载终端、收音机、MP3U盘/SD卡播放，电影U盘/SD卡播放、故障诊断、卡拉OK混响，支持高清播放，司机独立功放）
	空调系统	金龙非独立顶置式
	底盘底温保护	防止油箱燃油和管路冻结堵塞而采取的特殊保护措施，以保证低温状态下车辆能够正常启动
	雨刮器	单机双臂对刮式