

政府采购项目

西安市粮油质量检验中心 2026 年实验室 试剂耗材购置项目 2 标段服务合同

(项目编号: KY2026-3-215)

采购人(甲方): 西安市粮油质量检验中心

供应商(乙方): 西安复思科学仪器有限公司

2026 年 7 月

中国 西安

西安市粮油质量检验中心（以下简称甲方）2026年实验室试剂耗材购置项目2标段：
大型仪器耗材及标准物质采购，在西安市粮油质量检验中心的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定西安复思科学仪器有限公司（以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的试剂耗材品牌、规格型号、产地、单价组织供货（具体采购清单见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据试剂耗材的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

（一）中标试剂耗材品牌、规格型号、产地、单价详见附件1（供货清单）。结算单价按照合同单价，金额按照甲方实际采购数量结算。最终采购总额不得超过本标段预算金额173500.00元。

（二）乙方保证向甲方所供货物价格不高于市场价格。

三、合同款项支付

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

（二）付款方式：

每月产品供货完成，验收合格后据实结算，达到付款条件起10日内，支付当月货款的100.00%。注：合同结算价以中标时各类试剂、耗材所报的单价为准，结算金额按采购人实际采购量进行计算。

四、交货条件

（一）交货地点：采购人指定地点。

（二）交货期：接到采购人订单后，3-5天内到货。如货期有变化，提前通知采购人。

（三）质保期：质保期为产品的有效期。

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费的一切费用。

（二）提供与供货产品相适应的低温冷藏及运输安全保障。

六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，甲乙双方签字盖章后生效。

(三) 招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点：西安市

合同签订时间：2026年 7月 27日

甲方（章）：西安市粮油质量检验中心（盖章）

乙方（章）：西安复思科学仪器有限公司

法定代表人或其授权的代理人
(签字或盖章)：

法定代表人或其授权的代理人
(签字或盖章)：

地 址：西安市西北一路3号

地 址：陕西省西安市雁塔区西沣北路1159号万科汇智中心1幢12018室

邮 编：710003

邮 编：710000

电 话：029-87340926

电 话：029-81127114

传 真：029-87310607

传 真：/

开户行：交行陕西省分行莲湖路支行

开 户 行：中国银行西安长安区西长安街支行

帐 号：611301097018010023792

账 号：102467279986

12	镉单元素溶液标准物质标液	坛墨	20mL, 1000mg/L	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	20.00
13	丙酮中氯氰菊酯溶液标准物质	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	52.00
14	正己烷中甲氧菊酯溶液标准物质	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	44.00
15	正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	26.00
16	标准溶液/甲醇中8种有机氯农药混标/8 Organochlorine Pesticide Mix in Methanol	坛墨	1mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	220.00
17	丙酮中马拉硫磷溶液标准物质	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	28.00
18	丙酮中毒死蜱溶液标准物质	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	41.00
19	标准溶液/甲醇中甲拌磷	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	39.00
20	标准溶液/甲醇中甲拌磷砒	坛墨	1.2mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	39.00
21	标准溶液/丙酮中甲拌磷亚砒	坛墨	1mL, 100 μg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	支	1	39.00
22	六号溶剂标准溶液	坛墨	5mL, 10mg/mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	79.00
23	脂肪酸标准品 21 种	复思	GLC-538-100mg	西安	西安复思科学仪器有限公司	瓶	1	1260.00
24	脂肪酸标准品 37 种	安谱	CDAA-252795-25mg	上海	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1	780.00

					中心			
38	支链淀粉标准溶液	万佳首化	1mg/mL, 100mL	河南	河南标准物质研发中心	瓶	1	270.00
39	α -生育酚标准品	坛墨	CAS: 59-02-9, 99.8%, 100mg	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	83.00
40	β -生育酚标准品	坛墨	CAS: 148-03-8, 99.8%, 100mg	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	83.00
41	γ -生育酚标准品	坛墨	CAS: 54-28-4, 99.5%, 100mg	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	630.00
42	δ -生育酚标准品	坛墨	CAS: 119-13-1, 99.8%, 100mg	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	98.00
43	γ -生育三烯酚, 100mg, 99%	上海颖心	100mg, 99%	上海	上海颖心实验室设备有限公司	瓶	1	4850.00
44	δ -生育三烯酚, 100mg, 99%	上海颖心	100mg, 99%	上海	上海颖心实验室设备有限公司	瓶	1	3900.00
45	β -生育三烯酚, 5mg, 98%	上海颖心	5mg, 98%	上海	上海颖心实验室设备有限公司	瓶	1	3430.00
46	α -生育三烯酚, 10mg, 98%	上海颖心	10mg, 98%	上海	上海颖心实验室设备有限公司	瓶	1	4410.00
47	甲醛标准溶液	坛墨	100mg/L, 20mL/瓶	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	30.00
48	顺环氧七氯标准溶液	农科院	100 μ g/mL, 1mL/瓶	北京	中国农业科学院	瓶	1	100.00
49	亚硝酸盐标准溶液	坛墨	200mg/L, 50mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	28.00
50	硝酸盐标准溶液	坛墨	200mg/L, 50mL	常州	坛墨质检科技股份有限公司	瓶	1	28.00

	(GBWE100351)				股份有限公司			
65	小麦粉中总汞质控样品	坛墨	10g, 0.06±0.01mg/kg	常州	坛墨质检科技股份有限公司	袋	1	840.00
66	大米加工精度实物标准	万佳首化	粳米加工精度标准样品 (精碾, 适碾) 500g/包, 2包/套	河南	河南标准物质研发中心	袋	1	1650.00
67	小麦粉加工精度实物标准	万佳首化	精制粉, 标准粉/ 套, 200g/包, 2包/套	河南	河南标准物质研发中心	袋	1	1680.00
68	硅胶固相萃取柱	复思	6mL/500mg, 30根/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	350.00
69	二醇基 (Diol) 固相萃取柱	复思	500mg/3mL, 50根/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	1250.00
70	椰子壳活性炭固相萃取柱	复思	2g, 30根/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	1130.00
71	C18 固相萃取柱	复思	2000mg/12mL, 20根/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	470.00
72	棕色、透明进样瓶	HMING	1010-0101 2mL 开口螺 纹 带标签、透明 QTY:100个/盒	江苏	艾驰明科技(江苏)有限公司	盒	1	56.00
73	透明进样瓶	HMING	1010-0101 2mL 开口螺 纹 带标签、透明 QTY:100个/盒	江苏	艾驰明科技(江苏)有限公司	盒	1	56.00
74	预开口进样瓶	HMING	1010-0102 2mL 开口螺 纹 带标签、棕色 QTY:100个/盒	江苏	艾驰明科技(江苏)有限公司	盒	1	56.00
75	聚乙烯吸油蓝膜	复思	13cm*18cm, 1000张	西安	西安复思科学仪器有限公司	张	1	19.00

			盒		有限公司			
90	气相进样口隔垫	复思	04189522A, 25 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	630.00
91	气相进样口隔垫	复思	5183-4757, 50 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	1140.00
92	石墨压环	复思	221-81162-01, Bore 0.43, 6 个/板	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	2160.00
93	石墨压环	复思	221-81162-02, Bore 0.5, 6 个/板	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	2160.00
94	石墨压环	复思	S227-35006-01, Bore 0.5, 10 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	600.00
95	石墨压环	复思	S227-35009-01, Bore 0.8, 10 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	600.00
96	石墨压环	复思	5062-3508, 0.25, 10 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	980.00
97	石墨压环	复思	5080-8853, 0.32, 10 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	700.00
98	石墨压环	复思	500-2114, 0.25, 10 个/盒	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	480.00
99	衬管	复思	5062-3587 (不分流)	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	470.00
100	衬管	复思	5190-2293 (不分流)	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	550.00
101	衬管	复思	5190-2295 (分流)	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	680.00
102	衬管	复思	5183-4711 (分流)	西安	西安复思科学仪器有限公司	盒	1	490.00

115	气质调谐液	复思	05971-60571	西安	西安复思科学仪器有限公司	瓶	1	1460.00
116	气相色谱柱	复思	122-5532	西安	西安复思科学仪器有限公司	个	1	8300.00
117	原子荧光玻璃进样针	海光	5 根/盒	北京	北京海光仪器有限公司	盒	1	280.00
118	原子荧光样品管	海光	100 支/包	北京	北京海光仪器有限公司	包	1	350.00
119	原子荧光电热丝	海光	10 个/包	北京	北京海光仪器有限公司	个	1	140.00
120	C18 液相色谱柱	复思	693970-902 Poroshell1120, EC-C18, 4.6x150mm, 4um	西安	西安复思科学仪器有限公司	个	1	7700.00
121	C18 液相色谱柱	复思	990967-902Eclipse XDB-C18 4.6x2505u Analytical	西安	西安复思科学仪器有限公司	个	1	7400.00
122	C18 液相色谱柱	复思	993967-902 Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical	西安	西安复思科学仪器有限公司	个	1	6800.00
123	C18 液相色谱柱	HMING	5um, 4.6*150mm	江苏	艾驰明科技(江苏)有限公司	个	1	1760.00

总金额：人民币 壹拾柒万叁仟伍佰元 整 (¥ 173500.00 元)

5、脱氧雪腐镰刀菌烯醇标液、100 μ g/mL，1.2mL/瓶



STD#3102-1 : Pribolab®100 μ g/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol)/乙醇

液体标准品 | 物料代码: STD#3102-1

计量单位: 瓶

1.2ml

询价

6、黄曲霉毒素 B1 标液、100 μ g/mL，1.2mL/瓶



STD#1042-1 : Pribolab®100 μ g/mL黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)/乙醇


液体标准品 | 物料代码: STD#1042-1

计量单位: 瓶

1.2ml

询价

7、玉米赤霉烯酮标液、100 μ g/mL，1.2mL/瓶

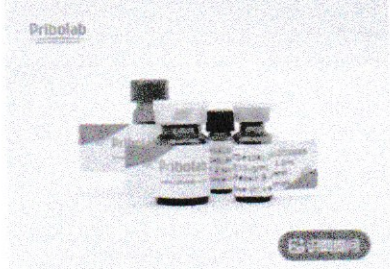

STD#4012-1 : Pribolab®100 μ g/mL玉米赤霉烯酮(Zearalenone)/乙醇

液体标准品 | 物料代码: STD#4012-1

计量单位: 瓶

1.2ml

询价

8、赭曲霉毒素 A 标液、100 μ g/mL，1.2mL/瓶



STD#5012-1M : Pribolab®100 μ g/mL曲古霉素A(ORA)/甲醇

液体标准品 | 物料代码: STD#5012-1M

计量单位: 瓶

1.2ml

询价

水中铅

本标准物质主要用于量值溯源、分析方法确认与评价、测量过程质量控制,也可作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制各种工作标准溶液。

一、样品制备

本标准物质以高纯度金属铅的高纯盐酸、硝酸和符合国际一级水标准的水为溶剂,在(20±3)℃的条件下采用容量-称量法准确配制而成。

二、溯源性及定值方法

本标准物质以国际纯度和纯度证书作为溯源,采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)进行量值溯源,通过采用经过确认的、满足计量特性的分析方法,经法定计量机构认定/校准的分析仪器、量具及天平等计量器具,确保量值溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(mg/L)	相对扩展不确定度(%) $(k=2)$	基体(V/V)
BW30029-1000-20	水中铅	1000	1	5%硝酸

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果、制备过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评价》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察,结果表明,本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质量值自定值日期起,有效期48个月,研制单位将定期跟踪监测标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 包装: 本标准物质采用经酸洗的玻璃瓶密封包装,20mL/瓶,转移或稀释时通过移液管量取为宜。
- 运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压、碰撞;冷藏,置于阴凉处贮存。
- 使用: 使用前应恒温(20±3)℃,并充分摇匀,安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次密封后作为标准物质使用,有效期是指安瓿瓶未开封前在规定的保存条件下可以使用的最后日期。

声明

- 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用,因用户使用或储存不当引起的损失,不属于责任范围。
- 收到后请立即核对品名、数量和质量,如发现与订单不符,请及时联系。
- 仍对质量有疑问时,请联系本研究所,如未联系,视为默认接受。
- 10个工作日内提供免费的技术支持,请与技术部联系。




销售热线: 010-57801888	服务热线: 400-019-883
邮箱: sales@china.com	
网站: www.china.com	
地址: 北京市昌平区回龙观镇	

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

11、汞元素溶液标准物质标准液、20mL, 1000mg/L

标准溶液/水中汞/介质:5%硝酸

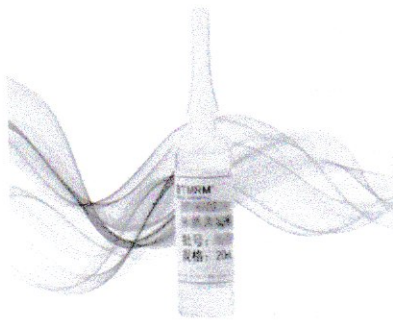

标准价 ¥50

优惠价 ¥50

产品编号 BW30029-1000-20

规格 20mL

库存 ≥6

有效期 2029-12-08

品牌 坛墨质检

标准值 1000mg/L

数量 1

储存条件 冷藏(2-8)℃

运输条件 常温运输

水中汞

本产品适用但不仅限于以下标准:
HJ 977-2018

本标准物质主要用于量值溯源、分析方法确认与评价、测量过程质量控制,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制各种工作标准溶液。本标准物质适用于电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、原子荧光光谱法(AFS)、原子吸收光谱法(AAS)、分光光度法等分析方法测试使用。

一、样品制备

本标准物质以高纯度金属汞的高纯盐酸、硝酸和符合国际一级水标准的水为溶剂,在(20±3)℃的条件下采用容量-称量法准确配制而成。

二、溯源性及定值方法

本标准物质以国际纯度和纯度证书作为溯源,采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)进行量值溯源,通过采用经过确认的、满足计量特性的分析方法,经法定计量机构认定/校准的分析仪器、量具及天平等计量器具,确保量值溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(mg/L)	相对扩展不确定度(%) $(k=2)$	基体(V/V)
BW30029-1000-20	水中汞	1000	1	5%硝酸

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果、制备过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评价》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察,结果表明,本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质量值自定值日期起,有效期48个月,研制单位将定期跟踪监测标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 包装: 本标准物质采用经酸洗的玻璃瓶密封包装,20mL/瓶,转移或稀释时通过移液管量取为宜。
- 运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压、碰撞;冷藏,置于阴凉处贮存。
- 使用: 使用前应恒温(20±3)℃,并充分摇匀,安瓿瓶打开后应一次性使用完毕,有效期是指安瓿瓶未开封前在规定的保存条件下可以使用的最后日期。

声明

- 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用,因用户使用或储存不当引起的损失,不属于责任范围。
- 收到后请立即核对品名、数量和质量,如发现与订单不符,请及时联系。
- 仍对质量有疑问时,请联系本研究所,如未联系,视为默认接受。
- 10个工作日内提供免费的技术支持,请与技术部联系。



销售热线: 010-57801888	服务热线: 400-019-883
邮箱: sales@china.com	
网站: www.china.com	
地址: 北京市昌平区回龙观镇	

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!

丙酮中氯氟菊酯溶液标准物质

本标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制或各种工作标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确测定的氯氟菊酯农药标准物质(GBW(E)060139)为原料,以农残级丙酮为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
氯氟菊酯,英文名称: Cypermethrin, CAS No.: 52315-07-8

二、溯源性及定值方法

本标准物质以纯度经准确测定的氯氟菊酯农药标准物质(GBW(E)060139)为原料,采用重量-容量法准确配制而成,并采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)对本批次标准物质和质量控制样品进行比对,验证配制准确,通过采用经过确认、满足计量学特性的分析方法经法定计量机构认定的分析仪器、器具及天平称量器具,确保量值溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值($\mu\text{g/mL}$)	相对扩展不确定度($\%)(k=2)$
GBW(E)085521	丙酮中氯氟菊酯溶液标准物质	100	3

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果、制备过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF 1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)按照随机抽样原则对本标准物质进行均匀性评估,评估结果表明,样品均匀性良好;采用相同量值方法进行稳定性评估,评估结果表明,样品稳定性良好。

本标准物质自定值日期起,有效期24个月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 包装: 本标准物质采用避光棕色玻璃瓶包装,约1.2mL/支,转移或稀释时请以移液管量取为准。
- 运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压、碰撞;冷藏($2\sim 8^{\circ}\text{C}$),置于阴凉处贮存。
- 使用: 开封前于室温($20\pm 3^{\circ}\text{C}$)平衡,并充分摇匀,安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次密封后作为标准物质使用。

声明

- 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用,因用户使用或操作不当所引发的损失,不予承担责任。
- 收到后请立即核对品名、数量和质量,如发现与标准物质不符,请及时反馈。
- 仅对加盖公章“标准物质控制部分”和“标准物质控制部分”的包装证书负责,请妥善保管此证书。
- 如蒙惠顾,请多与使用有关的业务,请与技术部联系。



研制单位: 中国计量科学研究院	联系电话: 4000-099-669
电子邮箱: www.gbwchina.com	
技术支持: jchu@gbwchina.com	
地址: 北京市昌平区未来科学城未来科学城二区二号楼	

14、正己烷中甲氧菊酯溶液标准物质、1.2mL, 100 $\mu\text{g/mL}$

正己烷中甲氧菊酯溶液标准物质



标准价 ¥35

优惠价 ¥35

产品编号 GBW(E)082323

CAS号 39515-41-8

规格 1.2mL

库存 ≥6

有效期 2027-12-17

品牌 坛墨质检

标准值 100 $\mu\text{g/mL}$

数量

1

储存条件 冷藏

运输条件 常温运输

图片仅供参考, 具体产品以实物为准!

正己烷中甲氧菊酯溶液标准物质

本标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制或各种工作标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确测定的甲氧菊酯农药标准物质(GBW(E)060978)为原料,以农残级正己烷为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
甲氧菊酯(别名: 芬普尼),英文名称: Fenprothrin, CAS No.: 39515-41-8

二、溯源性及定值方法

本标准物质以纯度经准确测定的甲氧菊酯农药标准物质(GBW(E)060978)为原料,采用重量-容量法准确配制而成,以配制仪器作为标准值,并采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)对本批次标准物质和质量控制样品进行比对,验证配制准确,通过采用经过确认、满足计量学特性的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值($\mu\text{g/mL}$)	相对扩展不确定度($\%)(k=2)$
GBW(E)082323	正己烷中甲氧菊酯溶液标准物质	100	2

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果、制备过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF 1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)按照随机抽样原则对本标准物质进行均匀性评估,评估结果表明,样品均匀性良好;采用相同量值方法进行稳定性评估,评估结果表明,样品稳定性良好。

本标准物质自定值日期起,有效期24个月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 包装: 本标准物质采用避光棕色玻璃瓶包装,约1.2mL/支,转移或稀释时请以移液管量取为准。
- 运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压、碰撞;冷藏($2\sim 8^{\circ}\text{C}$),置于阴凉处贮存。
- 使用: 开封前于室温($20\pm 3^{\circ}\text{C}$)平衡,并充分摇匀,安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次密封后作为标准物质使用。

声明

- 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用,因用户使用或操作不当所引发的损失,不予承担责任。
- 收到后请立即核对品名、数量和质量,如发现与标准物质不符,请及时反馈。
- 仅对加盖公章“标准物质控制部分”和“标准物质控制部分”的包装证书负责,请妥善保管此证书。
- 如蒙惠顾,请多与使用有关的业务,请与技术部联系。



研制单位: 中国计量科学研究院	联系电话: 4000-099-669
电子邮箱: www.gbwchina.com	
技术支持: jchu@gbwchina.com	
地址: 北京市昌平区未来科学城未来科学城二区二号楼	

以上信息仅供参考, 请以实物批次为准!

16、标准溶液/甲醇中8种有机氯农药混标/8 Organochlorine Pesticide Mix in Methanol、1mL, 100 µg/mL



图片仅供参考，具体产品以实物为准！

摩尔计算器

标准溶液/甲醇中8种有机氯农药混标/8 Organochlorine Pesticide Mix in Methanol

标准价 ¥340

优惠价 ¥310

产品编号 80087GA

CAS号

规格 1mL

库存 ≥6

有效期 2030-03-13

品牌 TMstandard

标准值 100µg/mL

数量

储存条件 常温，置于阴凉处

运输条件 常温运输

产品详情

甲醇中8种有机氯农药混标

Page 0 of 5/8087GA

Reference Material

This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed, produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.

Product Name(产品名称) 8 Organochlorine Pesticide Mix in Methanol(8种有机氯农药混标/8种有机氯农药)

Lot Number(产品批号)

Part Number(产品编号) 80087GA

Storage(存储条件) Room temperature, dry, dark

常温，避光保存

Expiry Date(失效日期) 2030-Mar-13

Transportation(运输条件) Normal temperature transportation
(常温运输)

CERTIFIED						
Component No. (组分号)	Peak Sequence (峰序号)	Component (组分)	CAS No.	Concentration (µg/mL) (浓度)	Relative Expanded Uncertainty (k=2) (相对扩展不确定度)	
1	1	o,p'-DDE (I, II, III)	319-84-6	100	3	
2	2	p,p'-DDE (I, II, III)	319-85-7	100	3	
3	3	p,p'-DDE (I, II, III)	50-89-9	100	3	
4	4	p,p'-DDE (I, II, III)	319-86-8	100	3	
5	5	o,p'-DDT (I, II, III)	72-55-9	100	3	
6	6	o,p'-DDT (I, II, III)	72-54-8	100	3	
7	7	o,p'-DDT (I, II, III)	789-02-6	100	3	
8	8	o,p'-DDT (I, II, III)	50-29-3	100	3	

Note

The product contains a trace of toluene (溶剂中含微量甲苯).

Intended Use

This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.

Uncertainty

The certified values (and uncertainty) are determined in accordance with ISO 17034 with an 85% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of reagents, homogeneity, stability testing.

Traceability

The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standard. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.

Homogeneity

Random replicates sampled of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.

Storage

The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.

CERTIFICATE ON	QC SIGNATURE	RM Release

Statement

- This reference material is intended solely for laboratory research and analytical testing purposes. The provider shall not be held liable for any complaints arising from improper use or storage by the user.
- Upon receipt, immediately verify the product type, quantity and packaging. Compensation, if applicable, is limited solely to the reference material itself and excludes any other associated losses.
- Responsibility is only assumed for the certificate bearing the "Special Seal for Reference Materials of TianMo Reference Materials Co., Ltd." Please safeguard this certificate.
- For additional information regarding usage, please contact the Technical Consulting Department.

以上信息仅供参考，请以实物标注为准！

18、丙酮中毒死蜥溶液标准物质、1.2mL, 100 μg/mL



图片仅供参考, 具体产品以实物为准!

丙酮中毒死蜥溶液标准物质

标准价 ¥30

优惠价 ¥30

产品编号 GBW(E)082239

CAS号 2921-88-2

规格 1.2mL

库存 ≥6

有效期 2028-06-02

品牌 坛墨质检

标准值 100μg/mL

数量

1

储存条件 冷冻

运输条件 冰袋运输

产品详情

丙酮中毒死蜥溶液标准物质

本标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制, 以及食品、卫生、环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测, 也可用于量值溯源或作为标准储备溶液, 通过逐级稀释配制或各种工作标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确测定的毒死蜥原正纯原标准物质(GBW(E)061459)为原料, 以农级级丙酮为溶剂, 采用重量-重量法准确配制而成。
毒死蜥别名: 氯吡啶磷, 英文名称: Chlorpyrifos, CAS No.: 2921-88-2

二、溯源性及定值方法

本标准物质以纯度经准确测定的毒死蜥原正纯原标准物质(GBW(E)061459)为原料, 采用重量-重量法准确配制而成, 以配制值作为标准值, 并采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)对本批次标准物质和质量控制样品进行比对, 验证配制值, 通过采用经过确认的、测定计量学特性的分析方法/经法定计量机构检定/校准的分析仪器, 量器及天平等计量器具, 确保量值溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(μg/mL)	相对扩展不确定度%(k=2)
GBW(E)082239	丙酮中毒死蜥溶液标准物质	100	3

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果、制备过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF 1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》, 采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)按照随机抽样原则对本标准物质进行均匀性评估, 评估结果表明, 样品均匀性良好, 采用相同量值方法进行稳定性评估, 评估结果表明, 样品稳定性良好。

本标准物质自生产日期起, 有效期24个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性, 有效期内如发现量值变化, 将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1. 包装: 本标准物质采用铝塑复合膜密封包装, 约1.2mL/支, 抽取或稀释时请以移液管量取为准。
2. 运输和贮存: 冰袋运输, 运输时应避免挤压、碰撞, 冷冻(-18±5)℃, 置于阴凉处贮存。
3. 使用: 开封前于室温(20±3)℃平衡, 并充分摇匀, 安瓿瓶一经打开, 应立即使用, 不可再次密封后作为标准物质使用。

声明

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用, 如用户发现或储存不善导致分配误差, 不属于质量问题。

2. 收到后请立即核对品种、数量和包装, 如发现破损及与标准物质不符, 请及时反馈给本公司。

3. 仅供内部“标准物质检验与评价”部门使用, 不得用于其他用途, 请妥善保管并签字。

4. 如需售后服务与使用相关信息, 请与技术支持部门联系。



研制单位: 坛墨质检标准物质有限公司

服务热线: 4006-099-669

官方网站: www.tanmetest.com

技术支持: support@tanmetest.com

公司地址: 山东省济南市高新区经十路18188号

20、标准溶液/甲醇中甲拌磷砒、1.2mL, 100 μ g/mL

标准溶液/甲醇中苯甲酸/2026国抽食品



标准价 ¥50

优惠价 ¥50

产品编号 BW900998-1000-A

CAS号 65-85-0

规格 2mL

库存 ≥6

有效期 2031-04-08

品牌 坛墨质检

标准值 1000 μ g/mL

数量

储存条件 冷藏(2~8)℃

运输条件 常温运输

图片仅供参考, 具体产品以实物为准!

产品详情

甲醇中苯甲酸

本标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制, 以及食品、卫生、环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测, 也可用于量值溯源或作为标准储备溶液, 通过逐级稀释配制各种工作用标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质采用纯度较高的苯甲酸纯品为原料, 以HPLC级甲醇为溶剂, 采用重量-重量法准确配制而成。

苯甲酸(别名: 羧基酸) 英文名称: Benzoic Acid CAS No.: 65-85-0

二、溯源性及赋值方法

本标准物质以配制值作为赋值, 采用高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)对本批标准物质和质量控制样品进行比对, 经检验赋值, 通过采用经过确认的、满足计量特性的分析方法经法定计量机构/校准的分析仪器, 量值及天平称量结果, 量值溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(μ g/mL)	相对扩展不确定度%($k=2$)
BW900998-1000-A	甲醇中苯甲酸	1000	2

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度赋值结果、制备过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性及稳定性考察

(依据JJF 1343-2012《标准物质定值的通用原则及统计学原理》, 对分装后的样品进行随机抽样, 对溶液浓度进行均匀性检验, 稳定性考察。结果表明, 本标准物质均匀性、稳定性良好, 本标准物质量值自赋值日期起, 有效期60个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性, 有效期间如发现量值变化, 将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1. 包装: 本标准物质采用玻璃瓶密封安瓿瓶包装, 约2mL/支, 移取或稀释时请以移液管量取为准。
2. 贮存: 常温运输, 运输时应避免挤压、碰撞; 冷藏(2~8)℃贮存。
3. 使用: 开封前于室温(20±3)℃平衡, 并充分摇匀。安瓿瓶一经打开, 应立即使用, 不可再次密封后作为标准物质使用。

声明

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用, 因用户使用或保存不当而引起的损失, 不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装, 如发现与标识不符, 请及时反馈本公司。
3. 凡购买“坛墨质检科技股份有限公司标准物质”的客户, 请妥善保管此证书。
4. 如需咨询更多使用相关信息, 请与技术支持部门联系。



销售热线: 4008-1988-669

邮箱: info@tcmq.com

网址: www.tcmq.com

地址: 山东省济南市高新区经十路10000号

21、标准溶液/丙酮中甲拌磷亚砒、1mL, 100 μ g/mL

标准溶液/丙酮中甲拌磷亚砒



标准价 ¥56

优惠价 ¥56

产品编号 BW901397-100-D

CAS号 2588-03-6

规格 1.2mL

库存 ≥6

有效期 2030-04-23

品牌 坛墨质检

标准值 100 μ g/mL

数量

储存条件 冷藏(2~8)℃

运输条件 冰袋运输

图片仅供参考, 具体产品以实物为准!

23、脂肪酸标准品 21 种、GLC-538-100mg

分析证书

日期: 2025年1月1日

GLC参考标准: GLC 538

批号: F8-G

制备人: BRIAN NUTTER 原材料来源: 多种植物油

有效期: 一旦瓶装开启, 需在良好储存条件下保存6个月
条件: 若安瓿瓶未开封并在0°C下储存, 则无限制。

链号	项目	重量%	项目 纯度%
C14:0	甲基肉豆蔻酸酯	6.0	99.8
C14:1	甲基肉豆蔻酸酯	1.0	99.5
C16:0	棕榈酸甲酯	16.0	99.9
C16:1	棕榈油酸甲酯	5.0	99.7
C18:0	硬脂酸甲酯	8.0	99.8
C18:1	甲基油酸酯	13.0	99.8
C18:1	甲基香豆酸酯	4.0	99.7
C18:2	亚油酸甲酯	2.0	99.8
C18:3	甲基亚油酸酯	2.0	99.5
C20:0	甲基花生酸酯	1.0	99.8
C20:1	甲基十一烯酸酯	1.0	99.7
C20:2	甲基11-14二十碳二烯酸酯	1.0	99.5
C20:3	甲基11-14-17二十碳三烯酸酯	1.0	99.4
C20:4	甲基花生四烯酸酯	3.0	99.4
C20:5	甲基二十碳五烯酸酯	10.0	99.4
C22:0	甲基山萘酸酯	1.0	99.8
C22:1	甲基紫檀醇酸酯	3.0	99.7
C22:6	甲基二十二碳六烯酸酯	12.0	99.6
C23:0	甲基三十四烷酸酯	8.0	99.5
C24:0	甲基木脂酸酯	1.0	99.5
C24:1	甲基神经酸酯	1.0	99.6

我们确认此批产品符合产品规格, 并已放行销售。

上述标准已精确到小数点后三位, 从而确保高精度。

25、苯并(a)芘标液、1mL, 100 μg/mL

标准溶液/乙腈中苯并[a]芘



标准价 ¥32

优惠价 ¥32

产品编号 96328a

CAS号 50-32-8

规格 1mL

库存 ≥6

有效期 2030-04-19

品牌 坛墨质检

标准值 100μg/mL

数量

1

储存条件 冷藏(2~8)℃

运输条件 常温运输

图片仅供参考, 具体产品以实物为准!

产品详情

乙腈中苯并[a]芘

本标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制, 以及食品、卫生、环境和农业等领域相关成分含量测定与残留检测, 也可用于量值溯源或作为标准储备溶液, 通过逐级稀释配制或各工作用标准溶液等。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确测定的苯并[a]芘纯品为原料, 以HPLC级乙腈为溶剂, 采用重量-重量法准确配制而成。

苯并[a]芘英文名称: Benzo[a]pyrene; CAS No.: 50-32-8

二、溯源性及赋值方法

本标准物质以配制量作为标准值, 采用有效液相色谱法-二级管阵列检测器(HPLC-DAD)对本批次标准物质和质量控制样品进行比对, 经检验赋值。通过采用经过确认、准确计量特性的分析方法, 经法定计量机构校准/校准的分析仪器、量器及天平称量器具, 溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(μg/mL)	相对扩展不确定度%(k=2)
96328a	乙腈中苯并[a]芘	100	3

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度赋值结果、制备过程、量器校准以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》, 对分装后的样品进行随机抽样, 对溶液浓度进行均匀性检验、稳定性考察。结果表明, 本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质量值自定值日期起, 有效期48个月, 研制单位将连续跟踪监测标准物质的稳定性, 有效期内如发现量值变化, 将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1. 包装: 本标准物质采用玻璃密封安瓿瓶包装, 约1mL/支, 拆瓶或拆瓶时请以标准重量计为准。

2. 运输和贮存: 常温运输, 运输时应避免挤压、碰撞, 冷藏(2~8)℃贮存。

3. 使用: 开封前于室温(20±3)℃平衡, 并充分摇匀。安瓿瓶一经打开, 应立即使用, 不可再次密封后作为标准物质使用。

声明

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用, 因用户使用或保存不当而造成损失, 不予承担责任。

2. 收到后请立即核对名称、数量及包装, 如有问题请及时与标准物质本身, 不涉及其他任何损失。

3. 对于国家“坛墨质检科技股份有限公司标准物质专项”的无验证与交易, 请妥善保管证书。

4. 如需获取更多与使用相关的信息, 请与技术部联系。



公司名称: 坛墨质检科技股份有限公司

联系电话: 4006 099 469


邮箱: www.tanmo.com

网址: www.tanmo.com

地址: 山东省济南市高新区舜华路2000号

以上信息仅供参考, 请以实物批次为准!

27、抗氧化剂标准溶液、10mL，1000 μg/mL

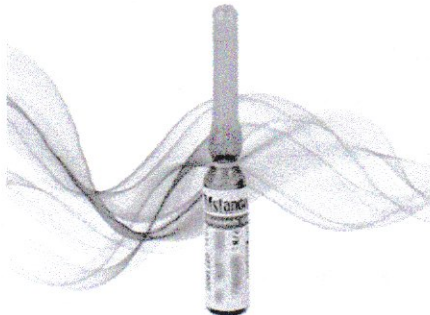

图片仅供参考，具体产品以实物为准！

摩尔计算器

标准溶液/乙腈中9种抗氧化剂混标/GB 5009.32-2016/9 Antioxidant Mix in Acetonitrile

标准价 ~~¥1300~~

优惠价 **¥ 1300**

产品编号 80861JH

CAS号

规格 1mL 库存 ≥6

有效期 2027-12-01 品牌 TMstandard

标准值 1000μg/mL

数量

储存条件 冷藏避光 运输条件 冰袋运输

组分信息			
乙腈中9种抗氧化剂混标			
序号	CAS号	名称	标准值 (μg/mL)
1	121-79-9	没食子酸丙酯	1000
2	1421-63-2	2,4,5-三羟基苯丁酮	1000
3	1948-33-0	叔丁基对苯二酚	1000
4	500-36-9	去甲二氢愈创木酚	1000
5	25013-16-5	叔丁基对羟基苯甲酸	1000
6	88-26-6	3,5-二叔丁基-4-羟基苯酚	1000
7	1034-01-1	没食子酸辛酯(OG)	1000
8	128-37-0	2,6-二叔丁基对甲酚	1000
9	1186-52-5	没食子酸月桂酯	1000

28、氢氧化钾标准储备液、500mL，C(KOH):0.5007mol/L



氢氧化钾容量分析用标准溶液

标准价 ~~¥140~~

优惠价 **¥ 140**

产品编号 BW20012-0.5-500

规格 500mL 库存 ≥6

有效期 2027-05-02 品牌 坛墨质检

标准值 0.5007mol/L

数量

储存条件 常温，置于阴凉处 运输条件 常温运输

30、硫代硫酸钠标准滴定溶液、500mL, (Na₂S₂O₃):0.1008mol/L



硫代硫酸钠容量分析用标准溶液

标准价 ¥400

优惠价 ¥100

产品编号 BW20020-0.1-W-500

规格 500mL

库存 ≥6

有效期 2027-10-08

品牌 坛墨质检

标准值 (Na₂S₂O₃):0.1020mol/Lmol/L

数量

1

储存条件 常温避光

运输条件 常温运输

产品详情

硫代硫酸钠容量分析用标准溶液

本产品适用但不限于以下标准：
GB/T 601-2016

本标准物质广泛应用于卫生、环境、医药、农业、化工、教学等领域的化学滴定分析及相关的分析方法确认与评价、测量质量控制等。

一、样品制备

本标准物质以高纯度高纯度的硫代硫酸钠、无水亚硫酸钠和符合高纯水质量的水为原料，在(20±3)℃的条件下用容量法准确称量配制而成。

二、溯源性及赋值方法

本标准物质采用容量法溯源至国家基准物质(GW/E-06018)，以容量法进行标定，以容量法进行标定，通过采用经过确认的、满足计量特性的分析方法，经法定计量机构检定/校准的分析仪器、量具及天平称量器具，测定其量值并溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值[mol/L(Na ₂ S ₂ O ₃)]	相对扩展不确定度%(k=2)
BW20020-0.1-W-500	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液	0.1020	0.5

标准值的不确定度主要由容量法、称量、终点判断、容量瓶和容量瓶的均匀性、稳定性等不确定度分量合成。

四、均匀性及稳定性考察

依据GB/T 1345-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》，对分装后的样品进行随机抽样，对标准溶液进行均匀性检验、稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质量值自定值日期起，有效期18个月，研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1. 包装：本标准物质采用避光玻璃瓶包装，500mL/瓶，瓶口密封，瓶身印有容量法溯源力值。

2. 运输和贮存：常温运输，运输时应避免挤压、碰撞、震动、潮湿、避光贮存。

3. 使用：使用前应恒温至(20±3)℃，并充分摇匀。避免发生化学变化导致溶液浓度发生变化，可按照GB/T 601附录A进行校准。本标准溶液开封后应尽快使用，避免沾污。

特别提示：

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用，用户应妥善保管，不得分装、稀释、不得用于其他用途。

2. 收到后请立即核对品种、数量、名称、规格、批号、生产日期、有效期、有效期、有效期、有效期。

3. 仅作为国家“标准物质”使用，不得用于其他用途，如用于其他用途，请按照国家标准执行。

4. 如有疑问请与本公司联系，请与本公司联系。



咨询电话：400-000-0000

网址：www.tanmo.com

电子邮箱：info@tanmo.com

地址：北京市昌平区北清路100号

以上信息仅供参考，请以实物批次为准！

32、硫酸标准滴定溶液、500mL, $c(1/2H_2SO_4):0.1012\text{mol/L}$



硫酸容量分析用溶液标准物质

标准价 ¥440

优惠价 ¥110

产品编号 GBW(E)085692

规格 500mL

库存 ≥6

有效期 2028-05-17

品牌 坛墨质检

标准值 $c(1/2H_2SO_4):0.1015\text{mol/L}$

数量

1

储存条件 常温, 置于阴凉处

运输条件 常温运输

产品详情

硫酸容量分析用溶液标准物质

本标准物质广泛应用于卫生、环保、医药、农业、化工、教学等领域的化学滴定分析及相关的分析方法确认与评价、测量质量控制等。

一、样品制备

本标准物质以纯度经准确测定的硫酸和符合国家一级标准纯度的纯水为原料, 在 $(20\pm3)^\circ\text{C}$ 的条件下采用容量法准确配制而成。

二、溯源性及测定方法

本标准物质采用无水硫酸钠标准物质(GBW(E)060315), 以容量法进行标定, 以测定其标准值。通过采用经过确认的、满足计量特性的分析方法, 经法定计量机构检定/校准的分析仪器、量具及天平称量器具, 测定其标准值并SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值($\text{mol/L}(1/2H_2SO_4)$)	相对扩展不确定度($k=2$)
GBW(E)085692	硫酸容量分析用溶液标准物质	0.1015	0.3

标准值的不确定度主要由测量重复性、称量、终点判断、硫酸的纯度标准物质、均匀性、稳定性等不确定度分量合成。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》, 采用滴定法按照随机抽样原则对本标准物质进行均匀性评估, 评估结果表明, 样品均匀性良好; 采用短期测量方法进行稳定性评估, 评估结果表明, 样品稳定性良好。

本标准物质自定值日期起, 有效期24个月。研制单位将连续跟踪监测该标准物质的稳定性, 有效期内如发现量值变化, 将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1. 包装: 本标准物质采用高密度聚乙烯(HDPE)瓶包装, 500mL/瓶, 每瓶或每箱时须以标准物质量为度。
2. 运输和贮存: 常温运输。运输时应避免挤压、碰撞; 常温, 置于阴凉处贮存。
3. 使用: 使用前应恒温 $(20\pm3)^\circ\text{C}$, 并充分摇匀。温度变化会导致溶液体积发生变化, 可根据GB/T601附录A进行体积校正。本标准物质开封后应尽快使用, 避免玷污。

其他:

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用, 用户使用时应遵守不损坏包装的说明, 不承担责任。
2. 收到后请立即核对标签、数量及包装, 如发现与标签不符或物质本身、包装有其他异常时, 请及时反馈。
3. 在对国家“坛墨质检科技股份有限公司标准物质专用章”的认证证书负责, 确保量值准确可靠。
4. 如需获取更多信息或有任何疑问, 请与技术支持部门联系。



研制单位: 坛墨质检科技股份有限公司	联系电话: 4008-099-609
官方网站: www.gbwchina.com	
电子邮箱: yjhu@gbwchina.com	
公司地址: 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣陵大道118号16楼1608室	

以上信息仅供参考, 请以实物批次为准!

34、磷化物标准溶液、100 μg/mL，30mL



标准溶液/水中磷/介质:1%盐酸

标准价 ¥70

优惠价 ¥70

产品编号 BW30025-1000-C-50

规格 50mL 库存 ≥6

有效期 2029-04-01 品牌 坛墨质检

标准值 1000mg/L

数量 1

储存条件 常温, 置于阴凉处 运输条件 常温运输

水中磷

本标准物质主要用于微量磷含量、分析方法验证与评价、测量过程质量控制,也可用于测量溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液。

一、样品制备
本标准物质以磷酸盐溶液经二级稀释,经中和符合国家一级标准物质的纯水为原料,在(20±3)℃的条件下采用重量法由主盐准确配制而成。

二、溯源性及检测方法
本标准物质以磷酸盐作为标准物质,采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)进行量值溯源,通过国家经过认证的、测量值量值特性的分析方法,经法定的量值溯源/浓度的分析仪器、量具及天平称量试剂,确保量值溯源至SI基本单位。

三、特性量值及不确定度

编号	名称	标准值(mg/L)(P)	相对扩展不确定度%(k=2)	基体(V/V)
BW30025-1000-C-50	水中磷	1000	1	1%盐酸

标准值的不确定度综合考虑了原料纯度、称量过程、量值溯源以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量。

四、均匀性及稳定性考察
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评价》,对分装后的样品进行随机抽样,对每瓶溶液进行均匀性检验,稳定性考察,结果证明,本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质量值自定值日期起,有效期36个月,研制单位将持续跟踪监测该标准物质的特性,有效期内的量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

- 包装: 本标准物质采用高密度聚乙烯(HDPE)瓶包装,50mL/瓶,转移或稀释时请以标准量取为要。
- 运输和贮存: 常温运输,运输时应避免剧烈震动、碰撞、需避光、置于阴凉处贮存。
- 使用: 使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇匀。本标准物质开封后应尽快使用,避免污染。

附注:

- 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用,因用户使用或储存不当而造成损失,不予赔偿。
- 收到后请立即核对品名、数量与包装,如发现与标称不符,请及时反馈。
- 仅对国内“坛墨质检科技股份有限公司标准物质业务”对质监证书负责,请妥善保管证书。
- 如有疑问或多项使用相关问题,请与技术支持部门联系。



技术支持: 010-57010868-202


邮箱: info@tanjie.com

网址: www.tanjie.com

地址: 北京市昌平区回龙观镇龙域村101号2层201室

以上信息仅供参考,请以实物标注为准!

35、棉酚标准储备液、1000 μg/mL，1mL

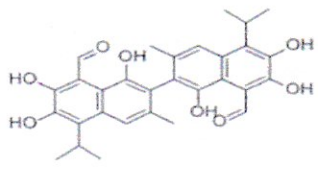

丙酮中棉酚溶液, 1000μg/mL

Gossypol Solution in Acetone, 1000μg/mL

请登录 标准价: 请登录

产品号: 1ST7506-1000B

CAS号: 303-45-7

分子式: C30H30O8 分子量: 518.55

规格: 1000μg/mL, 1mL 品牌: First Standard

纯度: 有效期: 2027/01/07

浓度: 1000μg/mL 储存条件:

运输条件:

中文同义名: 游离棉酚

英文同义名:

38、支链淀粉标准溶液、1mg/mL, 100mL



图片仅供参考，具体产品以实物为准！

摩尔计算器

马铃薯支链淀粉标准溶液/有证书/有效期6个月

标准价 ¥270

优惠价 ¥270

产品编号 BW1750-100mL

CAS号 9037-22-3

规格 100mL

有效期

标准值 1mg/mL

数量

储存条件 冷藏避光

库存 0

品牌 中国

运输条件 冰袋运输

产品详情

马铃薯支链淀粉标准溶液

分析项目名称	浓度	规格
马铃薯支链淀粉溶液	1mg/ml	100mL

以上信息仅供参考，请以实物批次为准！

39、α-生育酚标准品、CAS: 59-02-9, 99.8%, 100mg



图片仅供参考，具体产品以实物为准！

标准品/α-生育酚/(+)-α-Tocopherol

标准价 ¥195

优惠价 ¥195

产品编号 71031-100mg

CAS号 59-02-9

规格 100mg

有效期 2029-09-17

标准值 99.0%

数量

储存条件 冷藏避光

库存 ≥6

品牌 TMstandard

运输条件 常温运输

产品详情

α-生育酚

Page 0 of 071031-100mg-

Reference Material
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed, produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.

Product Name(名称)	(+)-α-Tocopherol(α-生育酚)	
Product Code(编号)	Lot Number(批号)	CAS No.
71031-100mg	-	59-02-9
Mol. Weight(分子量)	Mol. Formula(分子式)	Expiry Date(失效日期)
430.71	C ₅₅ H ₁₀₀ O ₂	2029-Sep-17
Appearance(外观)	Storage Temp(存储条件)	Transportation(运输条件)
Liquid(液体)	(2-8)°C/冷藏, 避光	Normal temperature transportation(常温运输)

Cc1cc(C)c(C)c(C)c1C/C=C/C(C)CCCC(C)C

Test Items(检测项目)	Method(检测方法)	Results(检测结果)
Purity(纯度)	GCFID	99.0%
Uncertainty(不确定度)		0.5%

Comment

1. The calculation of the 100% method follows the formula:
Assay(%)=(100%-Water Content)*Purity(%)100%

2. The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17024 with an 95% confidence level(v2);
Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of characterization, homogeneity and stability testing. Stability values are based on real evidence opposed to simulation.

CERTIFICATE ON	QC SIGNATURE	RM Release
		

41、 γ -生育酚标准品、CAS: 54-28-4, 99.5% 100mg

标准品/D-γ-生育酚/γ-Tocopherol



标准价 ~~¥1500~~

优惠价 ¥ 1500

产品编号 75398-100mg

CAS号 54-28-4

规格 100mg

库存 ≥6

有效期 2030-01-31

品牌 TMstandard

标准值 99.4%

数量

1

儲存條件 常溫避光

运输条件 常温运输

图片仅供参考，具体产品以实物为准！

产品详情


D-γ-生育酚

Page 5 of D75365-100mg.-

Reference Material

This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed, produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.

Product Name(名称)	γ-Tocopherol(γ-生育酚)	
Product Code(编号)	Lot Number(批号)	CAS No.
75398-100mg	-	54-28-4
Mol. Weight(分子量)	Mol. Formula(分子式)	Expiry Date(失效日期)
416.68	$C_{55}H_{84}O_2$	2030-Jan-31
Appearance(外观)	Storage Temp(存储条件)	Transportation(运输条件)
粘稠液体	Normal temperature, dark 常温、避光	Normal temperature transportation(常温运输)



Test Items(检测项目)	Method(检测方法)	Results(检测结果)
Identification(鉴别)	GC/MS	Conforms(符合)
Purity(纯度)		99.4%
Uncertainty(不确定度)		1.0%

Comment

1.The calculation of the 100% method follows the formular:

Water Content: (g/g) by Karl Fischer.

2. The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level ($k=2$).

Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of characterisation, homogeneity and stability testing. Stability values are based on real evidence opposed to simulation.

CERTIFICATE ON	QC SIGNATURE	
	<i>Hoguard</i>	RIM Release

43、 γ -生育三烯酚, 100mg, 99%、100mg, 99%

产品详情	安全信息	技术资料
中文名称:	γ -生育三烯酚	
英文名称:	Gama-Tocotrienol	
CAS号:	14101-61-2	
分子式:	C ₂₈ H ₄₂ O ₂	
分子量:	410.60	

44、 δ -生育三烯酚, 100mg, 99%、100mg, 99%

产品详情

中文名称:	δ -生育三烯醇	中文别名:	δ -生育三烯醇
英文名称:	D- δ -Tocotrienol	CAS:	25612-59-3
产品分类:		纯度:	99.00%
标准名称:	δ -生育三烯酚	英文名称:	δ -Tocotrienol
CAS:	25612-59-3	分子式:	C ₂₇ H ₄₀ O ₂
分子量:	396.605308532715	颜色与性状:	Oil
密度:	1.0±0.1 g/cm ³	沸点:	517.30°C.@760.00mmHg(est)
熔点:	No data available	水溶性:	

45、 β -生育三烯酚, 5mg, 98%、5mg, 98%

产品详情	安全信息	技术资料
中文名称:	β -生育三烯酚	
英文名称:	β -Tocotrienol	
CAS号:	490-23-3	
分子式:	C ₂₈ H ₄₂ O ₂	
分子量:	410.63	

48、顺环氧七氯标准溶液、100μg/mL，1mL/瓶



图片仅供参考，具体产品以实物为准！

标准品/正己烷中顺-环氧七氯

标准价 ¥80

优惠价 ¥80

产品编号 NYHD005291

CAS号 1024-57-3

规格 1mL

库存 0

有效期

品牌 中国农业科学院

标准值 100μg/mL

数量 +

储存条件 冷藏避光

运输条件 冰袋运输

49、亚硝酸盐标准溶液、200mg/L，50mL



标准品/水中亚硝酸盐

标准价 ¥73

优惠价 ¥73

产品编号 SRM-C13M1BAO

规格 50mL

库存 0

有效期

品牌 中国

标准值 c(NO₂-)=200μg/mL

数量 +

储存条件 常温避光

运输条件 常温运输

50、硝酸盐标准溶液、200mg/L，50mL



标准溶液/水中硝酸盐氮(以氮计)

标准价 ¥70

优惠价 ¥70

产品编号 定制BW20099-200-50

规格 50mL

库存 0


有效期

品牌 坛墨质检

标准值 200mg/L

数量 +

53、矢车菊素 3-O 葡萄糖苷标准品、分析标准品, ≥98.0%, 10mg

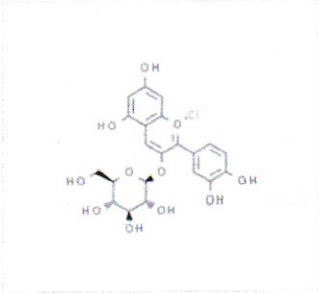


大包装询盘 加入购物车

矢车菊素-3-O-葡萄糖苷
Cyanidin-3-O-glucoside chloride

CAS No.: 7084-24-4 分子式: C₂₁H₂₁ClO₁₁ 分子量: 484.84 存储: -20°C in dark

产品编号	规格	标准值	标准价	货期
S44248-20mg	20mg	分析标准品, ≥98.0%	咨询	现货
S44248-100mg	100mg	分析标准品, ≥98.0%	咨询	现货
S44248-10mg	10mg	分析标准品, ≥98.0%	咨询	现货

54、芦丁标准品、0.983, 10mg

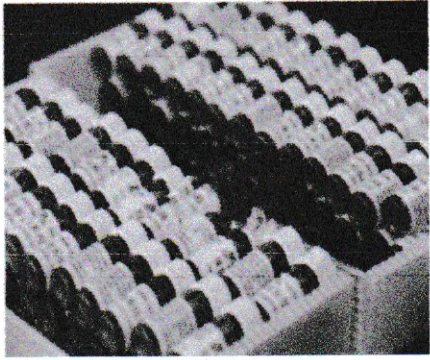

图片仅供参考, 具体产品以实物为准!

对照品/芦丁(UV级)

标准价 ¥80
优惠价 ¥80

产品编号 A0103
CAS号 153-18-4
规格 20mg 库存 0
有效期 品牌 中国
标准值 UV≥98%
数量 [+](#) [-](#)
储存条件 冷藏避光 运输条件 冰袋运输


产品详情

芦丁(UV级)

产品名称 (Product Name)	Rutin芦丁	
产品编号 (Product NO)	A0103	
产品规格 (specifications)	20mg	
CAS 编号 (CAS NO)	153-18-4	
分子式 (Molecular formula)	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	
分子量 (Molecular weight)	610.51	
项目 (Items)	标准 (Specifications)	分析结果 (Analysis Results)
性状 (Appearance)	浅黄色针状结晶	符合 (Conforms)
干燥失重 (Loss on drying)	≤2.0%	符合 (Conforms)
含量 (Assay by UV)	≥98.0%	98.0%
稳定期 (expiry date)	2年 (2 years)	
贮存条件 (Storage)	密封遮光, 置于阴凉干燥处 (Store in a cool and dry area, sealed and keep from direct light)	

以上信息仅供参考, 请以实物批次为准!

59、谷子支链淀粉标准品、1mg/mL，100mL

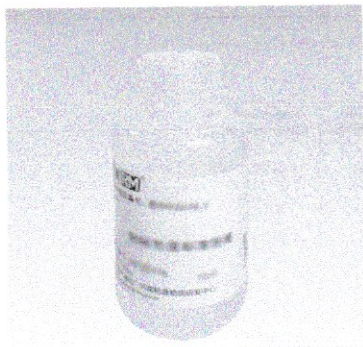


温馨提示：图片均为真实拍摄，仅供参考；如遇新包装上市可能存在更新滞后，请以实物为准！

谷子支链淀粉标准溶液

标物编号: BW1750-4	英文名称:
CAS NO: 9037-22-3	标准值: 1mg/mL
产品规格: 100mL	保存条件: 2-8℃
库存状态: 1-3天	产品价格: ￥1000.00
有效期至:	品 牌: BWRM
购买数量: 1	

60、小麦支链淀粉标准品、1mg/mL，100mL

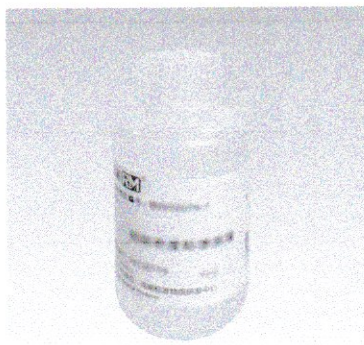


温馨提示：图片均为真实拍摄，仅供参考；如遇新包装上市可能存在更新滞后，请以实物为准！

小麦支链淀粉标准溶液

标物编号: BW1750-5	英文名称:
CAS NO: 9037-22-3	标准值: 1mg/mL
产品规格: 100mL	保存条件: 2-8℃
库存状态: 少量现货	产品价格: ￥1000.00
有效期至: 2026-12-15	品 牌: BWRM
购买数量: 1	

61、高粱支链淀粉标准品、1mg/mL，100mL

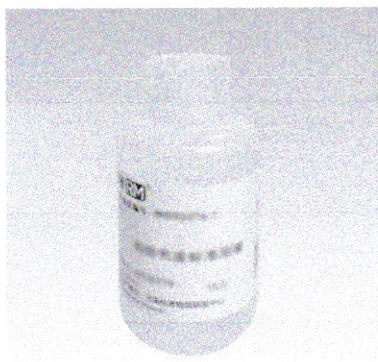

温馨提示：图片均为真实拍摄，仅供参考；如遇新包装上市可能存在更新滞后，请以实物为准！

高粱支链淀粉标准溶液

标物编号: BW1750-3	英文名称:
CAS NO: 9037-22-3	标准值: 1mg/mL
产品规格: 100mL	保存条件: 2-8℃
库存状态: 少量现货	产品价格: ￥1000.00
有效期至: 2026-12-15	品 牌: BWRM
购买数量: 1	

65、小麦粉中总汞质控样品、10g，0.06±0.01mg/kg



图片仅供参考，具体产品以实物为准！

质控样品/小麦粉中总汞分析质控样品

标准价 ¥800

优惠价 ¥800

产品编号 TMQC0946

CAS号

规格 10g

库存 0

有效期

品牌 坛墨质检

标准值 0.06±0.01mg/kg

数量

1

储存条件 常温，置于阴凉处

运输条件 常温运输

66、大米加工精度实物标准、粳米加工精度标准样品(精碾, 适碾)500g/包, 2包/套



温馨提示：图片均为真实拍摄，仅供参考；如遇新包装上市可能存在更新滞后，请以实物为准！

粳米加工精度标准样品(精碾、适碾等级)

标物编号: SH-01191

英文名称:

CAS NO:

标准值: 1-2级

产品规格: 500g/包 2包/套

保存条件: 详情请联系在线客服。

库存状态: 1周

产品价格: 询价

有效期至:

品牌: 中国

购买数量:

1

加入购物车

在线咨询

67、小麦粉加工精度实物标准、精制粉, 标准粉/套, 200g/包, 2包/套



温馨提示：图片均为真实拍摄，仅供参考；如遇新包装上市可能存在更新滞后，请以实物为准！

小麦粉加工精度标准样品

标物编号: SH-260303

英文名称:

CAS NO:

标准值: (精制粉和标准粉)

产品规格: 200g/包 2包/套

保存条件:

库存状态: 1周

产品价格: 询价

有效期至:

品牌: 中国

购买数量:

1

加入购物车

在线咨询

71、C18 固相萃取柱、2000mg/12mL，20 根/盒

艾杰尔固相萃取柱Cleanert S C18 (封端) S18200012

2g/12ml，20支

产品描述:


Cleanert® S C18 是以高纯球型硅胶为基质的反相C18 萃取柱。与普通C18 材料比较，球型材料均匀度更高，流速更稳定；高纯的硅胶表面，避免了对碱性与极性物质的过度吸附，更适合用于萃取低浓度分析物；

该材料具有高键合密度，低流失，高回收率等特点。主要应用于血液，血浆，尿液中药物及其代谢物、蛋白，DNA 等大分子样品的脱盐、环境水样中的有机物的富集等。

产品参数:

平均粒径: 50 μm ；**平均孔径:** 60 $\text{\AA}$ ；**比表面积:** 600 m^2/g ；

75、聚乙烯吸油蓝膜、13cm*18cm, 1000 张

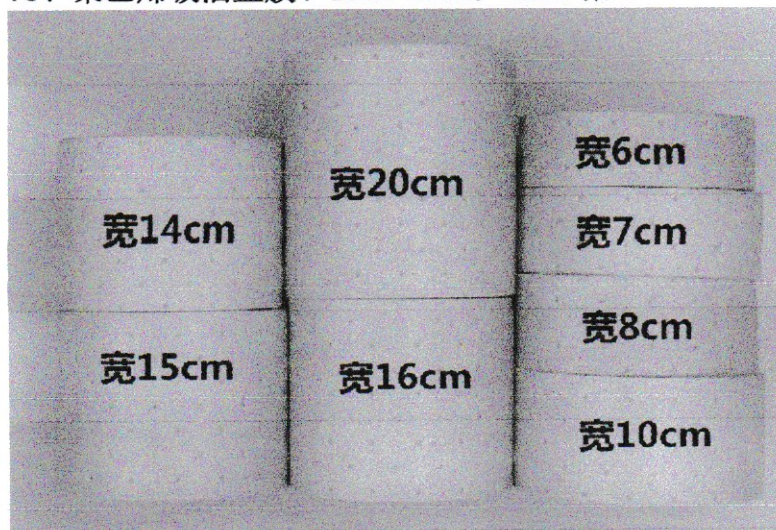

76、C18 液相色谱柱、204210-308, 1.8um, 2.1x100mm

Altura Ultra Inert HPLC Columns

部件号: 204210-308

Altura ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱, 1.8 μ m, 2.1 x 100 mm. 采用超高性能技术, 可改善峰型和样品回收率。能够在高达 1200 bar 下保持稳定, 使复杂样品获得快速、高分离度分离。

★ 添加到收藏夹

含税价格:

CNY 10,429.90

加入购物车

有现货



特性

pH 范围	2-9
保护剂	无
保护柱	No
样品兼容性	在空载下保存
内径 (ID)	2.1 mm
外壳材质	不锈钢
品牌	Altura Zorbax Eclipse Plus C18
填料类型	硅胶
孔径	95 Å
应用	LC 和 LC/MS
最高温度	60 °C
溶剂兼容性	生物活性
型号	Eclipse Plus C18
部件	Ultra Inert SS
粒径	1.8 μ m
重量	88 g
长度	100 mm
耐压能力	1200 bar

78、酰氨基柱、683775-913, 2.1x150mm, 2.7um

AdvanceBio Glycan Mapping

部件号: 683775-913

AdvanceBio 糖谱分析 120Å, 2.1 x 150 mm, 2.7 µm. 此色谱柱采用供体多孔颗粒填料与酰胺 HILIC 键合相, 能够在 < 600 bar 的压力下提供高分离度。


★ 高达 2000 载重 ★

含税价格

CHF 11,834.49

库存

有现货

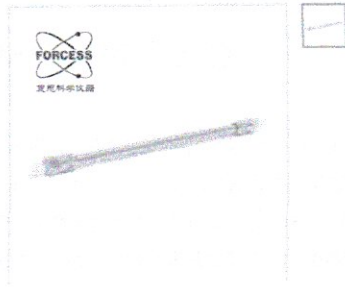

特性

Part Number Application	糖谱分析
Part Number Application Domain	生物科学
UNSPSC Code	43115711
pH 范围	2-7
溶剂相	乙腈/水
内径 (ID)	2.1 mm
化学键合	HILIC
品牌	AdvanceBio 糖谱分析色谱柱
填料类型	多孔颗粒
孔径	120 Å
填料	LC 和 LC/MS
最高温度	40 °C
溶剂兼容性	乙腈/水
相	酰胺 HILIC
操作	SS
粒径	2.7 µm
长度	150 mm
最大压力	600 bar

82、气相自动进样针、5190-1483, 10μL

气相色谱自动进样针
部件号: 5190-1483

手动进样针, 10 μL, 固定式针头, 斜面针尖. 适用于 1-8 μL 进样. 带斜面针尖的通用针头. 从安瓿或样品瓶中转移液体以及手动气相色谱进样的理想选择. 精密型 26 AWG 针头可减少样品的交叉污染.

★ 添加到收藏夹 ▼

含税价格:
CNY 490.42

数量 加入购物车
有现货



特性

UNSPSC Code	41122000	
体积	10 μL	
技术	GC	GC 和 GC/MS
密封隔膜材料	不锈钢	
针头类型	固定	
针头规格	26	
针头长度	50 mm	
针头类型	斜面	

83、气相自动进样针、G4513-80203, 10μL


GC Autosampler Syringes
部件号: G4513-80203

ALS 进样针, 蓝色系列, 10 μL, 固定式针头, 23-26/42/锥形针尖, 带 PTFE 头推杆. 23-26S 锥形针头气密进样针. 建议用于 1-8 μL 进样. 可更换推杆, G4513-80227.

★ 添加到收藏夹 ▼

含税价格:
CNY 1,221.53

数量 加入购物车
有现货

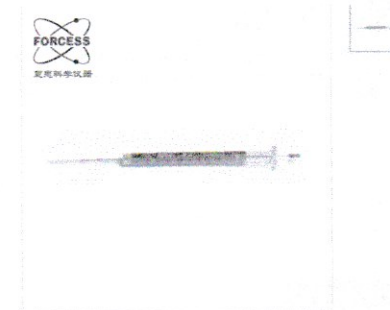

特性

UNSPSC Code	41122000	
体积	10 μL	
技术	GC	GC 和 GC/MS
密封隔膜材料	PTFE	
针头类型	固定	
针头规格	23-26s	
针头长度	42 mm	
针头类型	锥	

86、气相柱螺母、货号 05988-20066

GC/MS 仪器备件

部件号:05988-20066

Column nut for MS interface. GC/MS 传输线的备用接头。

☆ 添加到收藏夹


含税价格:

CNY 281.37

数量

添加到购物车

有现货

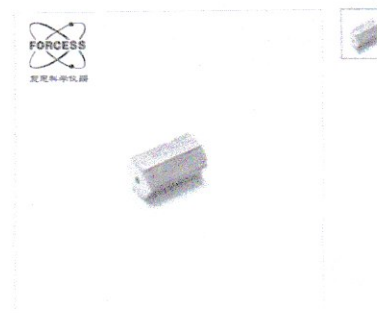

特性

Product Sub Model	Long		
UNSPSC Code	41113000		
产品类型	柱螺母		
仪器型号	5973	5975	5977
	7000A	7000B	7000C
	7200		
适用类型	柱螺母		

87、气相柱螺母、货号 G3440-81013

手拧式柱螺帽

部件号:G3440-81013

色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于 MSD

☆ 添加到收藏夹


含税价格:

CNY 1,463.35

数量

添加到购物车

有现货

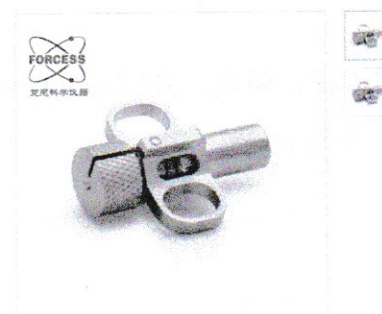

90、气相进样口隔垫、0418952ZA, 25 个/盒

商品详情

型号: 227-35004-01 器材类型: 气相耗材 品牌: 复思 产地:

颜色分类: 0418952ZA耐高温(25个),227-...

227-35004-01高级绿色不粘连隔垫可以耐最高温度350℃, 不会有流失, 能更好的减小检测带来的污染。

0418952ZA红色隔垫是能耐450℃的不粘连隔垫, 是最好的隔垫了。

91、气相进样口隔垫、5183-4757, 50 个/盒


分流/不分流进样口
部件号:5183-4757

Inlet septa, bleed and temperature optimized (BTO), non-stick, 11 mm, 50/pk. 流失与温度优化 (BTO) 隔垫适用于安捷伦分流/不分流 (S/SL) 进样口、程序升温气化 (PTV) 进样口和多模式进样口 (MMI)。适用进样口温度高达 400 °C。经过预老化, 即取即用。

原图放大预览

含税价格
CNY 1,288.20

有现货

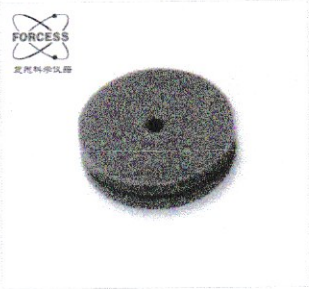

特性	
UNSPSC Code	41115715
标准	GC 和 GC/MS
最高温度	400 °C
材料	硅橡胶
直径	11 mm
组件类型	进样口隔垫
隔垫类型	BTO

92、石墨压环、221-81162-01, Bore 0.43, 6 个/板

93、石墨压环、221-81162-02, Bore 0.5, 6 个/板

ClickTek Ferrule		
部件名称	部件编号	注释
ClickTek连接器	221-77155-41	
ClickTek窄孔径套管 0.43	221-81162-01	
ClickTek 中缸径 0.5 口径 Ferrule	221-81162-02	

94、石墨压环、S227-35006-01, Bore 0.5, 10 个/盒

227-35006-01 石墨压环0.5

毛细管柱连接用部件		
部位名称	部位编号	备注
螺母(有狭缝)	221-32705-84	5个装
螺母(无狭缝)	221-16325-81	10个装
石墨压环0.5	227-35006-01	10个装外径0.5 mm以下的色谱柱用

97、石墨压环、5080-8853, 0.32, 10 个/盒

热导检测器 (TCD)
部件号:5080-8853

石墨密封垫圈, 短型, 内径 0.5 mm, 适用于 0.32 mm 色谱柱, 10/包

★ 添加到收藏夹 ▼

含税价格
CNY 796.65

数量 添加到购物车

有现货



特性

UNSPSC Code	41115717		
兼容的色谱柱内径	0.1-0.32 mm		
内径 (ID)	0.5 mm		
密封垫圈类型	毛细管		
技术	GC		
最高温度	450 °C		
材料	石墨		
检测器兼容性	Electron Capture Detector Sulfur Chemiluminescence Detector	Flame Ionization Detector Thermal Conductivity Detector	Nitrogen Phosphorus Detector
组件类型	密封垫圈		

98、石墨压环、500-2114, 0.25, 10 个/盒

Graphite Ferrules for GC
部件号:500-2114

密封垫圈, 内径 0.4 mm, 石墨, 适用于 0.05 mm 至 0.25 mm 色谱柱, 10/包. 适用于高达 450 °C 的柱温箱温度。推荐用于大多数选择性 GC 检测器。

★ 添加到收藏夹 ▼

含税价格
CNY 541.27

数量 添加到购物车

有现货



特性

UNSPSC Code	41115717		
兼容的色谱柱内径	0.05-0.25 mm		
内径 (ID)	0.4 mm		
密封垫圈类型	毛细管		
技术	GC		
最高温度	450 °C		
材料	石墨		
组件类型	密封垫圈		

101、衬管、5190-2295（分流）

散装气相色谱备件

部件号: 5190-2295

进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛

★ 添加到收藏夹

含税价格

CNY 775.18

收藏

立即购买

预计发货时间 7月7日



Agilent

5190-2295

特性

UNSPSC Code	41115715
体积	870 μ L
兼容性	双端进
内径 (ID)	4 mm
惰性化	超高惰性
外径 (OD)	6.25 mm
玻璃毛	玻璃毛
组件类型	进样口衬管
衬管几何结构	单端 LPD
材料类型	分流
长度	78.5 mm

102、衬管、5183-4711（分流）

Split Liners for GC

部件号: 5183-4711

Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated. 圆锥衬管中的玻璃毛位于中部, 可有效捕集高沸点化合物和非挥发性物质, 同时减少液源形成。锥形设计可确保分析物有效转移到色谱柱中, 减少峰展宽并改善峰形。

★ 添加到收藏夹

含税价格

CNY 558.22

收藏

立即购买

有现货



Agilent

5183-4711

特性

UNSPSC Code	41115715
体积	870 μ L
兼容性	双端进
内径 (ID)	4 mm
惰性化	标准去活
外径 (OD)	6.25 mm
玻璃毛	玻璃毛
组件类型	进样口衬管
衬管几何结构	单端
材料类型	分流
长度	78.5 mm

107、O 形圈、5188-6405

产品简介

供货周期	一周	货号	5188-6405
应用领域	医疗卫生,化工,生物产业,石油		

108、载气净化装置、SHC-B1030-S8, 1 个

1 岛津原厂气体过滤器	2 SHC-B1030-S8精准适配	3 S226-50730-00认证编号	4 气体过滤高精度效能	5 实验室器材专用配件
原厂制造质量,适用于岛津设备,确保仪器运行稳定可靠。	型号SHC-B1030-S8,精准适配实验室设备,提升工作效率。	通过认证编号S226-50730-00,确保产品符合标准规范。	高精度气体过滤效能,有效去除杂质,保障实验数据准确。	专注于实验室器材设计,提升设备性能,延长使用寿命。

岛津气体过滤器SHC-B1030-S8- 气体过滤器S226-50730-00, 实验室用气体过滤器, 专业过滤效能。适用于各类实验室环境, 确保气体纯度与设备稳定运作。采用岛津品牌技术, 提供高质量过滤解决方案。高质量过滤效能与稳定性- 岛津SHC-B1030-S8气体过滤器适用于多种气体纯化需求, 能有效去除杂质与微粒, 确保实验结果准确可靠。此过滤器型号为S226-50730-00, 适用于实验室器材过滤应用, 具备优良的耐化学性与长期稳定性, 提升仪器使用寿命与运作效率。适用于实验室与精密仪器环境- 此款气体过滤器专为实验室用气体过滤设计, 适用于多种分析仪器与气体输送系统。岛津品牌过滤器以高质量标准制造, 确保过滤过程中的安全性与稳定性, 广泛应用于科研、检测与工业实验场景, 提升整体作业质量与效率。提升实验精度与操作安全性- 岛津SHC-B1030-S8气体过滤器可有效减少气体中的污染物质, 确保实验数据准确, 降低设备故障风险。此SHC-B1030-S8气体过滤器采用专业设计, 提升实验室整体气体纯度与操作安全性, 满足高标准检测需求。专业气体过滤设备的首选- 岛津作为知名实验室器材品牌, 其SHC-B1030-S8气体过滤器提供稳定过滤性能与可靠品质, 是实验室与精密仪器应用的理想选择。选择岛津品牌过滤器, 确保气体纯度与实验结果的精准度, 提升整体作业效率与设备寿命。

109、载气净化装置、RMSH-2 CP17973(指示)

气体净化系统

部件号:CP17973

Gas Clean 载气净化器 载气或 GC/MS 或三重气体净化过滤器。更快实现稳定, 提高气相色谱分析效率, 去除 MS 载气中的氧气、水分和烃类, 更好地保护气相色谱柱。

★ 添加到收藏夹 ▼

含税价格:

CNY 3,631.82

数量

有现货



特性

UNSPSC Code	41104900
气体过滤器类型	Combination (Universal)

112、开口螺母、221-32705,

石墨压环

部件名称	部件编号	备注
螺母 (开口)	221-32705-84	5个装、石墨压环用
螺母 (不开口)	221-16325-81	10个装、石墨压环用

113、石墨压环、221-32126-05, 10 个/包

产品编号	产品名称	规格型号
221-32126-05	石墨压环	FERRULE CAP ASSM 0.5MM (10PC) 小口径毛细管用 10粒/盒
221-32126-08	石墨压环	FERRULE CAP ASSM 0.8MM (10PC) 大口径毛细管用 10粒/盒
221-15563-91	石墨压环	Ferrule, Graphite, 5 mm ID, for 5mm OD Gla ss Packed Columns-Inlet Liners-Inj & Det Ad apters, 4 pack 岛津玻璃柱用 4只/盒
221-10076-91	石墨压环	FERRULE GRAPH TCD ALL GC'S 10/PK岛 津TCD用 10只/包
221-15561-91	石墨压环	Glass Column Joint Kit set for GC 用于玻璃填充柱

114、气质灯丝、G7005-6006, 1 个/盒

GC/MS 仪器备件

部件号: G7005-60061

Filament, high temperature, Ei ion source. 用于 5973、5975 和 5977 MSD 的电子轰击 (EI) 离子源。不与 HES 配套使用。

★ 添加到收藏夹

含税价格
CNY 2,687.14

数量

添加到购物车


有现货



特性

Product Sub Model	High temp
UNSPSC Code	41113000
产品类型	灯丝
仪器型号	5973 5975 5977
	7000A 7000B 7000C
	7200

- 117、原子荧光玻璃进样针、5 根/盒
118、原子荧光样品管、100 支/包
119、原子荧光电炉丝、10 个/包

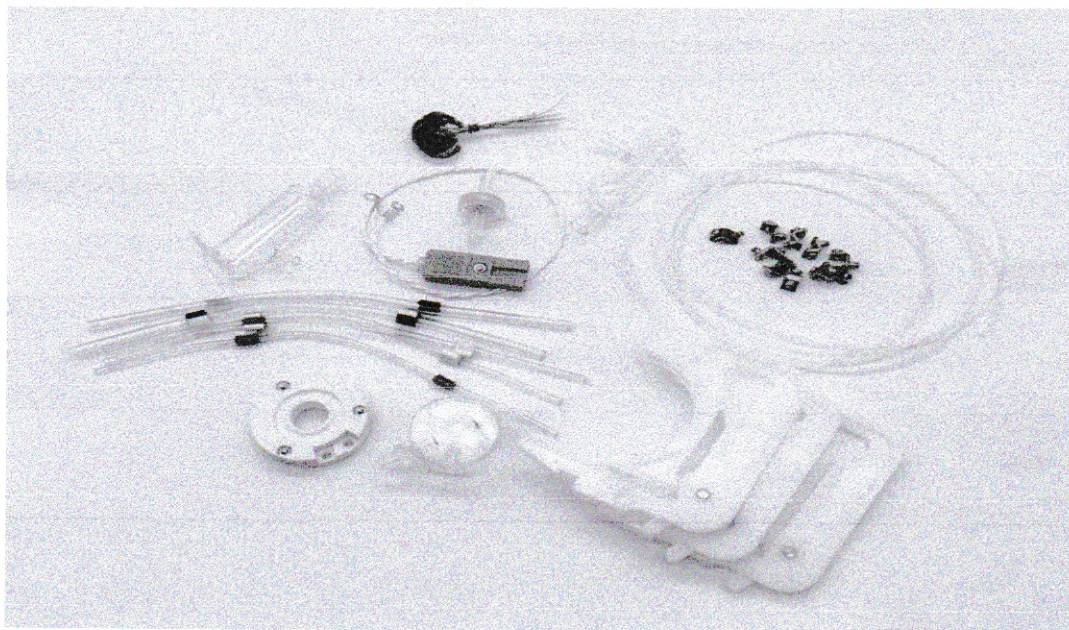

参数规格

货号	规格	价格 (RMB)
原子化器	原子化器	1500
泵管	泵管	65
混合反应块	混合反应块	180
进样针	进样针	150
一级气液分离器	一级气液分离器	65
二级气液分离器	二级气液分离器	65
炉丝	炉丝	100
连接管	连接管	200
接线柱	接线柱	100
气液隔离装置	气液隔离装置	100
瓷片	瓷片	180
泵压片	泵压片	120
原子化器电源线	原子化器电源线	180
小泵头	小泵头	300
毛细管	毛细管	100
电源线	电源线	120
样品管 (10ml)	样品管 (10ml)	380
样品管 (50ml、10个)	样品管 (50ml、10个)	100
橡胶泵管	橡胶泵管	130
压块	压块	100
管路 (普通)	管路 (普通)	600
管路 (升级版)	管路 (升级版)	1500

121、C18 液相色谱柱、990967-902Eclipse XDB-C18 4.6x2505u Analytical

ZORBAX Eclipse XDB

部件号: 990967-902

ZORBAX Eclipse XDB-C18 HPLC 色谱柱, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar. 增强极性化合物的保留能力, 确保尖锐清晰的峰形。药品和环境检测中复杂样品分析的理想色谱柱。


请注册并登录

含税价格

CNY 8,392.51

请注册并登录

管理

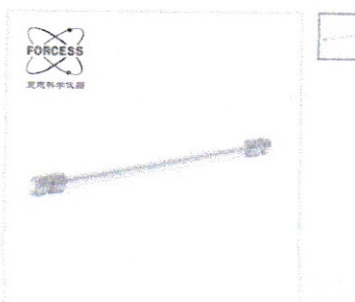

特性

UNSPSC Code	41115709		
USP 药典通则	C1		
pH 范围	2-9		
固定相	F80/3		
保护柱	No		
内径 (ID)	4.6 mm		
分子量上限	3000 Da		
分子量下限	0 Da		
流速范围	0-10 mL/min		
品牌	ZORBAX		
材料组成	全塑料		
包装	80 A		
材质	聚四氟乙烯		
使用温度	-40 °C (pH 6-9) 60 °C (pH 2-6)		
适用检测方法	HPLC		
适用的标准	ASTM D5297	ASTM D5837	ASTM D6844
	ASTM E2037		
系列	Eclipse XDB C18		
颗粒	球形		
粒径	5 µm		
负载量	10 %		
长度	250 mm		
耐压能力	400 bar		