咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2026]355号

项目名称：监护仪、输液泵、注射泵采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西博铭生物科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西博铭生物科技有限公司

甲方根据需求委托开瑞项目管理有限公司对咸阳市中心医院麻醉机等医疗设备采购项目采购包3：监护仪、输液泵、注射泵）进行国际招标，项目编号为【KRDL】K3-2607138，确定乙方陕西博铭生物科技有限公司为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签订本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件 DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	全院各临床科室	监护仪	监护仪（病人监护仪）	病人监护仪	ePM 12	深圳迈瑞	144	全套质保5年	11800.00	1699200.(
2		输液泵	输液泵	输液泵	BeneFusion uVP	深圳迈瑞	141	全套质保5年	3650.00	514650.(
3		注射泵	注射泵	注射泵	BeneFusion uSP ex	深圳迈瑞	30	全套质保5年	2350.00	70500.0(
合同总价：人民币贰佰贰拾捌万肆仟叁佰伍拾元整（大写），￥2284350.00元（小写）										

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后30个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

个日历天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《安装验收单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

三、付款方式

3.1 合同总价款：**人民币贰佰贰拾捌万肆仟叁佰伍拾元整（大写），¥2284350.00 元（小写）。**

3.2 支付方式：银行转账，分期支付。

第一期：合同签订后，乙方持合同复印件、中标通知书及全额发票，支付合同总价的 40%。甲方在收到乙方本期相关资料后 30 个工作日内，完成本期货款支付。

第二期：乙方应先开具本次待支付金额的收据，待设备运抵甲方指定地点，完成安装、调试，并最终经甲方出具《安装验收单》确认验收合格后，支付剩余合同总价的 60%。甲方在收到乙方本期相关资料后 30 个工作日内，完成本期货款支付。

3.3 结算方式：乙方持全额发票（付一期）、收据（付二期）、《安装验收单》（付二期）、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

4.1 设备售后应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，12 小时内修复故障。若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，设备生产日期与到货日期间隔时间不得超过 6 个月，如超过该期限，甲方有权认定该设备存在质量风险或缺陷，并可拒收或要求更换。乙方应在接到甲方通知后 7 个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.2 乙方承诺该设备质保期为5年，全套原厂质保，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内≥4次/年巡检，≥2次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 乙方承诺质保期内，提供响应承诺及维修期间应急预案。

5.6 质保期内，如设备故障20个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.7 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.8 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.9 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同约定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期时间最高限额为10周，误期赔偿费的最高限额为合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 分项报价表

10.2 设备技术参数、配置清单

10.3 耗材及易损件报价表

10.4 售后承诺书

10.5 原厂授权书

10.6 中标通知书

10.7 廉洁承诺书

以下为空白页面

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2016年9月18日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号 029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2016年9月18日	单位名称	陕西博铭生物科技有限公司
		地址	陕西省西咸新区沣西新城先河之星1111-1号
		纳税人识别号	9161040006484857XL
		电话	029-38016299
		传真	029-38018278
		户名	陕西博铭生物科技有限公司
		开户银行1	建行咸阳世纪大道支行
		帐　号1	61050163500809866666
		联系人姓名	丁 楠
		联系人电话	15829958875
		联系人Email	xybo331331@163.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件一、分项报价表

项目名称：咸阳市中心医院麻醉机等设备采购项目（采购包3）

报价人名称：陕西博铭生物科技有限公司　　项目编号：【KRDL】K3-2607138

报价明细表

项目名称：麻醉机等医疗设备采购项目

项目编号：【KRDL】K3-2607138

序号	名称	型号和规格	原产地及制造厂名	数量/单位	单价（元）	合价（元）
1	监护仪（病人监护仪）	ePM 12	深圳/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	144	11800.00	1699200.00
2	输液泵	BeneFusion uVP	深圳/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	141	3650.00	514650.00
3	注射泵	BeneFusion uSP ex	深圳/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	30	2350.00	70500.00
合计总价	（小写）：¥2284350.00 （大写）：贰佰贰拾捌万肆仟叁佰伍拾元整					

说明：

1.所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用，合计总价应与开标一览表中金额一致，甲方不再另行支付其他任何费用。

供应商名称：陕西博铭生物科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

2026 年 09 月 07 日

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
病人监护仪	中国	/	/	/	女
输液泵	中国	/	/	/	女
注射泵	中国	/	/	/	女

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数、配置清单

ePM 12
病人监护仪



ePM 12具有CE、FDA、NMPA 医疗注册认证资质

整机参数	
类型	一体式监护仪
重量	3.4 千克（标准配置，不含记录仪，电池和附件）
尺寸	312 x 238 x 174 mm
无风扇设计	是
输入方式	触摸屏、旋钮、10键2D面板
输出方式	网络打印机、热笔记录仪
通讯和网络	内置
10种语言面板，便于国际和区域销售	
显示	
显示器	彩色电容触摸屏，配备触屏功能，防止误操作
	12.1英寸，1280像素 x 800像素
显示波形数量	最大10行波形区
界面类型	标准界面、大字体界面、趋势趋势界面、EWS评分界面、单屏/单屏7导心电界面等
界面定制	支持，波形和参数颜色、显示顺序均可设置
扩展显示器	通过VGA扩展监视屏
屏幕亮度自动调节	支持
ECG	
符合标准	YY1079-2008、YY0782-2010、YY1139-2013
心电算法	四导同步分析心电监护算法
导联	3-导联：I, II, III
	5-导联：I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
	6-导联：I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V6
	3/5/6导联自动监测
波形速度	6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
增益	x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, 自动
波形顺序模式	标准, Cabrera
带宽模式	诊断、监护、手术、ST模式
起搏分析	支持，并提供界面标识显示
心律失常分析	适用于成人、小儿、新生儿
	支持27种心律失常事件，包括房颤
ST段分析	支持，适用于成人、小儿、新生儿
QT/QTc分析	支持，适用于成人、小儿、新生儿
HR测量范围	成人：15 – 300 bpm
	小儿/新生儿：15 – 350 bpm
HR精度	±1 bpm 或 ±1%，取大者

脉冲呼吸	
测量技术	阻抗法
计算导联	I, II, 自动
RR测量范围	0 – 200 rpm
RR精度	±1 rpm（0–120 rpm），±2 rpm（121–200 rpm）
RR分辨率	1 bpm
波形速度	3 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
呼吸暂停延迟	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s
SpO₂	
符合标准	YY0784-2010
SpO₂模块	Mindray SpO2, Nellcor SpO2
SpO₂测量范围	0 – 100%
SpO₂精度	成人/小儿：±2%（70 – 100%）
	新生儿：±3%（70 – 100%）
灌注指数（PI）	Mindray SpO2支持
PI测量范围	0.05 – 20 %
PR	
PR测量范围	20 – 300 bpm（SpO₂）
	30 – 300 bpm（NIBP）
	20 – 350 bpm（IBP）
PR精度	±3 bpm（Mindray SpO₂）
	±3 bpm（20 – 250 bpm, Nellcor SpO₂）
	±3 bpm 或 ±3 %，取大者（NIBP）
	±1 bpm 或 ±1 %，取大者（IBP）
PR分辨率	1 bpm
无创血压	
符合标准	YY0667-2008, YY0670-2008
测量模式	手动，间隔，连续，序列，静点
测量参数	收缩压，舒张压，平均压
测量范围	成人：10–290mmHg，小儿：10–240mmHg，新生儿：10–140mmHg
最大测量时间	成人/小儿：180s，新生儿：90s
过压保护	具备
病理静脉穿刺	支持
NIBP测量提示	支持

K3-260712538报价不使用

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Temp

符合标准	YY0785-2010
通道数	2通道
体温测量范围	0 - 50 ℃
体温精度	±1℃（不含探头）

支持体温体各型成和图表显示

记录仪模块

技术	热敏记录仪
波形通道	3通（50 mm）
打印速度	25 mm/s, 50 mm/s
记录纸长度	20 m

回顾与存储

趋势数据	120小时@1min（标准存储卡）
	240小时@1s, 2400小时@10min(大容量存储卡)
事件存储	1000条事件及相关波形（标准存储卡）
	2000条事件及相关波形（大容量存储卡）
NIBP测量记录	1000组（标准存储卡）
	3000组（大容量存储卡）
全息波形	48小时，存储时长与波形数量相关（标准存储卡）
	48小时最大参数配置的所有波形（大容量存储卡）
呼吸氧合图	400条呼吸氧合事件
ST回顾	120小时@1min
24小时NIBP统计	支持
EWS评分趋势	支持
动态趋势	支持

只有主存储功能

报警

报警灯	1个或2个三色报警灯（声红声色）
报警音	符合YY0709（IEC60601-1-8）标准的要求

支持图形化报警显示和报警集中设置功能。

智能报警策略

报警合理，重要报警升级报警级别；应用独占式报警时间延时反馈数

命报警音合理重复报警

ARR报警不间断，避免漏报的ARR报警

智能阈值推荐，通过智能分析算法及优化报警策略，ePM评估一段时

间内的参数数据，提供智能报警阈值，一键设置给患者的个性化报警设

置，也可以根据临床需要灵活调

临床辅助应用

标准EWS、临床麻醉普通评分、24小时动态血压分析、24小时心电趋

势回顾、ST Graphic、肺功能点等临床辅助应用。

网络规格

有线网络	100 Base-TX, IEEE802.3
无线网络	5GHz/2.4GHz, IEEE 802.11a/b/g/n
数据安全	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise,

WPA2-Enterprise（EAP-FAST/EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC/PEAP-TLS, LEAP, PEAP-MSCHAPv2,)

加密方式	TKIP and AES

接口

主机	电源接口（1个）
	网络接口（1个，RJ45）
	USB接口（2个）
	多功能接口（1个）
	VGA接口（1个）
	等电位端（1个）
病例扫描仪	支持
网络打印机	支持

电源

交流输入电压	100 - 240 VAC（±10%），
交流输入电流	2- 0.9 A
电池	可充电锂电池, 2600 mAh，典型工作时间2小时
	可充电锂电池, 4500 mAh，典型工作时间4小时
	智能可充电锂电池5600mAh，典型工作时间4.5小
时	
电池充电时间	关机时，充电2.5小时可达90%电量（2600mAh）
	关机时，充电5小时可达90%电量
	（4500mAh/5600mAh）

使用环境

工作温度	0 - 40 ℃
存储温度	-20 - 60℃
工作湿度	15 to 95%（非冷凝）
存储湿度	10 to 95%（非冷凝）
工作气压	57.0 to 107.4 kPa
存储气压	16.0 to 107.4 kPa

仅限K3-260738注册使用 2026-09-05 18:52:49
咸阳博铭生物科技有限公司 91610400MA6YQ0884
客服热线：400 700 5652
www.mindray.com
P/N:CHN-ePM 12 Datasheet-210385X2P-20230725
mindray迈瑞
生命科技如此亲近

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

BeneFusion uVP 产品规格

物理特征	
尺寸（L x W x H）	125mm x 95mm x 186mm （不含紧固夹，误差±3mm）
重量	≤1.3 kg
防护等级	CF Class I，IP44
显示	
屏幕	3.5 英寸电容屏，分辨率≥ 320x480 像素
亮度	1-8档可调，出厂默认4档
屏幕显示信息	1.病人信息区:病人类型、性别、床号、病人姓名 2.输液状态显示区:当前模式、品牌信息、药物名、输液运行指示和主要输液参数 3.输液状态显示区:其它参数和压力状态 4.报警信息显示区:报警状态、报警图标、报警信息或提示信息 5.系统信息区：电池、网络、联机状态，以及系统时间等 6.按键区：不同界面可以显示不同的按键，包括启动/快推，停止，返回等 7.动态阻塞压力显示区：通过不同的图标显示输液管路的压力状态 • 绿色图标：正常压力 • 黄色图标：接近阻塞报警压力 • 红色图标：达到阻塞报警压力
基本参数	
输液模式	11种: ■ 速度模式 ■ 体重模式 ■ 微量模式 ■ 时间模式 ■ 序列模式 ■ 首剂量模式 ■ 间歇给药模式 ■ 剂量时间模式 ■ 梯度模式 ■ 点滴模式 ■ 时间给药模式
输液速度调节范围	0.10 ml/h ~ 2000 ml/h （输血的流速范围为0.10 ml/h ~2000 ml/h）
输液速度设定步进	0.10 ~ 99.99ml/h 的最小步进为0.01ml/h 100.0 ~ 999.9ml/h 的最小步进为0.1ml/h 1000 ~ 2000ml/h 的最小步进为1ml/h
待入量设置范围	0.1 ~ 9999.99 ml，最小步进 0.01 ml
输液时间设置范围	00:00:01 ~ 99:59:59 （hh:mm:ss） 可调
累计容量	0.01 ~ 9999.99 ml
KVO	0.5 ~ 5.0ml/h，最小步进：0.01 ml/h
排气	0.1-2000ml/h
精度	
输液精度	≤ ±5%；≤ ±4.5% （使用仪纽输液管）
快推	
快推速度设定范围	0.10 ml/h ~ 2000 ml/h
快推速度设定步进	0.10 ~ 99.99ml/h 的最小步进为0.01ml/h 100.0 ~ 999.9ml/h 的最小步进为0.1ml/h 1000 ~ 2000ml/h 的最小步进为1ml/h
语言	中文/英文
安全系统	
阻塞压力	4 个压力单位: mmHg/kPa/bar/psi 可选 各种单位自动换算,出厂默认 mmHg

仅用于2607138投标使用

阻塞压力	50-1125 mmHg, 出厂默认，450mmHg，步进1mmHg
自动数据锁	"开"和 "关" "开": 1-5min可选,增量值1 min, 出厂默认 "关"
阻塞前智能预警	阻塞压力上升时预警提示
阻塞后自动尝试重启	管路压力下降后自动恢复输液
anti-bolus	阻塞压力报警时回缩积蓄在管路里的压力
气泡大小	单个气泡档位6 档可调，分别为（15、50、100、250、500、800）μl
累积气泡	0.1～4.0ml/h
报警	
报警方式	声光图报警
报警级别	高级别:管路气泡，累积气泡，空瓶，流速异常，上阻塞，下阻塞，输液监视器，未安装输液器，管路异常，无滴数传感器，电池耗尽，电池耗尽，输液完成，KVO 完成，联机失效，系统故障 低级别:KVO 输液中，KVO 输液中，电源使用中，电源异常，CMS/GGW 断开，待机时间结束，与DOCK 通信中断，系统时间异常，联机即将失效，接近完成，无操作，电池电量低
报警音量	1-8 档可调,出厂默认4档
遗忘提醒	"开"和 "关", "开": 1-5min.可调, 增量值1 min.
电池	
工作时间	@ 5ml/h: ≥ 11 小时 （智能电池）/ ≥ 5 小时 （非智能电池）
充电时间	≤5小时充满（非智能电池）/ ≤6小时充满（智能电池）
接口	RS232 / 护士呼叫接口 / 直流电接口/USB/交流电源接口/滴数传感器接口
供电	
	交流电：100-240V~, 50/60Hz, 0.5-0.21A
	直流电：10V-16V, 2.25A-1.5A
环境要求	
温度	工作5～40°C, 储存-30～70°C
湿度	工作15～95%,储存 10～95%
气压	工作57～107.4kPa,储存 16～107.4kPa
防水防尘等级	IP44
使用寿命	10年
模式参数	
流速模式	待入量：0.1 ～ 9999.99 ml 流速范围:0.10 ml/h～2000 ml/h（输血的流速范围为0.10 ml/h～2000 ml/h）
时间模式	待入量：0.1 ～ 9999.99 ml 时间：00:00:01-99:59:59 (h:m:s)
体重模式	体重体重：默认:300,加kg或者0.1-660.3lb,kg或lb两个单位可选 剂量单位：ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal,cal,kcal, mEq 可选 浓度单位：ng/ml, μg/ml, mg/ml, g/ml, mU/ml, U/ml, kU/ml, EU/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml, mEq/ml, mcal/ml, cal/ml 剂量单位: ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mU/kg/min, mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h, EU/kg/min, EU/kg/h, EU/kg/24h, mmol/kg/min, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/24h, mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, cal/kg/min, cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mEq/kg/24h 待入量：0.1 ～ 9999.99 ml 时间：00:00:01-99:59:59(h:m:s)
间断给药模式	待入量：0.1 ～ 9999.99 ml 间隔时间：00:00:01-99:59:59 h:m:s

保度模式	待入量：0.1 ~ 9999.99 ml 时间段(总时间/上升/下降)：00:00:01-99:59:59(h:m:s)
序列模式	待入量：0.1 ~ 9999.99 ml 流速：0.01-2300ml/h 时间：00:00:01-99:59:59(h:m:s)
药剂量模式	待入量：0.1 ~ 9999.99 ml 速率：0.01-2300ml/h; 时间：00:00:01-99:59:59 (h:m:s)
微量模式	待入量：0.1 ~ 9999.99 ml 流速：0.1-100ml/h; 时间：00:00:01-99:59:59(h:m:s)

仅限【KRDL】K3-260713投标示使用
2026-03-05 18:32:10

BenePusion uSP ex产品规格

物理特征	
尺寸（L × W × H）	252mm x 118mm x 134mm （不含紧固夹，误差±3mm）
重量	≤1.7kg
防护等级	CF Class I，IP44
显示	
屏幕	3.5 英寸电容屏，分辨率≥ 320x480 像素
亮度	1-8档可调，出厂默认4档
屏幕显示信息	1.病人信息区:病人类型、性别、床号、病人姓名 2.输液状态显示区:当前模式、品牌信息、药物名、输液运行指示和主要输液参数 3.输液状态显示区:其它参数和压力状态 4.报警信息显示区:报警状态、报警图标、报警信息或提示信息 5.系统信息区：电池、网络、联机状态，以及系统时间等 6.按键区：不同界面可以显示不同的按键，包括启动，快推，停止，返回等 7.动态阻塞压力显示区：通过不同的图标显示输液管路的压力状态 • 绿色图标：正常压力 • 黄色图标：接近阻塞报警压力 • 红色图标：达到阻塞报警压力
注射器规格	
兼容性	兼容并自动识别注射器的规格：2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml
基本参数	
注射模式	10种 ■ 速度模式 ■ 体重模式 ■ 微量模式 ■ 时间模式 ■ 序列模式 ■ 间断给药模式 ■ 剂量时间模式 ■ 梯度模式 ■ TCI模式 ■ TIVA模式
注射速度设定范围	2/3ml注射器：0.01 ~ 150ml/h 5/6ml注射器：0.01 ~ 300ml/h 10/12ml注射器：0.1 ~ 600ml/h 20ml注射器：0.1 ~ 1200ml/h 30/35ml注射器：0.1 ~ 1500ml/h 50ml/60ml注射器和60ml注射器：0.1 ~ 2300ml/h
注射速度设定步进	0.01 ~ 99.99ml/h：0.01ml/h 100.0 ~ 999.9ml/h：0.1ml/h 1000 ~ 2300ml/h：1ml/h
待入量设置范围	0.01 ~ 9999.99 ml，最小步进0.01 ml
输液时间设置范围	00:00:01 ~ 99:59:59（hh:min:sec）可调
累计容量	0.01 ~ 9999.99 ml
KVO	0.1 ~ 5.0ml/h，最小步进：0.01ml/h
排气	0.01-2300m/h
精度	
机械精度	≤±0.5%
注射精度	≤±1.8%
快推	

仅供KRDL-260713828投标使用
陕西博铭生物科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

快输速度设定范围	2/3ml 注射器：0.01 ~ 150ml/h 5/6ml 注射器：0.01 ~ 300ml/h 10/12ml 注射器：0.1 ~ 800ml/h 20ml 注射器：0.1 ~ 1200ml/h 30/35ml 注射器：0.1 ~ 1500ml/h 50ml/60ml 和60ml 注射器：0.1 ~ 2300ml/h
快输速度设定步进	0.01~99.99ml/h：0.01ml/h 100.0~999.9ml/h：为0.1ml/h 1000~2300ml/h：为1ml/h
语言	中文/英文
安全系统	
输液压力	4 个压力单位: mmHg/kPa/bar/psi 可选, 各种单位自动换算,出厂默认 mmHg 50-1125 mmHg, 出厂默认，450mmHg，步进1mmHg
自动数据锁	"开"和 "关" "开": 1-5min可选,增量值1 min, 出厂默认 "关"
阻塞前智能预警	阻塞压力上升时预警提示
阻塞后自动尝试重启	管路压力下降后自动恢复输液
anti-bolus	阻塞压力报警时间推积蓄在管路里的压力
报警	
报警方式	声光图报警
报警级别	高级别:阻塞，注射器排空，注射器脱落，未安装注射器，爪夹异常，电池耗尽，输液完成，KVO 完成，联机失效，系统故障
	低级别:延长管脱落，注射器接近排空，KVO 输液中，电池使用中，电池异常，CMS/eGW 断开，待机时间结束，与DOCK 通信中断，系统时间异常，联机即将失效，接近完成，无操作，电池电量低
报警音量	1-8 档可调,出厂默认4档
遗忘提醒	"开"和 "关"，"开": 1-5min可调, 增量值 1 min.
电池	
工作时间	@ 5ml/h: ≥ 12.5 小时（智能电池）；≥6.5 小时 （非智能电池）
充电时间	≤5小时充满（非智能电池）；≤6小时充满（智能电池）
接口	RS232 / 护士呼叫接口 / 直流电接口/USB/交流电源接口
供电	
	交流电：100-240V~, 50/60Hz, 0.5-0.21A
	直流电：10V-16V, 2.25A-1.5A
环境要求	
温度	工作5 ~ 40℃，储存-10 ~ 70℃
湿度	工作15 ~ 95%，储存10 ~ 95%
气压	工作57 ~ 107.4kPa,储存16 ~ 107.4kPa
防水防尘等级	IP44
使用寿命	10年
模式参数	
流速模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 流速范围: 2/3ml 注射器：0.01 ~ 150ml/h 5/6ml 注射器：0.01 ~ 300ml/h 10/12ml 注射器：0.1 ~ 800ml/h 20ml 注射器：0.1 ~ 1200ml/h 30/35ml 注射器：0.1 ~ 1500ml/h 50ml/60ml 注射器和60ml 注射器：0.1 ~ 2300ml/h
时间模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 时间：00:00:01-99:59:59 (h:m:s)

仅限KRDL使用

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

体重模式	容量体重：0.1-300.0kg或者0.1-660.8lb,kg或lb两个单位可选 药量单位：ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal,cal,kcal, mEq可选 浓度单位：ng/ml, μg/ml, mg/ml, g/ml, mU/ml, U/ml, kU/ml, EU/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml, mEq/ml，mcal/ml, cal/ml 剂量单位: ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mU/kg/min, mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h, EU/kg/min, EU/kg/h, EU/kg/24h, mmol/kg/min, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/24h, mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, cal/kg/min, cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mEq/kg/24h 待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 时间：00:00:01-99:59:59(h:m:s)
间歇给药模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 间隔时间：00:00:01-99:59:59 h:m:s
梯度模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 时间段(总时间/上升/下降)：00:00:01-99:59:59(h:m:s)
序列模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 流速：0.01-2300ml/h 时间：00:00:01-99:59:59(h:m:s)
首剂量模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 速率：0.01-2300ml/h 时间：00:00:01-99:59:59 (h:m:s)
微量模式	待入量：0.01 ~ 9999.99 ml 流速：0.1-100ml/h 时间：00:00:01-99:59:59(h:m:s)

仅限【KRDL】K3-2023年采购

ePM12 监护仪配置清单(单台)

序号	名称	数量
1	监护仪主机	1台
2	心电主电缆	2条
3	心电导联线	2条
4	血氧主电缆	2条
5	血氧探头	2条
6	无创血压导气管	2条
7	血压袖带	2条
8	锂电池	1块
9	电源线	1条

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

ePM12 监护仪装箱清单(单台)

分项配件	数量
监护仪主机	1台
心电主电缆	2条
心电导联线	2条
血氧主电缆	2条
血氧探头	2条
无创血压导气管	2条
血压袖带	2条
锂电池	1块
三芯电源线	1条
使用说明书	1本
设备保修卡	1份
合格证	1份
序列号小标贴	1份

BeneFusion uVP配置清单（1台）

序号	名称	数量
1	输液泵主机 BeneFusion uVP	1台
2	输液管路固定夹	1个
3	电源适配器/电源线	1条
4	壁挂安装支架	1个
5	内置电池	1块

BeneFusion uVP输液泵装箱清单(单台)

分项配件	数量
输液泵主机	1台
电源线	1条
紧固夹	1个
内置电池	1块
说明书	1本
合格证	1份
序列号小标贴	1张

BeneFusion uSP ex配 置 清 单（单台）

序号	名称	数量
1	注射泵主机 BeneFusion uSP ex	1台
2	固定夹	1个
3	电源线	1条
4	内置电池	1块

BeneFusion uSP ex注射泵装箱清单(单台)

分项配件	数 量
注射泵主机	1台
电源线	1条
紧固夹	1个
内置电池	1块
说明书	1本
合格证	1份
序列号小标贴	1份

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三、耗材及易损件报价表

1、病人监护仪

耗材及易损件报价单

金额：元

序号	易损易耗件名称	品牌	单位	单价	备注
1	12针3/5分体式心电主电缆 除颤型	深圳迈瑞	个	520	
2	5导导联线	深圳迈瑞	个	520	
3	12针3导一体式心电电缆	深圳迈瑞	个	520	
4	7针血氧主电缆	深圳迈瑞	个	340	我司承诺质保期后长期优惠供应
5	血氧传感器	深圳迈瑞	个	550	
6	7针一体式血氧饱和传感器	深圳迈瑞	个	550	
7	无创血压导气管	深圳迈瑞	个	175	
8	血压袖套	深圳迈瑞	个	150	
9	锂电池	深圳迈瑞	个	670	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

输液泵

耗材及易损件报价单

金额：元

序号	易损易耗件名称	品牌	单位	单价	备注
1	后壳组件	深圳迈瑞	个	225	我司承诺质保期后长期优惠供应
2	前壳组件	深圳迈瑞	个	1200	
3	超声组件	深圳迈瑞	个	225	
4	主控板	深圳迈瑞	个	1200	
5	电池	深圳迈瑞	个	450	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、注射泵

耗材及易损件报价单

金额：元

序号	易损易耗件名称	品牌	单位	单价	备注
1	主控板	深圳迈瑞	个	1200	我司承诺质保期后长期优惠供应
2	前壳组件	深圳迈瑞	个	750	
3	后壳	深圳迈瑞	个	450	
	推拉盒后壳组件			225	
4	旋转电位器	深圳迈瑞	个	180	
5	电池	深圳迈瑞		450	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四、原厂授权书

GNTB202608250017

mindray迈瑞

厂家授权书

致：【开瑞项目管理有限公司/咸阳市中心医院】

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司是按中国法律成立的一家医疗器械制造企业，主要营业地点设在深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦，作为【ePM 12】的制造/生产商，在此授权按中国法律成立的【陕西博铭生物科技有限公司】（以下简称“【陕西博铭】公司”）使用我公司制造的上述货物就【麻醉机等医疗设备采购项目，采购包 3 ；项目编号：【KRDL】K3-2607138】递交投标文件，且【陕西博铭】公司以其自己的名义处理后续的商业谈判和签署合同并独立承担责任。

我公司承诺：为【陕西博铭】就本次项目而提供的货物提供相关售后服务工作。

本授权的有效期截至【至项目截止】。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

附件五、售后承诺书

1、监护仪售后承诺

GNTB202608250017　　编号：MRYF-04-R0001　版本号：V6.0

mindray 迈瑞

迈瑞产品质量和售后服务承诺

(V6.0)

为了更好地服务于广大深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（简称“迈瑞公司”）的客户，迈瑞公司将提供技术咨询、产品选型、以及整体解决方案，确保产品的质量性能、供货时间、服务保障以及产品的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：

一、 产品质量承诺

1、迈瑞公司对本次招投标所提供的产品符合麻醉机等医疗设备采购项目,采购包3项目编号:【KRDL】K3-2607138 要求的规格型号和技术性能。

2、迈瑞公司保证所供产品是经过出厂检验的合格产品。

3、迈瑞公司承诺对所供产品满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规要求；并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

二、 售后服务承诺

1、保修范围：用户应按照说明书、操作卡的用所购买的产品。在保修期内，机器出现故障，迈瑞公司提供免费维修和配件更换。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户应承担配件成本费和人工费（另行约定），但迈瑞公司会尽快协助排除故障，使系统恢复正常。


- 由于用户不按操作规程操作或者用户人为造成产品损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。
- 由于电网电压在本产品规定的适用范围外造成的故障及严重损坏等。
- 由于不可抗力引起的机器损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、失窃等。
- 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。
- 对产品的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。
- 由于产品与其他仪器连接使用而发生的故障。
- 其它非因产品本身质量问题而发生的故障。

2、服务热线：

迈瑞专设客户交互中心全天候 24 小时接听服务申告热线及客户投诉，热线号码： 400 700 5652，供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题，第一时间响应并全程响应和支持客户的需求。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3、迈瑞产品服务请求处理流程图：

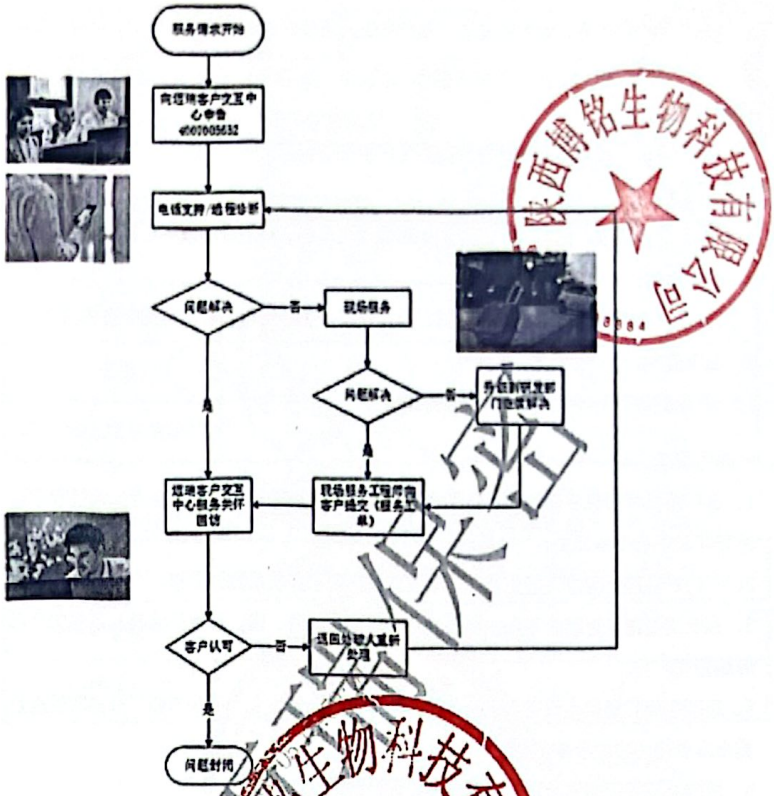

4、服务团队：迈瑞服务人员均经过公司严格的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。



5、敏捷高效的备件中心：迈瑞公司拥有总部、6 个大区物流中心、55 个城市备件中心、37 个驻点地区备件中心和授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，零担、快递、

急送三级物流派送服务，保障产品全生命会周期备件供应及时、充足。

6、收费服务：保修期满后，客户可以与迈瑞签订《保修销售合同》进行续保，或由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。

7、关怀服务：客户交互中心为客户提供技术咨询电话；迈瑞服务人员在保修期内提供公司规定的主动服务，如主动走访，为产品进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级等。

三、 培训计划

迈瑞公司将按与买方的约定对最终用户进行培训。

1、培训方式：

根据客户需求，组织客户进行集中培训或在现场、线上定期或不定期的技术培训。

2、培训内容：

涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。

3、培训资料：

产品的培训资料由迈瑞公司免费提供。

四、 其他事项

1、返厂维修时请您妥善包装，防压、防潮，购买足额运输保险，以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失。

2、不论产品因何种原因发生损坏，请立即停止使用并联系我们维修。

3、本承诺适用于迈瑞公司在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售的全部迈瑞公司产品。

4、迈瑞公司只提供本承诺所包含的服务，不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺内容的承诺负责。

5、迈瑞公司保留对本承诺的最终解释权。

6、迈瑞联系方式：

24 小时服务热线	400 780 5652		
迈瑞公司 全球用户服务部地址	广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
全球用户服务部总经理	张亚帅	邮编	518057
服务中心	西安	服务中心邮编	710065
服务中心联系人	齐博深	服务中心联系电话	029-88360649
服务中心联系地址	西安市雁塔区丈八四路 18 号		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、 保修及服务响应时间承诺

仅限 麻醉机等医疗设备采购项目,采购包 3 项目编号:【KRDL】K3-2607138

1、产品保修期：保修期从产品“安装验收日”起开始计算。

投标产品型号	主机免费保修期（月）
ePM 12	60
保修期内非仪器故障平均开机率：≥95%，即每年停机不超过 13 个工作日（一年 250 个工作日），超过一天保修期顺延一天。	

2、附件、试剂、超声探头或其他模块保修期：

产品	保修期（月）
附件	
试剂	
超声探头或其他模块	

3、保修期间，对迈瑞公司提供的产品出现的故障，迈瑞公司承诺的服务时间如下：

服务时间	市区内（小时）	市区外（小时）
响应申告时间	0.5 小时内	
上门服务时间	4	

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

二〇二六 年 八 月 二十五 日

2、输液泵、注射泵售后承诺

GNTB202608250037　　编号：MRYF-04-R0007　版本号：V1.0

mindray迈瑞

深迈科产品质量和售后服务承诺

(V1.0)

为了更好地服务于广大深圳迈瑞科技有限公司（简称“深迈科”）的客户，深迈科将提供技术咨询、产品选型、以及整体解决方案，确保产品的质量性能、供货时间、服务保障以及产品的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：

一、 产品质量承诺

1、深迈科对本次招投标所提供的产品符合麻醉机等医疗设备采购项目，采购包3项目编号：【KRDL】K3-2607138 要求的规格型号和技术性能。

2、深迈科保证所供产品是经过出厂检验的合格产品。

3、深迈科承诺对所供产品满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规要求；并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

二、 售后服务承诺


1、保修范围：用户应按照说明书、操作卡使用所购买的产品。在保修期内，机器出现故障，深迈科提供免费维修和配件更换。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户应承担配件成本费和人工费（另行约定），但深迈科公司会尽快协助排除故障，使系统恢复正常。

- 由于用户不按操作规程操作或者用户人为造成产品损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。
- 由于电网电压在不产品规定的范围外引起的故障及严重损坏等。
- 由于不可抗力引起的机发损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、失窃等。
- 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。
- 对产品的使用超出我方在说明书以及合同预料到的使用目的和使用条件。
- 由于产品与其他仪器连接使用而发生的故障。
- 其它非因产品本身质量问题而发生的故障。


2、服务热线：

深迈科专设客户交互中心全天候24小时接听服务申告热线及客户投诉，热线号码： 400 700 5652，供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题，第一时间响应并全程响应和支持客户的需求。

3、深迈科产品服务请求处理流程图：

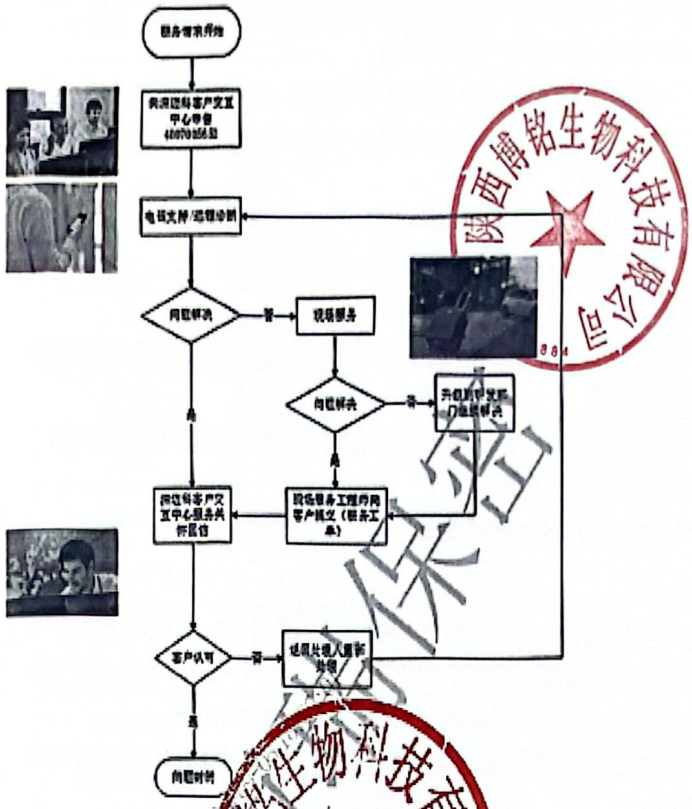

4、服务团队：深迈科服务人员均经过公司统一的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。

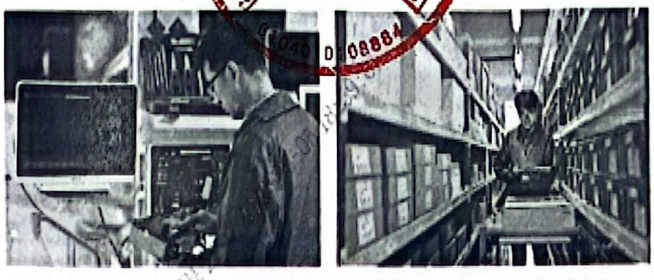

5、敏捷高效的备件中心 深迈科拥有总部、6 个大区物流中心、55 个城市备件中心、37 个驻点地区备件中心和授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，零担、快递、急送

三级物流派送服务，保障产品全生命会周期备件供应及时、充足。

6、收费服务：保修期满后，客户可以与深迈科签订《保修销售合同》进行续保，或由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。

7、关怀服务：客户交互中心为客户提供技术咨询电话；深迈科服务人员在保修期内提供公司规定的主动服务，如主动走访，为产品进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级等。

三、 培训计划

深迈科将按与买方的约定对最终用户进行培训。

1、培训方式：

根据客户需求，组织客户进行集中培训或在现场、线上定期或不定期的技术培训。

2、培训内容：

涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。

3、培训资料：

产品的培训资料由深迈科免费提供。

四、 其他事项

1、返厂维修时请您妥善包装，防压、防潮，购买足额运输保险，以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失。

2、不论产品因何种原因发生损坏，请立即停止使用并联系我们维修。

3、本承诺适用于深迈科在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售的全部深迈科公司产品。

4、深迈科只提供本承诺所包含的服务，不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺内容的承诺负责。

5、深迈科保留对本承诺的最终解释权。

6、深迈科联系方式：

24 小时服务热线	400 700 5652		
深迈科公司 全球用户服务部地址	深圳市光明区[illegible]街道南环大道 1203 号 2 号楼 6 楼 深圳迈瑞科技有限公司		
全球用户服务部总经理	张亚帅	邮编	518057
服务中心	西安	服务中心邮编	710065
服务中心联系人	齐博深	服务中心联系电话	029-88360649
服务中心联系地址	西安市雁塔区丈八四路 18 号		

五、 保修及服务响应时间承诺

仅限 麻醉机等医疗设备采购项目，采购包 3 项目编号：【KRDL】K3-2607138

1、产品保修期：保修期从产品“安装验收日”起开始计算。

投标产品型号	主机免费保修期（月）
BeneFusion uVP	60
BeneFusion uSP ex	60
保修期内非仪器故障平均开机率：≥95%，即每年停机不超过 13 个工作日（一年 250 个工作日），超过一天保修期顺延一天。	

2、附件、试剂、超声探头或其他模块保修期：

产品	保修期（月）
附件	/
试剂	/
超声探头或其他模块	/

3、保修期间，对深迈科公司提供的产品出现的故障，深迈科公司承诺的服务时间如下：

服务时间	市区内（小时）	市区外（小时）
响应申告时间	0.5 小时内	
上门服务时间	2	4

深圳迈瑞科技有限公司

二〇二六 年 八 月 二十五 日

附件六、中标通知书

2026/9/9 09:14 采购交易执行系统

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：【KRDL】K3-2607138

陕西博铭生物科技有限公司：

咸阳市中心医院于 2026年09月07日就 麻醉机等医疗设备采购项目（项目编号：【KRDL】K3-2607138） 进行 公开招标采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包3
中标(成交)合同包名称	咸阳市中心医院麻醉机等医疗设备采购项目采购包3：监护仪、输液泵、注射泵
中标(成交)金额(元)	2,284,350.00
合计金额(大写)：贰佰贰拾捌万肆仟叁佰伍拾元整	

[illegible]项目管理有限公司
2026年09月08日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件七、廉洁承诺书

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：陕西博铭生物科技有限公司

法人/代表签字：

日　　期：2016.9.18

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App