

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2023-ZB-2635-001

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置  
(消毒供应设备、无影灯、手术床、吊塔设备)  
招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二四年二月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
二、申请人的资格要求 .....	1
三、获取招标文件 .....	4
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	4
五、公告期限 .....	4
六、其他补充事宜 .....	4
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 .....	4
第二章 投标人须知 .....	8
（一）投标人须知前附表 .....	8
（二）投标人须知 .....	12
一、总 则 .....	12
1. 采购人、采购代理机构及投标人 .....	12
2. 资金来源 .....	13
3. 投标费用 .....	13
4. 适用法律 .....	13
二、招标文件 .....	13
5. 招标文件构成 .....	13
6. 招标文件的澄清与修改 .....	14
7. 投标截止时间的顺延 .....	14
三、投标文件的编制 .....	14
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用 .....	14
9. 投标文件组成 .....	15
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件 .....	15
11. 投标报价 .....	15
12. 投标保证金 .....	15
13. 投标有效期 .....	15
14. 投标文件的制作 .....	16
四、投标文件的递交 .....	16
15. 投标文件的加密 .....	16
16. 投标截止 .....	16
17. 投标文件的接收、修改与撤回 .....	16
五、开标及评标 .....	17
18. 开标 .....	17
19. 资格审查及组建评标委员会 .....	17
20. 投标文件符合性审查与澄清 .....	18
21. 投标偏离 .....	19
22. 投标无效 .....	19
23. 比较与评价 .....	20
24. 废标 .....	20
25. 保密要求 .....	20
六、确定中标 .....	21

26.	中标候选人的确定原则及标准 .....	21
27.	确定中标候选人和中标人 .....	21
28.	发出中标通知书 .....	21
29.	告知招标结果 .....	21
30.	签订合同 .....	21
31.	履约保证金 .....	22
32.	预付款 .....	22
33.	招标代理服务费 .....	22
34.	政府采购信用担保及融资 .....	22
35.	廉洁自律规定 .....	25
36.	人员回避 .....	27
37.	质疑的提出与接收 .....	27
38.	不见面开标注意事项及流程 .....	28
第三章	评标方法和标准 .....	29
第四章	拟签订的合同文本 .....	36
第五章	采购需求及要求 .....	41
5.1	采购需求一览表 .....	41
5.2	技术要求 .....	41
第六章	投标文件格式 .....	57
一、	资格证明文件 .....	61
第一部分	身份证明文件 .....	61
第二部分	资格证明文件 .....	64
二、	商务及技术文件 .....	68
	投标函 .....	68
	开标一览表 .....	69
	投标分项报价表 .....	70
	所有设备配置清单 .....	94
	节能产品、环境标志产品明细表 .....	73
	技术偏离表 .....	74
	商务条款偏离表 .....	75
	中小企业声明函（货物） .....	76
	投标人监狱企业声明函 .....	77
	残疾人福利性单位声明函 .....	78
	投标人参加政府采购活动承诺书 .....	78
	符合评分标准要求的商务文件 .....	79
	投标人须知第 10 条要求的所有技术文件 .....	82
	投标方案或技术方案 .....	83
	业绩一览表 .....	84
	投标人须知前附表要求的其他文件 .....	85

## 第一章 招标公告

### 榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置 (消毒供应设备、无影灯、手术床、吊塔设备) 招标公告

#### 项目概况

迁建项目医疗设备购置（消毒供应设备、无影灯、手术床、吊塔设备）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用 **CA 锁** 获取招标文件，并于 2024-02-28 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCZD2023-ZB-2635-001

项目名称：迁建项目医疗设备购置（消毒供应设备、无影灯、手术床、吊塔设备）

采购方式：公开招标

预算金额：12,950,000.00 元

采购需求：

合同包 1（消毒供应设备）

合同包预算金额：4,950,000.00 元

合同包最高限价：4,950,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他医疗设备	榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（消毒供应设备）	1（批）	详见采购文件	4,950,000.00	4,950,000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订之日起 45 天内交货。设备到场后，乙方需在 30 天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包 2（无影灯、手术床、吊塔设备）

合同包预算金额: 8,000,000.00 元

合同包最高限价: 8,000,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	其他医疗设备	榆林市中 医医院迁 建项目医 疗设备购 置(无影 灯、手术 床、吊塔 设备)	1(批)	详见采购文件	8,000,000.00	8,000,000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限: 合同签订之日起 45 天内交货。设备到场后, 乙方需在 30 天内完成安装调试工作, 并达到甲方要求的验收标准。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1 (消毒供应设备) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无, 本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包 2 (无影灯、手术床、吊塔设备) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无, 本项目为非专门面向中小企业的项目

3、本项目的特定资格要求:

合同包 1 (消毒供应设备) 特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 和中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的, 不得参加投标;

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证 (投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证; 投标

人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内),并出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书;

3.4、法定代表人参加的,须提供本人身份证复印件加盖公章;法定代表人授权他人参加的,须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章,并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章,并提供授权代表本单位证明(养老保险缴纳证明或劳动合同复印件);

3.5、投标人不得存在下列情形之一:

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本次采购活动;

(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台(陕西省·榆林市)获取采购文件,未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2(无影灯、手术床、吊塔设备)特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加投标;

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内),并出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;

3.3、法定代表人参加的,须提供本人身份证复印件加盖公章;法定代表人授权他人参加的,须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章,并提供被授权代表的身份证复

印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

### 3.4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

### 三、获取招标文件

时间：2024年02月05日至2024年02月09日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用CA锁

方式：在线获取

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024-02-28 09:30:00

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统）企业端〕，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站〔首页〕不见面开标〕系统，在线参加开标过程。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

#### 1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支

持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4 《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

1.6 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.7 《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。



2、采购文件获取方式: 供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>),选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式,供应商使用数字认证证书(CA锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(<http://yl.sxggzyjy.cn/>),选择“服务指南”,点击“下载专区”,点击榆林不见面开标系统操作手册(供应商)、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0,请供应商仔细阅读操作手册,了解操作流程,熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜,若无法正常投标,供应商自行承担 responsibility。电子响应文件制作软件技术支持热线: 400-998-0000; CA 锁购买: 榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话: 0912-3515031。

4、请各供应商获取采购文件后,按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求,通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

#### 1、采购人信息

名称: 榆林市中医医院

地址: 榆林市榆阳区新明楼街道新建南路 131 号

联系方式: 0912-3235287

#### 2、采购代理机构信息

名称: 陕西省采购招标有限责任公司

地址: 西安市高新二路 2 号山西证券大厦八楼

联系方式: 029-88497916

#### 3、项目联系方式

项目联系人: 张锐 雷鹏 程燕

电 话： 029-88497916

## 第二章 投标人须知

### （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：榆林市中医医院 地 址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路 131 号 电 话：0912-3235287
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路 2 号山西证券大厦八楼 联系人：张锐 雷鹏 程燕 电话：029-88497916
1.3.3	合格投标人的特定资格条件： 1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）和中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为生产厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书； 4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

	<p>5、投标人不得存在下列情形之一：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。</p>
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品：包 1 快速生物培养箱（高温）、快速生物培养箱（低温）、快速生物培养箱（环氧乙烷）允许采购进口产品
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求： 无
1.7	项目所属行业： <u>工业</u>
2.2	<p>项目预算金额：12,950,000.00 元。其中，包 1（消毒供应设备）4,950,000.00 元。</p> <p>最高限价：12,950,000.00 元。其中，包 1（消毒供应设备）4,950,000.00 元。</p>
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>2</u> 个包
12.1	<p>本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：<a href="https://credit.yl.gov.cn/">https://credit.yl.gov.cn/</a>）。</p> <p>各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及包号+项目编号”。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。</p>
14.1	本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。
16.1	投标截止时间： <u>2024-02-28 09:30:00</u>
18.1	开标时间： 2024-02-28 09:30:00

	开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〔首页〕不见面开标〕系统，在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束
20.5	核心产品：包 1：平移门脉动真空灭菌器（采购需求一览表序号 9）。
23.2	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u>
31.1	是否提交履约保证金： <u>否</u>
32.1	预付款比例为： <u>60%</u>
33	<p>中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法（按标段）下浮 10%收取，</p> <p>中标单位的招标代理服务费交纳信息</p> <p>    银行户名：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>    开户银行：中国光大银行西安友谊路支行</p> <p>    账    号：78560188000095264</p> <p>    联 系 人：财务部    联系电话：029-85263975</p>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	<p>联系单位：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>联 系 人：综合办公室</p> <p>联系电话：  029-85235014</p>
39	不见面开标注意事项及流程
39.1	<p>本项目为不见面开标：</p> <p>须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。</p> <p>1 采用不见面开标的方式进行；</p>

	<p>1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>1.2、供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》</p> <p>2、不见面开标流程相关注意事项如下：</p> <p>2.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种：</p> <p>2.2 IE 浏览器输入网址：  <a href="http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login">http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login</a>;</p> <p>2.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>2.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>2.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>2.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>2.8 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。</p>
--	--

## （二）投标人须知

### 一、总 则

#### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同

参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

## **2. 资金来源**

2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## **3. 投标费用**

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## **4. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

# **二、招标文件**

## **5. 招标文件构成**

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知



### 第三章 评标方法和标准

### 第四章 拟签订的合同文本

### 第五章 采购需求及要求

### 第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

## 6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

## 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

## 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投

标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## **9. 投标文件组成**

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

## **10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件**

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## **11. 投标报价**

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

## **12. 投标保证金**

12.1 本项目不收取投标保证金。

## **13. 投标有效期**

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保

- 持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
- 14. 投标文件的制作**
- 14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“**.SXSTF**”的电子投标文件。
- 14.2 投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
- 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

- 15. 投标文件的加密**
- 15.1 投标人应按照国家公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。
- 16. 投标截止**
- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
- 17. 投标文件的接收、修改与撤回**
- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时

间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 开标时，由投标人代表检查自己投标文件的加密情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录,投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外,网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责评标工作。

## **20. 投标文件符合性审查与澄清**

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

### **20.2 投标文件的澄清**

20.2.1 在评标期间,评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行,并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

- (1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并

修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

## 21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

## 22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## **23. 比较与评价**

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：
  - (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
  - (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

## **24. 废标**

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## **25. 保密要求**

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。



### **31. 履约保证金**

- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### **32. 预付款**

- 32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### **33. 招标代理服务 fee**

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### **34. 政府采购信用担保及融资**

- 34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关


于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。


业务流程简图如下：

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	李 靖 15509125117
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	刘 波 18809125468
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	2000 万元	1 年	3.8%	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	3000 万元	1 年	3.45%-3.85%	24 小时	杨 尧 13325409313
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850

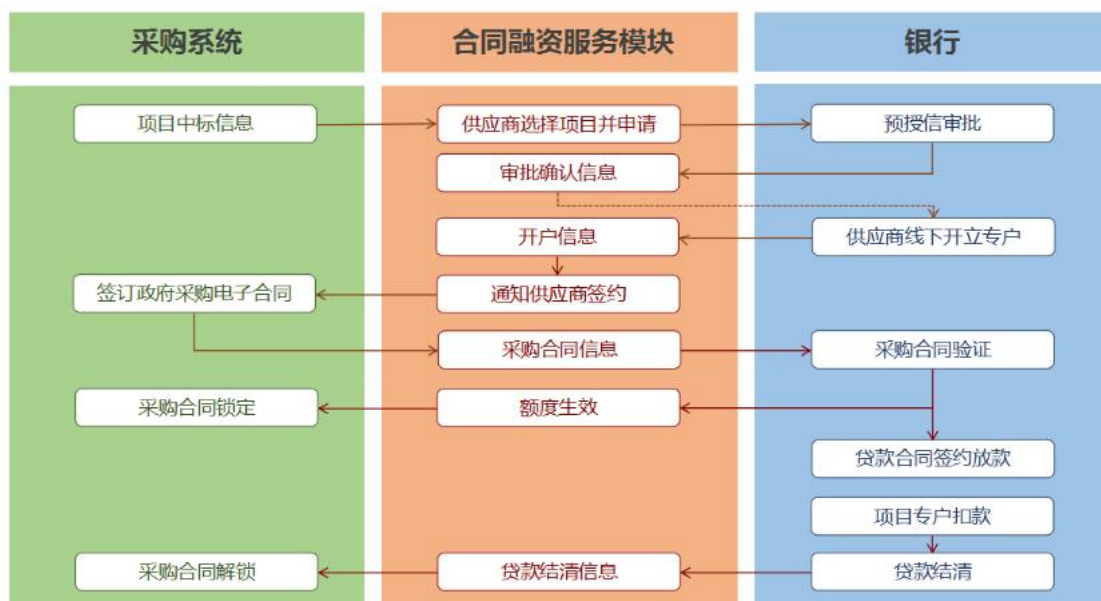


未签订采购合同申请流程

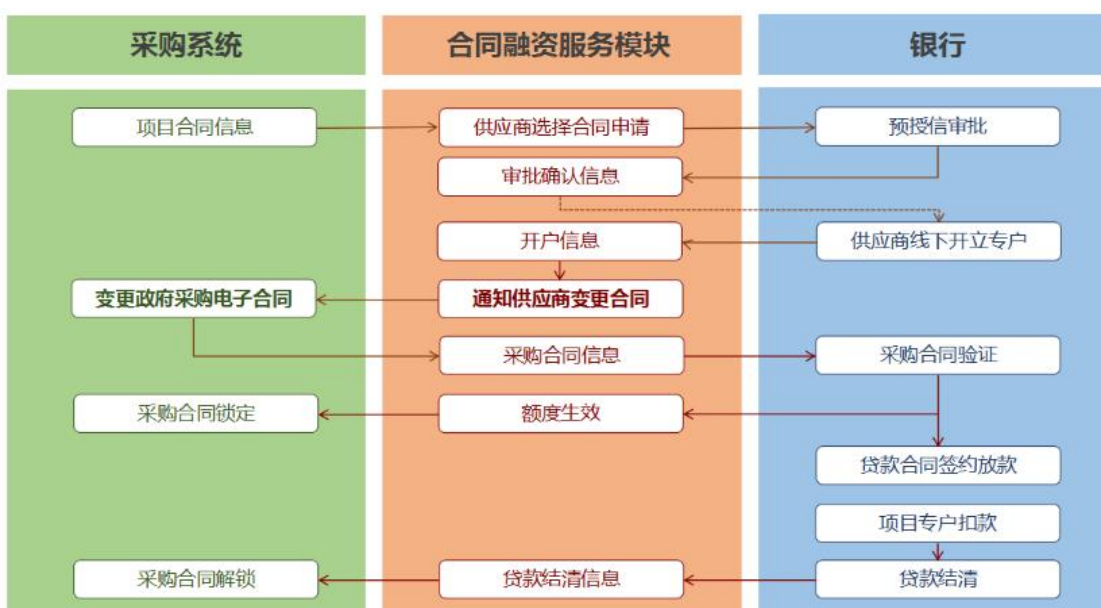


已签订采购合同申请流程

# 中征平台“政采贷”业务流程图

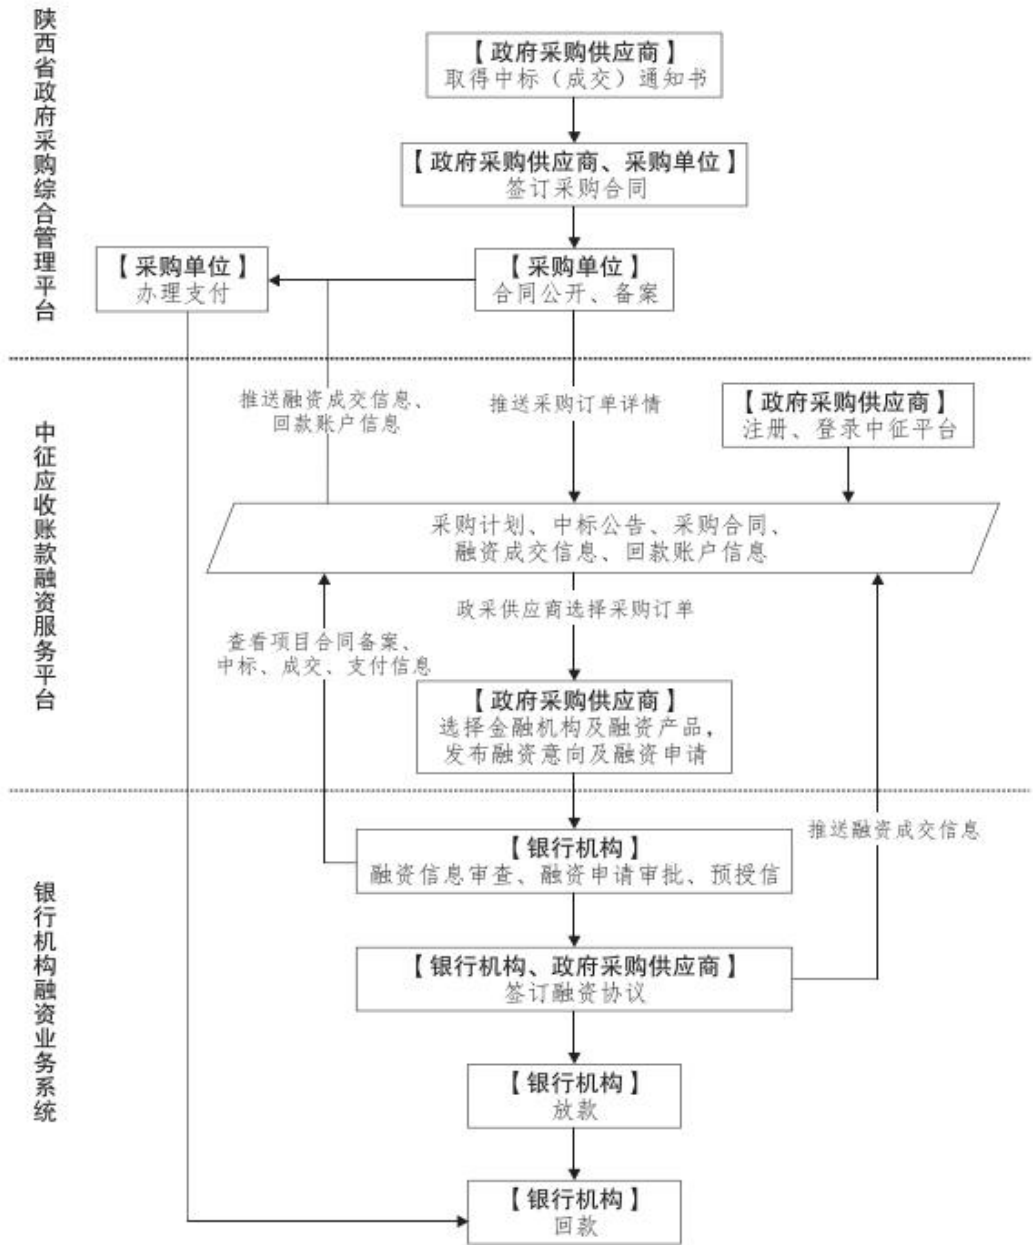

## 附件2

# 中征平台政府采购供应商用户注册流程

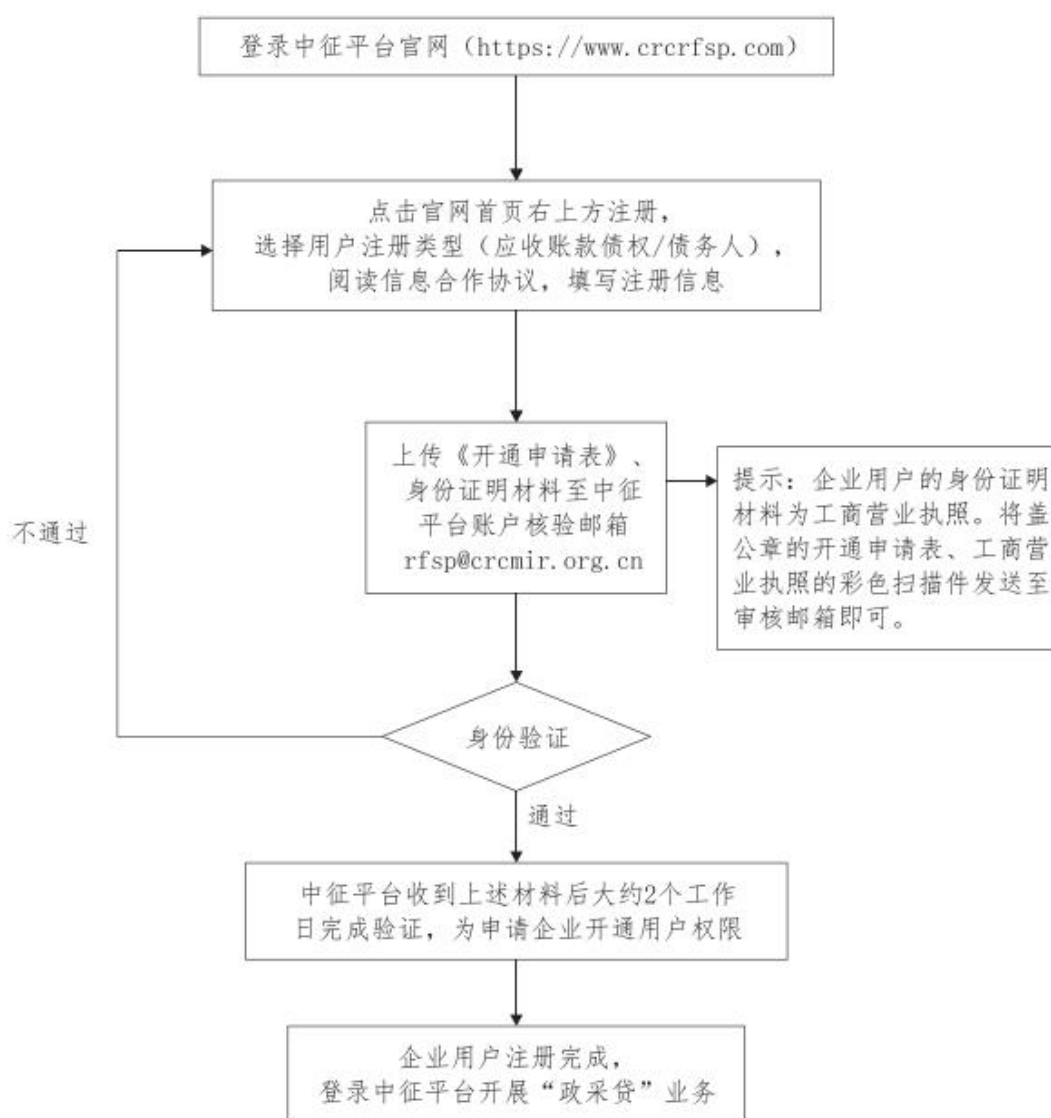

## 35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，

不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### **36. 人员回避**

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### **37. 质疑的提出与接收**

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

### **38. 不见面开标注意事项及流程**

详见投标人须知前附表。

### 第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

- 1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19



号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 6、低于成本价不正当竞争预防措施

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标阶段合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构

成事项详细陈述。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查项目	资格条件
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	<p>1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>2、供应商 2022 年度经审计的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明；</p> <p>3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；</p> <p>4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；</p> <p>5、供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；</p>
2	资格条件	<p>1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）和中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；</p> <p>2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；</p> <p>3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；</p> <p>4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；</p>

		<p>5、投标人不得存在下列情形之一：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。</p>
--	--	--

附表二 符合性审查标准

序号	审查项目	投标无效条件
1	签署、盖章	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的
2	投标报价	投标人投标报价超出采购预算或最高限价的
3	报价合理性	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的
4	投标内容	投标内容出现漏项或数量与要求不符的
5	其它情形	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款

### 附表三 评审因素和指标

(适用于包1)

评标因素	权值%	评价要素
价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
节能、环境标志产品	2	投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计 0~2 分。
投标产品技术指标评审内容	38	投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得 38 分。“▲”号技术参数一项不满足扣 3 分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣 1 分，扣完为止（技术指标提供技术支持资料，未提供不得分。请在技术偏离表“说明”栏中标明页码）。
投标产品的可靠性评审	10	1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、有品质保证，提供相关证明材料，按其响应程度计 0~5 分。 2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系，产品性能稳定，具有较好的使用效果，并符合国内相关标准。按其响应程度计 0~5 分。
供货能力、履约能力等	5	供应商对所投产品的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计 0~5 分。
售后服务	10	1、针对该项目提供具体可行的售后服务计划、售后服务措施、故障响应时间等，以及其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计 0~5 分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计 0~5 分。
类似业绩	5	提供 2020 年 1 月 1 日（含）至今厂家的所投核心产品销售业绩，以合同为准，每份 1 分，最高不超过 5 分。
总分		100 分

## 第四章 拟签订的合同文本

### 榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置

(消毒供应设备、无影灯、手术床、吊塔设备) (包 X) 采购合同

采购人(以下称甲方):榆林市中医医院

供应商(以下称乙方):

合同签订地点: 榆林市中医医院

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,就乙方向甲方供货事宜,双方本着平等自愿、友好协商的原则,在遵守招标文件、投标文件所有条款规定基础上,经双方协商一致同意签订本合同。

#### 一、供货清单

设备名称	规格型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	生产厂家	备注
总金额(大写): _____(¥ 元)(含税)						

#### 二、

1.交货地点: 榆林市中医医院迁建院区。

2.交货注意事项: 交货前与院方主管科室、基建办、项目部等部门联系做好设备进场前期准备工作,进场时和进场后必须严格按照相关部门要求开展工作。

3.设备安装前需要主动与施工单位、项目设计单位及项目单位主管部门对接,协商安装事宜。

#### 三、

1.交货期: 合同签订之日起 45 天内。

2.安装期: 设备到场后,乙方需在 30 天内完成安装调试工作,并达到甲方要求的验收标准。

#### 四、合同价款

1.合同总价是投标产品在使用地点达到正常使用条件下所包含的所有费用,包括:新产品供应价、运杂费(含保险)、调试费、培训费及其它相关费用,进口设备包含海关

税及附属税、手续费等所有税、费。

2.合同总价一次包死，在合同执行期间不受市场价变化的影响。

## 五、付款方式

1.合同签订 30 日后支付合同总价款的 60%；

2.设备全部安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90 日内支付合同总价款的 40%。

3. 乙方指定收款银行账户信息：

1)公司名称：

2)开户行名称：

3)帐号：

4. 甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供正规等额税票，否则甲方付款时间相应顺延；同时甲方内部报账付款流程期限导致不能按期付款的，付款时间相应顺延，不属于违约，无需承担违约责任。

## 六、运输

1.运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费、搬运费等全部费用。

2.运输方式：乙方自行选择。

## 七、售后服务

1.质保期:从设备安装验收合格之日为：1 年，质保期内设备需要进行无偿的、定期的维护和保养。

2.质保期内服务：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在 4 小时内给予答复，并派出合格的维修人员在 1 个工作日内到用户现场进行维修服务。若因设备质量造成损害，全部费用由乙方自行支付；若需将产品送回生产厂维修，乙方还应支付维修设备所需的往返全部费用。

3.质保期外服务：在质保期后设备终身维修，维修时只收取零配件成本价格费用，免收其余一切费用。

4.大型设备应当提供维修维护手册、常用备件（包括耗材）与易损零部件的清单及价格表。

5.有故障代码和维修密码的设备应提供故障代码表及维修密码，带有软件的设备应提供软件备份。



## 八、质量保证

- 1.乙方设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、配置合理，满足标书要求。
- 2.所投产品必须是最新工艺生产的最新产品，产品因原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担全部维修、更换费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
- 3.乙方应保证合同项下所供设备是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。
- 4.乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
- 5.根据检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
- 6.乙方设备经过国家法定部门鉴定和注册。
- 7.乙方设备必须性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

## 九、检验和测试

- 1.甲方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知乙方。
- 2.检验和测试在甲方指定的地点或单位进行，以出具合格的检测报告为准。

## 十、技术服务

1. 技术资料：提供产品合格证和使用说明书(中文)以及产品图纸（特种设备需提供全套的设计、制造、安装、施工等技术图纸）。
- 2.技术培训：
  - 1)内容：应包括设备原理、使用操作、保养维修技术，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。
  - 2)地点：按照甲方要求。
  - 3)人员：按照甲方要求。
  - 4)费用：已包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

## 十一、验收

1. 设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知使用医院验收。需

商检的进口设备，必须提供商检证明到当地商检部门登记或邀请当地商检部门的商检人员参加验收，所产生的一切费用由乙方负责。

2. 甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备产地、规格、型号和数量。如有必要可通知招标代理机构并邀请有关专家验收。

3.验收合格后，甲乙双方填写设备安装验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料。以便使用单位日后管理和维护。

4.验收依据：合同文本、招标文件、投标文件以及国内相应的标准、规范。

5.乙方提供《项目实施报告》且评价达到“满足”或“基本满足”。

6.负责办理国家规定的使用许可证或其他质检计量检定证书。

## 十二、安全责任

1.乙方在运输、装卸、安装调试设备时，应当注意严格按照安全规范操作，若发生人身损伤或者设备损坏等事件时，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

2.本合同所约定的设备在交付甲方前，设备可能存在毁损、灭失等风险全部由乙方承担。

## 十三、违约责任

本合同履行过程中，若乙方违约，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿由此给甲方造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款 30%的违约金。

## 十四、争议解决方式

本合同在履行过程中若发生任何争议，双方均应友好协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

## 十五、其他条款

1.本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商签订书面补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。

3.本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

单位名称：榆林市中医医院

单位名称：

联系电话： 0912-3360442

联系电话：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

签订日期： 年 月 日

附件 1:

政府采购项目货物验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）		使用单位验收意见：（盖章）	
签字：  年 月 日		签字：  年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

## 附件 2：产品及配置清单

## 第五章 采购需求及要求

包 1:

需求一览表:

序号	设备名称	单位	数量	限价（万元）	备注
1	高效清洗消毒器	台	2	495	
2	真空超声清洗机	台	1		
3	医用超声波清洗机（除锈机）	台	1		
4	多功能清洗中心	套	1		
5	眼科清洗工作站	套	1		
6	腔镜清洗工作站	套	1		
7	医用器械干燥柜	台	1		
8	医用低温真空干燥柜	台	1		
9	平移门脉动真空灭菌器	台	3		
10	低温等离子灭菌器	台	2		
11	环氧乙烷灭菌器	台	1		
12	内窥镜监测系统	套	1		
13	快速生物培养箱（高温）	台	1		允许采购进口产品
14	快速生物培养箱（低温）	台	1		
15	快速生物培养箱（环氧乙烷）	台	1		
16	绝缘监测仪	个	1		
17	封口打印一体机	台	2		
18	环境安全监测报警系统控制主机	个	1		
19	过氧化氢浓度报警器	个	1		
20	环氧乙烷浓度报警器	个	1		

21	不锈钢清洗工作分类台	个	2	
22	双头洗眼器	套	1	
23	小车清洗机	个	2	
24	器械检查打包台	个	4	
25	包布检查打包台	个	2	
26	器械检查放大镜	个	4	
27	敷料柜	个	4	
28	器械柜	个	5	
29	密封回收车	辆	6	
30	多功能台	台	2	
31	疏列式货架	个	5	
32	双列立式网筐储存架	个	5	
33	一单元双门互锁传递窗	个	7	
34	平板货架	个	5	
35	贮槽平台车	辆	8	
36	平板送物车	辆	2	
37	标准篮筐	个	50	
38	无纺布架	个	3	
39	清洗工作站（隔离去污区配）	套	1	
40	医用干燥柜（小型）	台	1	

## 技术要求:

### 一、高效清洗消毒器

序号	技术参数
1	清洗舱容积及材质: 容积 $\geq 500\text{L}$ ; 不锈钢镜面板, 全自动无缝焊接; 锥形舱体水箱。
2	舱门要求: 双门通道设计, 全自动升降门; 双门可实现互锁, 舱体内配置照明灯。
3	加热方式: 电加热, 为了提高加热速度, 设备具有快速预热功能, 双水箱设计。
4	▲循环泵采用不锈钢泵体, 流量 $\geq 600\text{L/分钟}$ 。
5	喷淋设施: 全方位覆盖无死角, 喷射臂两端具有开孔设计, 并且两端可拆卸清理;
6	设备具备节水设计, 标准程序用水 $\leq 25\text{L/步}$ , 有水位监测压力开关。
7	清洗程序: 具有 $\geq 9$ 套预置程序, $\geq 20$ 套自定义程序, 用户可根据需要进行程序编辑。标准程序时间 $\leq 30$ 分钟, 包括预洗、主洗、清洗、消毒、上油、干燥等步骤。
8	采用双风机供风, 双级加热系统。
9	程序控制及显示方式: PLC 控制清洗消毒全过程, 彩色触摸屏操作, 倒计时圆型的方式显示与记录每次清洗程序的运行周期。具有 $\geq 8.0$ 英寸彩色触摸屏, 前后双屏, 能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数; 屏幕分辨率 $\geq 64\text{K}$ 彩色显示。
10	安全保障: 通过电磁兼容性检验。具有自动故障检测, 故障声音报警功能。有漏电断路装置、泵过载保护装置、内置防溢流装置、腔体过热保护装置等。
11	▲变频清洗: 可实现软启动, 根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。
12	配置要求: 主机 1 台、外搬运车 2 辆、4 层清洗架 1 个, 清洗托盘 12 个
13	获得达芬奇机器人清洗验证资质, 可以清洗消毒达芬奇机器人手臂 (提供相关证明材料)。

## 二、真空超声清洗机

序号	技术参数
1	工作原理及功能要求：利用减压沸腾技术进行手术器械、器具的清洗及消毒一次完成，减压沸腾阶段具有液相脉冲与气相脉冲双重清洗功能，达到清洗器械表面与管腔内部的目的。
2	清洗舱容积及材质：有效容积 $\geq 150\text{L}$ ，316L 不锈钢镜面板，全自动无缝焊接，舱体排水结构有节水功能设计。
3	舱门要求：双门；升降门防夹手开关，遇障碍自动返
4	加热方式：电加热
5	▲装载方式：各类管腔器械无需连接各种接管接头，可直接放置于托盘中清洗；支持混合装载。
6	清洗程序：标准程序每次用时 $\leq 60\text{min}$ 。包括预洗、超声、主洗、漂洗、消毒、上油、干燥等步骤，具有常规器械清洗模式、管状器械清洗模式、软管及网状器械清洗模式、自由清洗模式等多种模式可供选择。有清洗液泵自动供给系统，液位过低可自动报警。
7	减压沸腾次数及要求：腔体内压力脉冲次数 $\geq 20$ 次。提供运行曲线图。真空度 $\geq 0.1\text{bar}$ ，水沸腾温度控制在 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。
8	消毒方式：采用蒸汽消毒，消毒温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间可调，A0 值达到 3000 以上。
9	控制及显示方式：电脑自动控制，彩色液晶触摸屏操作，实时显示主要参数。遇有故障和超误差，可立即停止操作、报警，打印并记录故障信息
10	彩色触摸屏操作，倒计时圆型的方式显示与记录每次清洗程序的运行周期。设备具有 $\geq 8.0$ 英寸彩色触摸屏
11	打印机：内置式打印机，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、湿度、A0 值等，同时能打印运行曲线。
12	信息存储系统：信息采集及存储系统：自动存储设备运行信息
13	安全保障：有漏电断路装置、泵过载保护装置、内置防溢流装置、腔体过热保护装置等，保障机器运行安全。
14	▲提供清洗效果检测报告
15	配置要求：主机 1 台、外搬运车 2 辆、装载篮筐 8 个
16	获得达芬奇机器人清洗验证资质，可以清洗消毒达芬奇机器人手臂（提供相关证明材料）

## 三、医用超声波清洗机（除锈机）

序号	技术参数
1	容积： $\geq 80\text{L}$
2	材质：304 不锈钢镜面板
3	开门方式：一键升降式开门
4	快速管路设计：U 型排水管路含排水泵，排水时间 $\leq 4\text{min}$
5	三频超声：40KHZ、80KHZ、100KHZ
6	控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤波器；面膜操作，一键启动；具有故障自动检测功能。
7	安全保护：具有水位低保护功能；超时保护功能；电机过流保护功能
8	配置要求：主机 1 台、装载篮筐 1 个

#### 四、多功能清洗中心

序号	技术参数
1	主体台面、清洗槽、沥水台要求：整体高背板带灯，带计时器 1 个（具有倒计时功能，报警声音可调节， $\geq 60\text{dB}$ ）台面及背板为 304 不锈钢，槽体为 316L 不锈钢，超声槽厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，其余槽体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；沥水台面四周为滚筋结构中间低四周高，台面高度 $\geq 850\text{mm}$ ，柜体为分段式柜体，底部有移动脚轮，支架、柜门为 304 不锈钢材质，门铰链为阻尼铰链，柜体底板为 304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
2	有可升降防护装置，防护罩材质为透明亚克力，板材厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，防护罩可手动升降；蒸汽清洗槽具有排风装置，风机为大风量离心风机，风量 $\geq 600$ 立方米/h，内置设备蒸汽冷凝装置，冷凝水可排入下水道
3	配置蒸汽清洗机，外罩为 304 不锈钢拉丝板，设计压力 $\geq 1.0\text{Mpa}$ ，外表面侧面温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ；控制系统与设备一体式设计，一键式操作，液晶显示屏；触摸控制按键（非按键膜按键），显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态；喷蒸汽系统，手柄按键式操作，蒸汽压力值设定范围为 0-0.55Mpa
4	超声波要求，液晶显示屏；有报警信息显示功能；按键操作，一键启动，有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；有自动加热系统，超声波清洗时间 5-10 分钟调节。
5	煮沸消毒槽，液晶显示屏；显示汉字及字符；有报警信息显示功能；按键操作，一键启动；有故障自动检测功能；温度可调并可保存，电加热方式，加热温度室温- $93^{\circ}\text{C}$ 。
6	高压清洗喷枪，高压水枪材质枪体为 304 不锈钢，配备八个清洗喷嘴；高压气枪材质枪体为 304 不锈钢，配备八个清洗喷嘴；水龙头材质为 304 不锈钢，可 360 度旋转，水龙头单独可以抽出来。
7	▲具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，集成后级除水过滤系统、气体净化干燥系统。采用净化干燥技术对空气进行净化处理，净化吸附剂采用医用级；并配有后冷却系统、液态水分离器、粉尘过滤器、 $0.01\mu\text{m}$ 精密过滤器以及内洁净存储罐等；具有自动净化排水功能。
8	供排水管路要求：所有给水管采用优质 PP-R 冷、热水管材和管件。采用同质热熔连接技术。安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯。
9	可根据用户操作习惯流程，方向可左右转换
10	设备具有消毒功能，提供相应的检测报告。
11	配置要求：超声波 1 台、煮沸槽 1 台、蒸汽清洗机 1 台、水枪+气枪共 4 把

#### 五、眼科清洗工作站

序号	技术参数
1	材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力 PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，表面光亮平滑，无锋角，无接缝；柜门材质：采用彩色钢化玻璃。
2	柜体支架：选用全优质不锈钢材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，高 $\geq 800\text{mm}$ 。



3	超声槽要求超声波采用内嵌式设计，材质为优质 SUS304 不锈钢，四周有橡胶减震胶条，与设备主体融合
4	控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用 PVC 面膜，采用触摸控制按键，控制实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，具有时间报警功能，报警声音可调节 $\geq 60\text{db}$ 。
5	清洗槽具体尺寸根据实际场地来决定；防护罩材质为透明亚克力，板材厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，
6	▲具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，集成后级除水过滤系统、气体净化干燥系统。采用净化干燥技术对空气进行净化处理，净化吸附剂采用医用级；另配有后冷却系统、液态水分离器、粉尘过滤器、 $0.01\mu\text{m}$ 精密过滤器以及内洁净存储罐等单元组成；具有自动净化排水功能。
7	自动/手动双控水源控制：具有自动/手动双控水源的开关，总水源可自动关闭，同时可实现在断电情况下手动打开总水源。
8	水龙头可任意扭曲，满足不同器械的清洗。
9	供排水管路要求：所有给水管采用优质 PP-R 冷、热水管材和管件。采用同质热熔连接技术。安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯。
10	设备具有消毒功能，提供相应的检测报告
11	配置要求：超声波 1 台、水枪+气枪共 4 把

## 六、腔镜清洗工作站

序号	技术参数
1	材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力 PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，表面光亮平滑、耐磨，无锋角，无接缝；柜门材质：采用彩色钢化玻璃。
2	柜体支架：选用全优质不锈钢材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，高 $\geq 800\text{mm}$ 。
3	超声槽要求超声波采用内嵌式设计，材质为优质 SUS304 不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合
4	控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用 PVC 面膜，采用触摸控制按键，控制实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，具有时间报警功能，报警声音可调节 $\geq 60$ 分贝。
5	清洗槽具体尺寸根据实际场地来决定；防护罩材质为透明亚克力，板材厚度 $\geq 8\text{mm}$
6	▲具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，集成后级除水过滤系统、气体净化干燥系统。采用净化干燥技术对空气进行净化处理，净化吸附剂采用医用级；另配有后冷却系统、液态水分离器、粉尘过滤器、 $0.01\mu\text{m}$ 精密过滤器以及内洁净存储罐等单元组成；具有自动净化排水功能。
7	自动/手动双控水源控制：具有自动/手动双控水源的开关，总水源可自动关闭，同时可实现在断电情况下手动打开总水源。
8	水龙头可任意扭曲，满足不同器械的清洗。
9	供排水管路要求：所有给水管采用优质 PP-R 冷、热水管材和管件。采用

	同质热熔连接技术。安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯。
10	设备具有消毒功能，提供相应的检测报告
11	配置要求：超声波 1 台、水枪+气枪共 4 把

#### 七、医用器械干燥柜

序号	技术参数
1	容积 $\geq 350\text{L}$ ，双门结构，可一次性处理 $\geq 8$ 个标准器械托盘或 $\geq 35$ 根导管或 $\geq 25$ 个湿化瓶，整体不锈钢外观，带侧面热风循环，显示屏和控制面板位于侧维修门处。整机 304 不锈钢材质
2	密封门材质为 304 不锈钢拉丝板，板材厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，板材折边为刨槽工艺，门体中部为双层中空钢化玻璃结构，门密封为手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，固定为上下转轴方式，维修门为 304 不锈钢拉丝板，板材折边为刨槽工艺，上下双磁吸闭合方式，
3	进风加热系统，交流离心风机，风机风量 $\geq 550\text{m}^3/\text{h}$ ，最大静压 $\geq 450\text{Pa}$ ，噪音 $\leq 72\text{dB}$ ，风机数量 $\geq 3$ 个，风机具有自动程序控制和故障报警功能
4	设备有加热系统故障检测、保护、报警功能；加热箱为电加热方式，加热管数量 $\geq 3$ 根，加热箱加装温度探头，加热管含过热保护，加热箱外部粘贴隔热保温层，一体化控制器，OLED 显示屏，内置 $\geq 9$ 套程序， $\geq 4$ 套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），
5	导管干燥架为抽拉式医用导管干燥架，适合装夹不同口径（ $\phi 6\sim\phi 30\text{mm}$ ）的导管，湿化瓶干燥架，适合内径为 $9\text{mm}\sim 42\text{mm}$ 的瓶类物品使用
6	配置要求：配置主机 1 台，格栅 9 个，标准器械托盘 9 个，导管干燥架 1 个，湿化瓶干燥架 1 个，积水盒 1 个

#### 八、医用低温真空干燥柜

序号	技术参数
1	容积： $\geq 100\text{L}$ ，外形尺寸 $\leq 550*1600*900\text{mm}$ (宽高深)。
2	材质要求：柜体采用航空铝合金材质
3	舱体结构：双舱体设计，可分开独立运行，单台可分别满足大负载和小负载不同需求；方形舱体设计，一次可装载 4 个 DIN 标准器械托盘的器械。全铝合金导轨、抽拉式搁板。
4	内室尺寸 $\geq 320*700*220\text{mm}$ (宽深高)，可满足长度 $\leq 700\text{mm}$ 腔镜的干燥处理。
5	控制系统采用控制器 + $\geq 7$ 英寸彩色触摸屏，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；感应式一键按键操作。
6	压力检测：采用压力传感器，要求监测舱内压力；采用电磁阀控制回空时间频率，保证舱体压力的稳定性。
7	内置 $\geq 10$ 套程序， $\geq 4$ 套默认程序，可根据需求自行调节参数，并保存自定义；

8	门结构：自动门结构，电动锁，自动密封，自动检测门关位，一键开门。
9	可做通道式前后门结构，满足隔断式安装要求。
10	≥19mm 钢化玻璃密封，高透视窗，可在运行中随时观察内部符合干燥情况。
11	干燥时间：脉动次数 1~9 次可设，脉动时间 1~99min 可调。
12	控制方式：压力传感器控制回空，检查舱内压力；自带保压测试程序，可对设备密封性、真空本性能等功能进行准确监测。
13	配备高效真空泵；空气回流采用 0.3um 高效过滤器。
14	配置要求：主机 1 台、装载篮筐 4 个

### 九、平移门脉动真空灭菌器

序号	技术参数
1	有效容积：≥1200L
2	主体结构：环形加强筋结构，多点进汽，多段加热（提供竣工图）。环形加强筋个数≥6 个。多点进汽，进汽口数量≥6 个。
3	自带品质提升装置
4	材质：灭菌器内室、夹层、门板材质使用 316L 以上不锈钢，使用寿命≥15 年/30000 次灭菌循环，主体所带蒸汽发生器材质与灭菌器主体材质一致，均为 15 年寿命（提供证明材料）
5	▲加热方式：蒸汽加热和电加热两种模式；自带蒸汽发生器材质使用 316L 以上不锈钢，使用寿命≥15 年/30000 次灭菌循环
6	舱门要求：双门通道设计，自动左右平移门，有安全互锁系统；门密封胶条为圆形空心，一次性冷压成型，无接口，门胶条采用设备主体安装，非门板安装，门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3 个，提供设备主体竣工图纸佐证。
7	隔热、降噪和节能性能：有良好的隔热和隔音措施，使舱体外表层温度<45℃，控制真空泵噪音≤65dB；有蒸汽冷凝水再循环利用程序。
8	灭菌程序：有多种标准工作程序和舱体测漏程序，可自行设定程序适合各种物品的灭菌；能混装灭菌；免费提供重载灭菌程序。灭菌工艺：脉动、跨压脉动、正压脉动、升温、灭菌、排汽、真空干燥、平衡、结束。
9	倒计时圆型的方式显示与记录每灭菌程序的运行周期，每套程序首次成功运转结束后，自动存储为该程序比对基值。
10	数据保存：显示屏存储：运行数据可存储在显示屏内，可存储数据量≥6 年/12000 次灭菌循环；前后双屏
11	▲根据新规 <b>ws310-2016</b> 对高温灭菌器物理参数的监测要求，生产厂家应取得实验室认可权威机构—中国合格评定国家认可委员会 <b>CNAS</b> 资质，可对灭菌器进行定期监测。
12	配置要求：主机 1 台，外搬运车 2 辆、内消毒车 1 辆、安全阀 1 个、真空压力表 1 个

### 十、低温等离子灭菌器

序号	技术参数
1	总容积: $\geq 150\text{L}$
2	腔体结构及材质: 腔体结构为矩形, 腔体材质采用优质航空铝材, 厚度 $\geq 16\text{mm}$ , 过氧化氢保持 100% 气态
3	门开启方式: 采用顶杆驱动式电动升降门
4	门板加热功能: 加热膜数量 $\geq 2$ 个, 门板温度维持在 $50 \pm 2^\circ\text{C}$
5	具有门障碍开关功能和脚踏开门功能。
6	过氧化氢加注方式: 采用卡匣式加注; 卡匣胶囊式, 每个卡匣 12 个胶囊
7	胶囊计数记忆功能: 卡匣安装后, 自动计算胶囊使用个数, 并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。胶囊灌装量 $\geq 5\text{ml}$
8	加注控制阀门: 采用电磁阀。
9	具有过氧化氢提纯功能, 过氧化氢提纯后浓度 $\geq 95\%$ , 提供省级以上检测机构出具的检测报告。
10	压力传感器: 产品设置压力传感器数量 $\geq 3$ 个, 其中检测内室压力传感器 $\geq 2$ 个, 提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。
11	压力传感器: 测量范围 $0 \sim 2700\text{Pa}$ , 精度 $0.25\%$ 。
12	产品具有排气过氧化氢气体过滤系统, 周围空气中过氧化氢浓度 $< 0.6\text{mg/m}^3$ 。
13	采用 $\geq 10$ 英寸彩色触摸屏, 全新程序设计。
14	▲腔体内部具有过氧化氢浓度检测系统, 对过氧化氢实时进行检测, 确保灭菌合格性 (提供佐证材料)
15	显示屏显示内容: 温度, 压力, 时间, 循环模式, 过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等, 并提供实际界面照片。倒计时圆型的方式显示与记录每灭菌程序的运行周期, 方便观察, 每套程序首次成功运转结束后, 自动存储为该程序比对基值
16	能够打印记录: 程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息;
17	根据灭菌物品特点, 设置多个灭菌程序, 软镜循环; 管腔循环; 快速循环。
18	具有软式内镜专用灭菌程序, 能对内径 $1\text{mm}$ 长度 $1000\text{mm}$ 管腔的软式内镜灭菌, 并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
19	具有倒计时显示功能, 可根据装载情况自动调整剩余时间, 能够使操作者更加合理的安排工作时间。具有真空干燥模块: 将等离子体灭菌器与真空干燥柜完美结合, 彻底干燥管腔器械
20	灭菌能力: 聚四氟乙烯管腔直径 $1\text{mm}$ , 长度 $4000\text{mm}$ ; 不锈钢管腔直径 $0.7\text{mm}$ , 长度 $600\text{mm}$ 。
21	提供达芬奇机器人内镜器械灭菌认证证书
22	具有低温真空干燥模块
23	配置要求: 主机 1 台、装载篮筐 2 个、灭菌纸塑袋搁架 2 套

## 十一、环氧乙烷灭菌器

序号	技术参数
1	总容积: $\geq 220\text{L}$
2	腔体材质: 采用优质航空铝材 3003, 厚度 $\geq 8\text{mm}$ , 环氧乙烷保持 100% 气态。非不锈钢材质。舱体形状: 矩形舱体
3	真空系统: 采用无油真空泵, 流量 $\geq 130\text{L/min}$ , 无需外置压缩气源系统;
4	动作阀门: 采用气动阀, 压缩气 0.4—0.7MPa, 动作 $\geq 400$ 万次无故障
5	加湿系统: 加湿阀控制加湿水量, 并具有内置湿度传感器。
6	设备具有解析装置, 尾气不能采用水排的方式排放到外部。(提供证明材料)
7	触摸屏显示内容: 灭菌过程的温度、压力、湿度、时间、循环模式, 过程阶段, 报警信息提示等, 并提供实际界面照片。倒计时圆型的方式显示与记录每灭菌程序的运行周期, 方便观察, 每套程序首次成功运转结束后, 自动存储为该程序比对基值
8	打印方式: 曲线和报表两种形式, 并提供打印样品。打印记录内容: 程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间, 报警代码等信息
9	程序数量: 设有 37℃ 和 55℃ 两种程序, 未运行程序前可随时切换灭菌温度。
10	具有断电记忆保持功能
11	具有开门通风功能: 灭菌完成后, 15 分钟后开门, 可进行一次通风处理
12	负压工作系统: 负压循环过程安全可靠, 环氧乙烷进入机器期间和灭菌结束后的泄露率平均值分别 $\leq 0.900\text{mg/m}^3$ 和 $\leq 0.180\text{mg/m}^3$
13	具有门安全设置
14	配置要求: 主机 1 台、装载篮筐 2 个

## 十二、内窥镜监测系统

序号	技术参数
1	主机设置: 一体化设计, 支持零部件及平板收纳, 支持镜头保护
2	镜头像素 $\geq 100$ 万
3	软镜检测线长度 $\geq 1.6$ 米 (操作长度 $\geq 1.5$ 米)
4	光学镜直径 $\geq$ 内径 1.5mm, 外径 $\leq 2.0\text{mm}$
5	视场角 $\geq 120^\circ$
6	光源: LED 光源
7	亮度调节: 旋钮式调节
8	操作模式平板电脑操作
9	操作系统自主研发软件
10	屏幕 $\geq 10$ 英寸
11	信息记录方式图像及视频捕捉
12	信息存储方式 U 盘/内存卡

## 十三、快速生物培养箱 (高温)

序号	技术参数
1	生物监测阴性结果判读时间 $\leq 30$ 分钟
2	阳性报警时间 $\leq 5$ 分钟
3	配备生物指示剂培养孔 $\geq 8$ 个
4	每个培养孔有独立荧光读头
5	配备 LCD 显示屏
6	具备程序自检功能以及智能报警功能
7	支持网络连接功能
8	配备指示剂挤碎器
9	带有断电保护装置
10	阅读器配有翻盖式配套防尘且遮光盖
11	配置要求：主机 1 台

#### 十四、快速生物培养箱（低温）

序号	技术参数
1	生物监测阴性结果判读时间 $\leq 30$ 分钟
2	阳性报警时间 $\leq 5$ 分钟
3	配备生物指示剂培养孔 $\geq 8$ 个
4	每个培养孔有独立荧光读头
5	配备 LCD 显示屏
6	具备程序自检功能以及智能报警功能
7	支持网络连接功能
8	配备指示剂挤碎器
9	带有断电保护装置
10	阅读器配有翻盖式配套防尘且遮光盖
12	兼容性证明报告
13	配置要求：主机 1 台

#### 十五、快速生物培养箱（环氧乙烷）

序号	技术参数
1	生物监测阴性结果判读时间 $\leq 4$ 小时
2	培养温度 $37 \pm 2$
3	配备生物指示剂培养孔 $\geq 8$ 个
4	配备 LCD 显示屏
5	支持网络连接功能
6	具备程序自检功能以及智能报警功能
7	设备自带诊断功能
8	配置要求：主机 1 台

#### 十六、绝缘监测仪

序号	技术参数
1	电外科器械绝缘性能检测，用于带绝缘层的所有电外科器械的漏电检测
2	单、双极电刀电缆线绝缘性能检测
3	*显示屏：≥3.5 英寸液晶屏（69*48mm），显示电量，电压设置值以及报警指示灯
4	使用时间：≥40 个小时
5	输出电压：0-10000V，旋钮式无极任意调节
6	报警方式：声、光两种方式报警，检测到器械漏电时机子会发出蜂鸣音和屏幕报警灯会闪烁
7	正极探测头：铜质探测毛刷，铜质探测圆刷，铜质探测 U 型刷，用于腔镜手术器械、电缆的漏电检测及导通性测试，可满足所有的带电源腔镜手术器械的漏电检测
8	配置要求：主机 1 个

#### 十七、封口打印一体机

序号	技术参数
1	封口温度：60~220℃任意设置，封口温度误差≤±1℃。
2	高速升温设计：室温升至 180℃
3	待机控制：长期不使用，设备进入待机状态，加热带保温到较低温度；
4	≥5 英寸触摸屏，显示时间、温度、速度等参数
5	封口速度：10±0.5m/min；封口边距：0~35mm 可调
6	配置要求：主机 1 台

#### 十八、环境安全监测报警系统控制主机

序号	技术参数
1	量程 0-30ppm；分辨率 0.01ppm；显示方式 LCD 液晶数字显示；
2	一台主机可同时显示三种气体（环氧乙烷、过氧化氢、甲醛）有害气体数值
3	配置要求：主机 1 个

#### 十九、过氧化氢浓度报警器

序号	技术参数
1	量程 0-30ppm；分辨率 0.01ppm；显示方式 LCD 液晶数字显示；
2	配置要求：过氧化氢浓度探头 1 个

#### 二十、环氧乙烷浓度报警器

序号	技术参数
1	量程 0-30ppm；分辨率 0.01ppm；显示方式 LCD 液晶数字显示；
2	配置要求：环氧乙烷浓度探头 1 个

#### 二十一、不锈钢清洗工作分类台

序号	技术参数
1	全 SUS304 不锈钢，前后边角大圆弧过渡；
2	底部带脚轮，可随意移动；尺寸：1800×1100×800mm±20mm
3	配置要求：不锈钢清洗工作分类台 1 个

#### 二十二、双头洗眼器

序号	技术参数
1	与清洗槽配套使用
2	双头出水
3	配置要求：双头洗眼器 1 套

#### 二十三、小车清洗机

序号	技术参数
1	功率：≥1400w
2	最大压力≥120 bar，工作压力≥70Bar；
3	最大水流量 6 升/min；最高水温 50 度；
4	水管长度≥5 米，电线长度≥5 米
5	配置要求：小车清洗机 1 个

#### 二十四、器械检查打包台

序号	技术参数
1	双层台面，双面使用，全 304 不锈钢材质
2	带照明灯、立柱上带有电源插座；
3	用于器械的检查打包；尺寸 2000×1100×1800mm±20mm
4	配置要求：器械检查打包台 1 个

#### 二十五、包布检查打包台

序号	技术参数
1	材质：304 不锈钢
2	2. 配置：内嵌式检查灯×1，4 寸万向轮(含刹)×4；
3	底部带脚轮，可随意移动；外形尺寸：2000×1100×850mm±20mm
4	配置要求：包布检查打包台 1 个

#### 二十六、器械检查放大镜

序号	技术参数
1	自由伸缩，带光源
2	可固定在器械检查打包台上面
3	8 倍放大倍数



4	配置要求：器械检查放大镜 1 个
---	------------------

#### 二十七、辅料柜

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢；
2	四层隔板；带玻璃；存储容量大，也可作为库房储柜
3	尺寸：950×400×1800±10mm
4	配置要求：辅料柜 1 个

#### 二十八、器械柜

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢；
2	四层隔板；带玻璃；存储容量大，也可作为库房储柜
3	尺寸：950±10×400±10×1800±10mm
4	配置清单：器械柜 1 个

#### 二十九、密封回收车

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢；
2	内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品
3	车体采用一体化焊接；单层搁板的最大承重为≥60Kg
4	配置要求：密封回收车 1 辆

#### 三十、多功能台

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢；
2	配置纸带切割机
3	要求用于放置封口机，配备 AC220V 电源
4	配置要求：多功能台 1 台，纸袋切割机 1 台，篮筐 2 个

#### 三十一、疏列示货架

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢；
2	层间距 380mm，中间镂空设计，便于包裹通风
3	四角带脚轮，外形尺寸：1200×600×1800±20mm
4	配置要求：疏列示货架 1 个

#### 三十二、双列立式网筐储存架

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢
2	立式网筐存储结构、易于通风
3	一次性可悬挂≥40 个标准灭菌篮筐
4	配置要求：双列立式网筐储存架 1 个

### 三十三、一单元双门互锁传递窗

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢
2	双门互锁设计
3	带有 AC220V 电源，自带紫外线灯管
4	配置要求：一单元双门互锁传递窗 1 个

### 三十四、平板货架

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢
2	四层设计
3	可用于辅料包的摆放
4	配置要求：平板货架 1 个

### 三十五、贮槽平台车

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢，带脚轮
2	搁板×2 凹槽深度 100mm
3	外形尺寸：900×500×940±20mm
4	配置要求：贮槽平台车 1 辆

### 三十六、平板送物车

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢，带脚轮
2	外形尺寸：1030×500×850
3	配置要求：平板送物车 1 辆

### 三十七、标准篮筐

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢
2	可避免手接触无菌物品造成的污染
3	多个标准篮筐可叠列存放
4	配置要求：标准篮筐 1 个

### 三十八、无纺布架

序号	技术参数
1	全 304 不锈钢
2	可存放不同规格的包布

### 三十九、清洗工作站（隔离去污区配）

序号	技术参数
1	材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力 PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，表面光亮平滑，无锋角，无接缝；柜门材质：采用彩色钢化玻璃。
2	柜体支架：选用全优质不锈钢材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，高 $\geq 800\text{mm}$ 。
3	超声槽要求超声波采用内嵌式设计，材质为优质 SUS304 不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合
4	控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用 PVC 面膜，采用触摸控制按键，控制实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，具有时间报警功能，报警声音可调节 $\geq 60\text{dB}$ 。
5	清洗槽具体尺寸根据实际场地来决定；防护罩材质为透明亚克力，板材厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，
6	▲具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，集成后级除水过滤系统、气体净化干燥系统。采用净化干燥技术对空气进行净化处理，净化吸附剂采用医用级；并配有后冷却系统、液态水分离器、粉尘过滤器、 $0.01\mu\text{m}$ 精密过滤器以及内洁净存储罐等；具有自动净化排水功能。
7	自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，总水源可自动关闭，同时可实现在断电情况下手动打开总水源
8	水龙头可任意扭曲，满足不同器械的清洗。
9	供排水管路要求：所有给水管采用优质 PP-R 冷、热水管材和管件。采用同质热熔连接技术。安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯。
10	设备具有消毒功能，提供相应的检测报告
11	配置要求：超声波 1 台、水枪+气枪共 4 把

#### 四十、医用干燥柜（小型）

序号	技术参数
1	容积 $\geq 350\text{L}$ ，双门结构，可一次性处理 $\geq 8$ 个标准器械托盘或 $\geq 35$ 根导管或 $\geq 25$ 个湿化瓶，整体不锈钢外观，带侧面热风循环，显示屏和控制面板位于侧维修门处。整机 304 不锈钢材质
2	密封门材质为 304 不锈钢拉丝板，板材厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，板材折边为刨槽工艺，门体中部为双层中空钢化玻璃结构，门密封为手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，固定为上下转轴方式，维修门为 304 不锈钢拉丝板，板材折边为刨槽工艺，上下双磁吸闭合方式，
3	进风加热系统，交流离心风机，风机风量 $\geq 550\text{m}^3/\text{h}$ ，最大静压 $\geq 450\text{Pa}$ ，噪音 $\leq 72\text{dB}$ ，风机数量 $\geq 3$ 个，风机具有自动控制程序和故障报警功能。
4	设备有加热系统故障检测、保护、报警功能；保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用；加热箱为电加热方式，加热管数量 $\geq 3$ 根，加热箱加装温度探头，加热管含过热保护，加热箱外部粘贴

	隔热保温层，一体化控制器，OLED 显示屏，内置 $\geq 9$ 套程序， $\geq 4$ 套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），
5	导管干燥架为抽拉式医用导管干燥架，适合装夹不同口径（ $\Phi 6\sim\Phi 30\text{mm}$ ）的导管，湿化瓶干燥架，适合内径为 $9\text{mm}\sim 42\text{mm}$ 的瓶类物品使用
6	配置要求：配置主机 1 台，格栅 9 个，标准器械托盘 9 个，导管干燥架 1 个，湿化瓶干燥架 1 个，积水盒 1 个

## 第六章 投标文件格式



政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

## 投 标 文 件

包 号：\_\_\_\_\_

投 标 人：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

## 目 录

### 一、资格证明文件

#### 1、身份证明文件

#### 2、资格证明文件

### 二、商务及技术文件

#### 1、投标函（见投标文件格式一）

#### 2、开标一览表（见投标文件格式二）

#### 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

#### 4、技术偏离表（见投标文件格式四）

#### 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

#### 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

##### 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

##### 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

##### 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

#### 7、投标人参加政府采购活动承诺书

#### 8、符合评分标准要求的商务文件

#### 9、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件

#### 10、投标方案或技术方案

#### 11、业绩一览表

#### 12、投标人须知前附表要求的其他文件

一、资格证明文件

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_  
职 务：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供



## 2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任\_\_\_\_\_（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

注：自然人投标的仅提供身份证

### 3、授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明或劳动合同复印件)

## 第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料：

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）投标人 2022 年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料：（格式见附件 6-9）

**要求：1、以上资格证明文件须提供加盖投标人红色公章的复印件。**

#### **6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）**

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

#### **6-2 2022 年度经审计的财务报表**

提供投标人 2022 年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 **6-2 本年度基本开户银行出具的资信证明**

#### **6-3 依法缴纳税收的证明**

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

#### **6-4 社会保障资金缴纳记录**

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

## 6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明**

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：**1、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；2、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书。

## 二、商务及技术文件

(投标文件格式一)

### 投标函

(采购人或采购代理机构名称)\_\_\_\_\_

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档\_\_\_\_份。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- (1) 按照招标文件的规定,我公司投标总价为:人民币(大写)\_\_\_\_\_元(¥:\_\_\_\_元),其中联合协议或分包意向协议(如有)约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币(大写)\_\_\_\_\_元(¥:\_\_\_\_元),占投标总价的\_\_\_\_%。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起\_\_\_\_\_个日历日,若我方中标,投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (3) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有的话),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (4) 按照招标文件的规定,在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- (5) 按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资料,我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件,且尊重评标结论和定标结果。
- (6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(盖公章): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(投标文件格式二)

## 开标一览表

项目名称:

采购项目编号:

包号:

投标总价(单位:元)	交货期	安装期	交货地点	备注
大写: 小写:				

投标人(盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注:此表中,每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。



(投标文件格式三)

## 投标分项报价表

项目编号:

项目名称:

包号:

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	合计(元)

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



## 所有设备配置清单

自拟

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(投标文件格式四)

## 技术偏离表

项目编号:

项目名称:

包号:

序号	货物名称	数量及单位	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人(盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注: 1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写, 与相关证明材料一致, 不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容, 否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数; 必须在备注栏进行明确说明偏离情况, 且偏离情况与实际相符, 否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中, 否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

## 商务条款偏离表

项目编号:

项目名称:

包号:

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期（合同签订之日起 45 天内）			
	安装期（设备到场后，乙方需在 30 天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准）			
	交货地点（榆林市中医医院迁建院区）			
	付款方式（1.合同签订 30 日后支付合同总价款的 60%；2.设备全部安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90 日内支付合同总价款的 40%）			
	质保期（1 年）			
	投标文件有效期（提交投标文件截止之日起 90 个日历日）			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

（投标文件格式六）

## 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

(投标文件格式七)

## 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位)\_\_\_\_\_ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位)\_\_\_\_\_ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。



（投标文件格式八）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）

## 投标人参加政府采购活动承诺书

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

## 投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：提供双方签订的合同复印件加盖公章。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

投标人须知前附表要求的其他文件



附件1：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人信用承诺书

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人：\_\_\_\_\_

承诺人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：            年        月        日

说明：本承诺书效力和作用等同谈判保证金，其有效期与投标有效期一致

提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

# 榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19号

## 榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

### 一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

### 二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

### 三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）  
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证  
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目  
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）  
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证  
与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用  
承诺，不能代报、替报





## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➤ 带\*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带\*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

## 常见问题 注意事项

### 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

## 常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：


- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带\*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

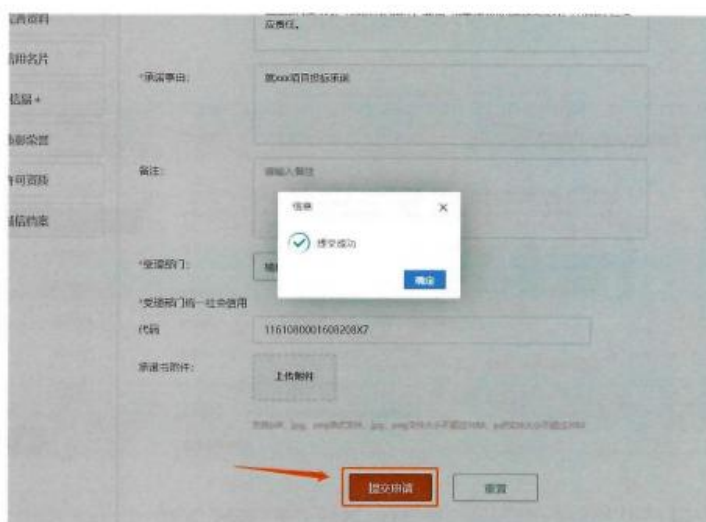

## 附件 3: 陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）

### 一、系统登录

- 1、打开全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），点击【不见面开标】->选择对应辖区不见面大厅（注意一定要选对应辖区的不见面开标大厅）->【不见面开标】进入不见面开标大厅登录首页。





- 2、点击【登录】---挑选投标人身份使用 CA 锁登录系统，提前登录系统调试环境，确保系统登录正常。




备注：推荐使用 IE11 浏览器

## 二、开标流程


### 1、选择参加的开标项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。

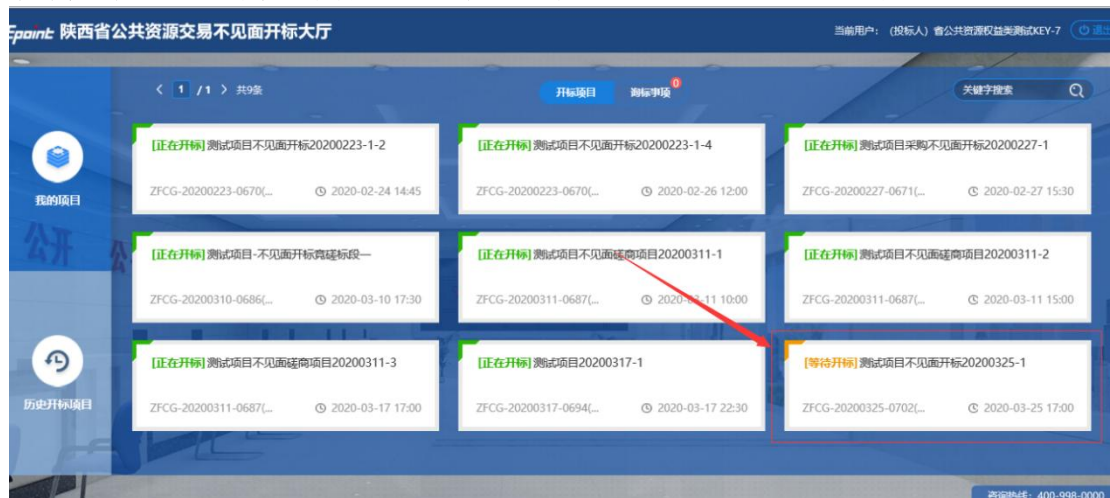

### 2、阅读开标流程

投标人阅读开标流程。

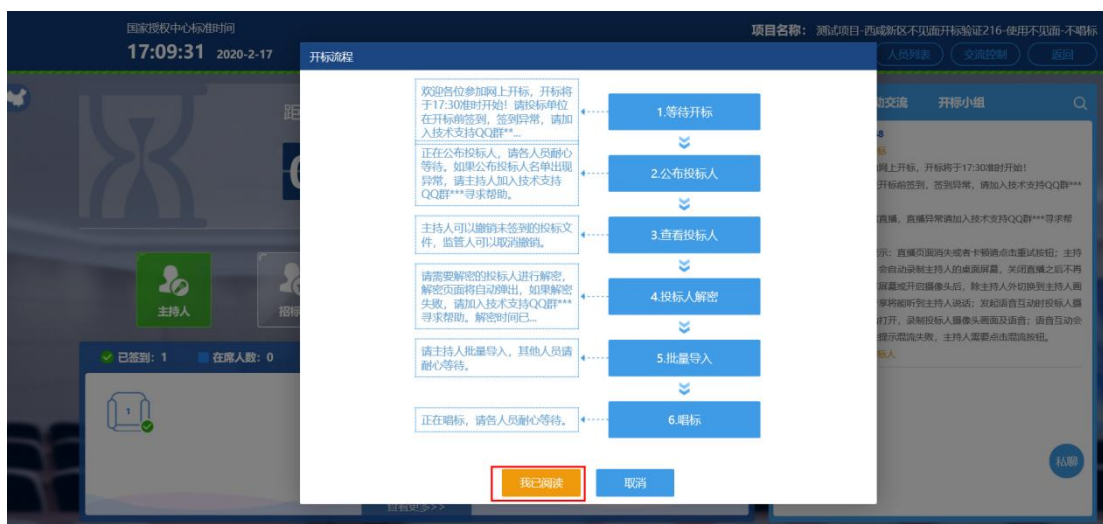


### 3、查看投标人

开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒，等待公布投标人



投标人公布完成后，投标人名单有图标展示模式和列表展示模式，可根据自己意愿进行切换。

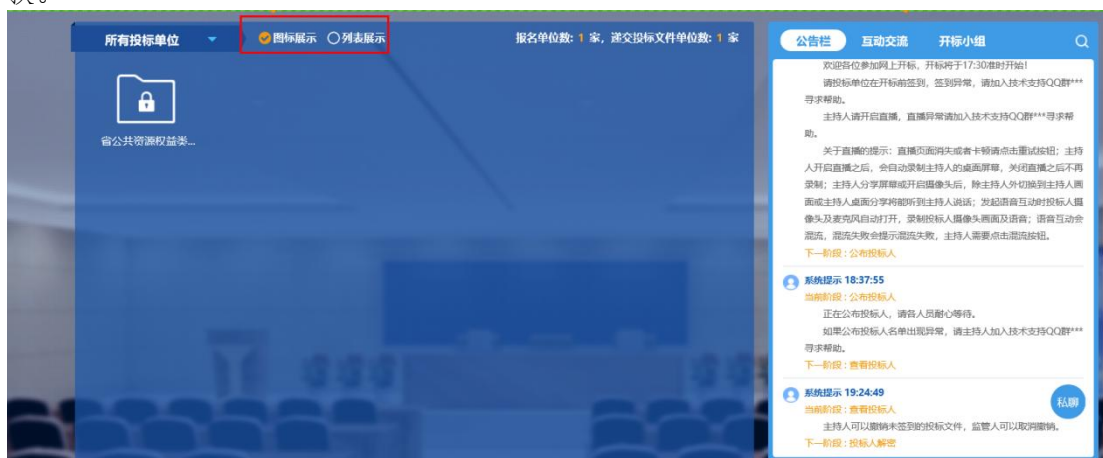

所有投标单位					报名人数数: 1 家, 递交投标文件单位数: 1 家
		图标展示	列表展示		
序号	投标单位名称	递交状态	文件状态	文件送达时间	
1	省公共资源权益类测试KEY-9	已递交	未启封	2020-02-17 14:41:22	

## 4、投标人远程解密

采购代理机构主持人宣布进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。系统会自动弹出以下界面。

剩余时间: 00: 26: 11

图标展示 列表展示

此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 0 家

我的投标文件

解密剩余时间

00: 26: 11

请输入PIN码: .....

解 密

开标异议文字提问

公告栏

面或主  
像头及  
混淆,  
下一

系统指  
当前解  
正  
如  
寻求帮  
下一

系统指  
当前解  
主  
下一

系统指  
当前解  
请  
失败,  
解  
或进行  
下一

解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。

注意：解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

剩余时间: 00: 23: 54

☒ 图标展示 ☐ 列表展示

此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 1 家

公告

面  
像  
混  
下

系  
当

号  
下

系  
当

下

系  
当

失

或  
下

我的投标文件

剩余时间: 00: 22: 53

☐ 图标展示 ☒ 列表展示

此次共 1 家投标单位需要解密, 已解密 1 家

序号	投标单位名称	投标单位解密状态	解密时间	最终解密状态
1	我的投标文件	解密成功	2020-02-17 19:33:58	解密成功

开标异议文字提问

## 5、投标文件批量导入

由采购代理机构将解密成功的投标文件进行批量导入。导入前任何人无法打开已解密的投标文件。

## 6、唱标及公布开标结果

解密成功后投标人可在线等待唱标，等待公布开标结果。





## 7、开标结束

开标结束后投标人可对开标过程进行评价。



## 三、其他功能介绍


### 1、主持人桌面分享以及开标环境查看

投标人在采购代理机构主持人开启直播间后，可以通过控制下图查看按钮，进行“主持人桌面分享查看”以及“开标环境查看”操作。




## 2、互动交流

投标人可在互动交流页面查看采购代理机构发出的文字、语音信息，当采购代理机构发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。

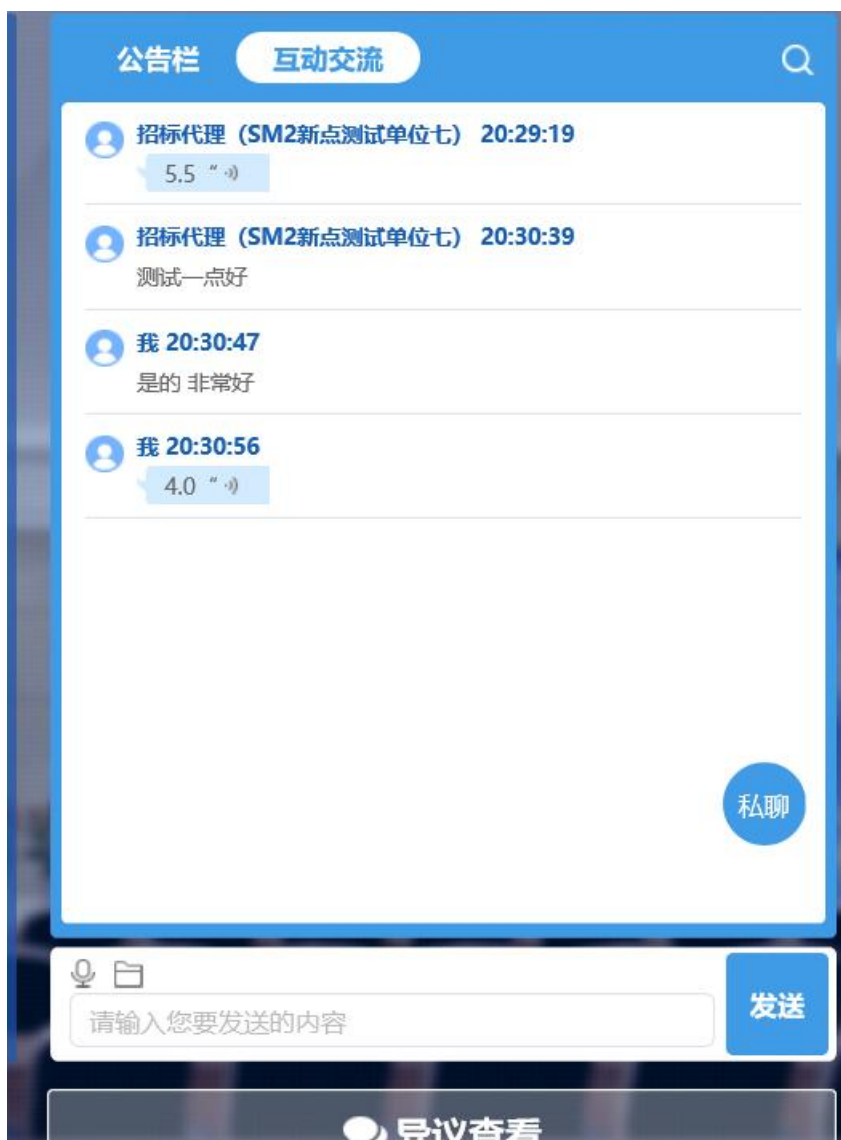


当采购代理机构开启私聊，并有人向投标人发送了私聊信息后，投标人端会在左下角看到有私聊提醒，点击即可与其进行私聊。



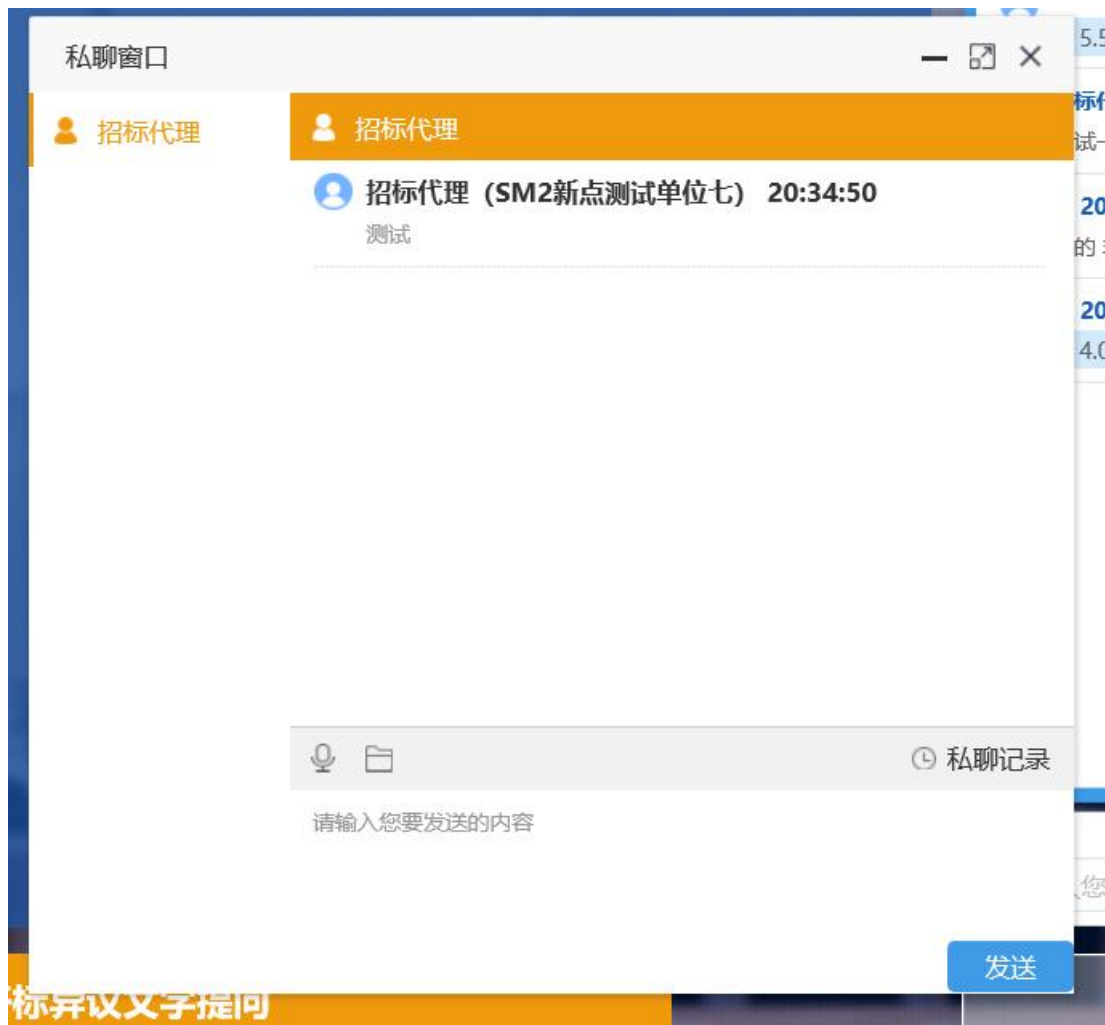

### 3、开标异议提出及答复

投标人可通过“开标异议文字提问”向采购代理机构提出异议

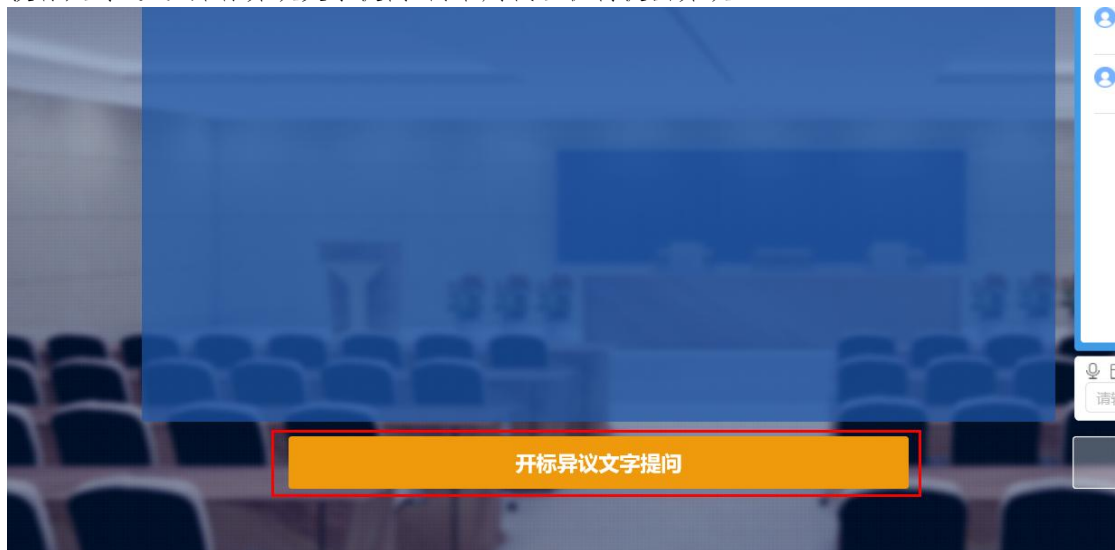

填写异议内容、依据和理由，也可上传相关证明附件。

[illegible]

#### 4、异议查看

投标人可通过异议查看功能查看自己或其他投标人提出的异议及异议的回复内容。

[illegible]

## 四、注意事项

1、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

2、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

3、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。及时关注右侧公告及互动栏目信息。