政府采购项目

采购项目编号：SCZC2026-ZB-3491-001

靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二六年十一月

目　录

第一章　招标公告 1
第二章　投标人须知 6
第三章　评标方法和标准 29
第四章　拟签订的合同文本 40
第五章　采购需求及参数要求 44
第六章　投标文件格式 98

第一章　招标公告

靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目招标公告

项目概况

靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用 CA 锁获取招标文件，并于 2026 年 11 月 27 日 09 时 30 分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZC2026-ZB-3491-001

项目名称：靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：11,443,320.00 元

采购需求：

合同包 1(靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目)：

合同包预算金额：11,443,320.00 元

合同包最高限价：11,443,320.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他医疗设备	便携式超声诊断系统宫腔镜利普刀治疗仪等	1(批)	详见采购文件	11,443,320.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日内

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目)特定资格要求如下:

3.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的，不得参加投标。

3.2 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（或单位负责人）参加投标的，应提供法定代表人（或单位负责人）身份证明，并与营业执照上信息一致；授权代表参加投标的，应提供法定代表人（或单位负责人）身份证明、授权委托书及授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

3.3投标产品属于第二类医疗器械管理的投标人需提供第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于第三类医疗器械管理的投标人需提供医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内），若投标人为制造厂家须同时提供医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）。

3.4 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。

3.5 所投车辆及生产厂家须在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》内并提供截图。

3.6 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.7 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间： 2026 年 11 月 06 日 至 2026 年 11 月 12 日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）使用 CA 锁

方式：在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026 年 11 月 27 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号)、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》(陕财办采〔2018〕23 号)、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10 号)。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》(财库〔2022〕35 号)、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》(财办库〔2023〕52 号)。

1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34 号)。

若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、采购文件获取方式:供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式,供应商使用数字认证证书(CA 锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(http://yl.sxggzyjy.cn/),选择“服务指南”,点击“下载专区”,点击榆林不见面开标系统操作手册(供应商)、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0,请供应商仔细阅读操作手册,了解操作流程,熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜,若无法正常投标,供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线:400-998-0000;CA 锁购买:榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话:0912-3515031。

4、请各供应商获取采购文件后,按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求,通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、项目概况:靖边县紧密型医共体建设项目妇保院和乡镇卫生院医疗设备等采购项目,家庭病床家医随访包、医护上门便携式护理包、除颤仪...具体参数详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：靖边县卫生健康局

地址：榆林市靖边县统万路县政府办公大楼3楼

联系方式：0912-4643032

2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

联系方式：029-85257505

3.项目联系方式

项目联系人：罗琳、田婧、王莉

电话：029-85257505

第二章　投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内　　容
1.1	采购人：靖边县卫生健康局 地　址：榆林市靖边县统万路县政府办公大楼3楼 电　话：0912-4643032
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层 联系人：罗琳、田婧、王莉 电话：029-85257505
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见招标公告。
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购：否
1.3.5	是否允许采购进口产品：否
1.4	是否允许联合体投标：否
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业：工业（制造业）
2.2	项目预算金额：详见招标公告； 最高限价：详见招标公告；
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标/包（不适用）
12.1	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，按投标文件格式提供投标信用承诺书。 投标人在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）（网址：https://credit.yl.gov.cn/）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书： **“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标信用(保证金）承诺书”、“投标人委托代理人员信用承诺书”** 各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用承诺。 并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段+投标保证金”（例：××××××项目-××标包+投标

	保证金）。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日
14.1	本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。
16.1	投标截止时间：2026年11月27日09时30分
18.1	开标时间：2026年11月27日09时30分 开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.4	本项目涉及的政府强制采购产品：笔记本电脑、黑白打印机（所投产品为激光打印机、针式打印机需提供）
20.5	支持本国产品： ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
20.6	本项目核心产品：“两癌”筛查专用车
23.2	评标方法：适用 综合评分法
27.1	推荐中标候选人的数量： 3
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否
31.1	是否提交履约保证金：是
32.1	预付款比例为： 30%
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：本项目招标代理服务费为3万元。 中标单位的招标代理服务费交纳信息： 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账　　号：78560188000095264 联 系 人：财务部　联系电话：029-85263975
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014

38	不见面开标注意事项及流程
38.1	本项目为不见面开标： 须严格按照以下要求及内容进行执行,因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 1 采用不见面开标的方式进行； 1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 1.2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 2、不见面开标流程相关注意事项如下： 2.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种： 2.2 IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login; 2.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 2.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 2.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 2.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 2.8 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
39	1、投标文件内的投标产品信息必须与注册证、设备标牌信息一致。

	2、中标后所签合同产品信息与注册证、设备标牌、投标文件、所开发票、随货同行信息必须一致。
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见招标公告。
2	投标人应提交的其他文件：满足评审需求即可

（二）投标人须知

一、总　则

1.　　采购人、采购代理机构及投标人

1.1　采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2　采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3　投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1　具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2　以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3　符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4　若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5　若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4　如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1　两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2　联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3　采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4　联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5　大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效。**

1.4.7　对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6　为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7　本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.　资金来源

2.1　本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2　项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3　投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.　投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.　适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.　招标文件构成

5.1　招标文件共六章，构成如下：

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标方法和标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　采购需求及要求

第六章　投标文件格式

5.2　招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3　投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4　现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.　招标文件的澄清与修改

6.1　采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.　投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.　投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1　投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 详见投标人须知前附表。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

14.2 投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的加密

15.1 投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 开标时，由采购人或采购代理机构组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2　采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1　投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3　按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.　投标文件符合性审查与澄清

20.1　符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2　投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3　投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

20.6 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2） 未满足招标文件中商务要求或技术实质性要求、存在漏项或数量与要求不符；

（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通

知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款

保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。业务流程简图如下：

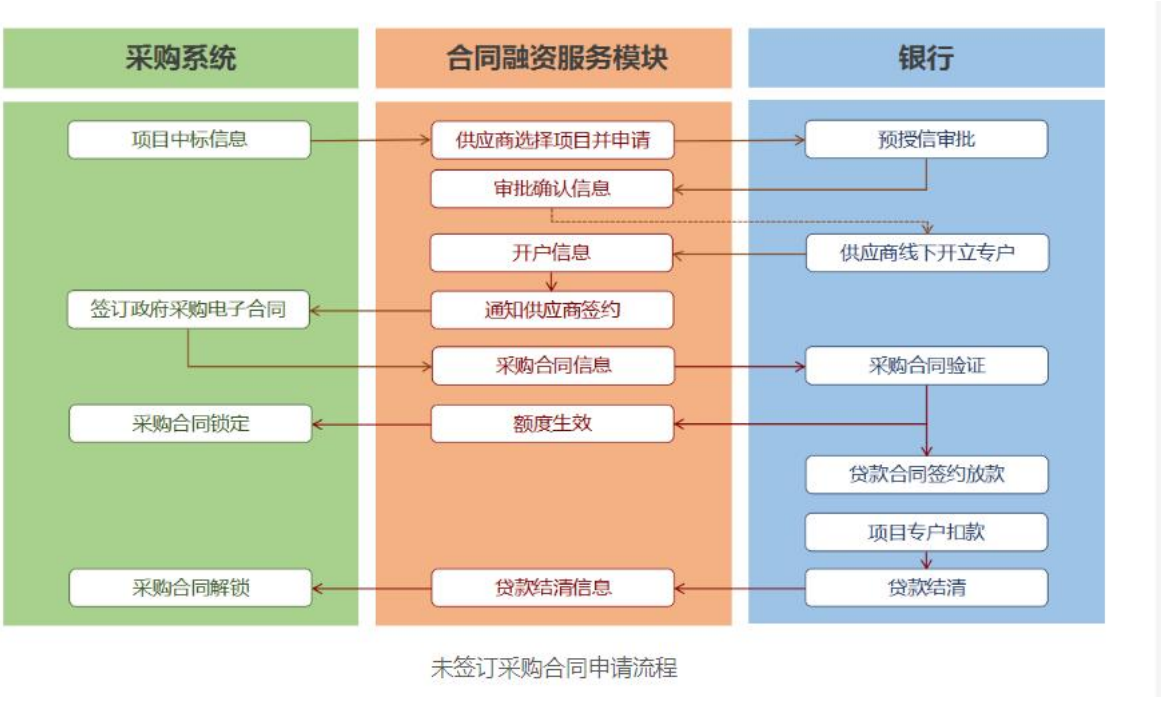

未签订采购合同申请流程

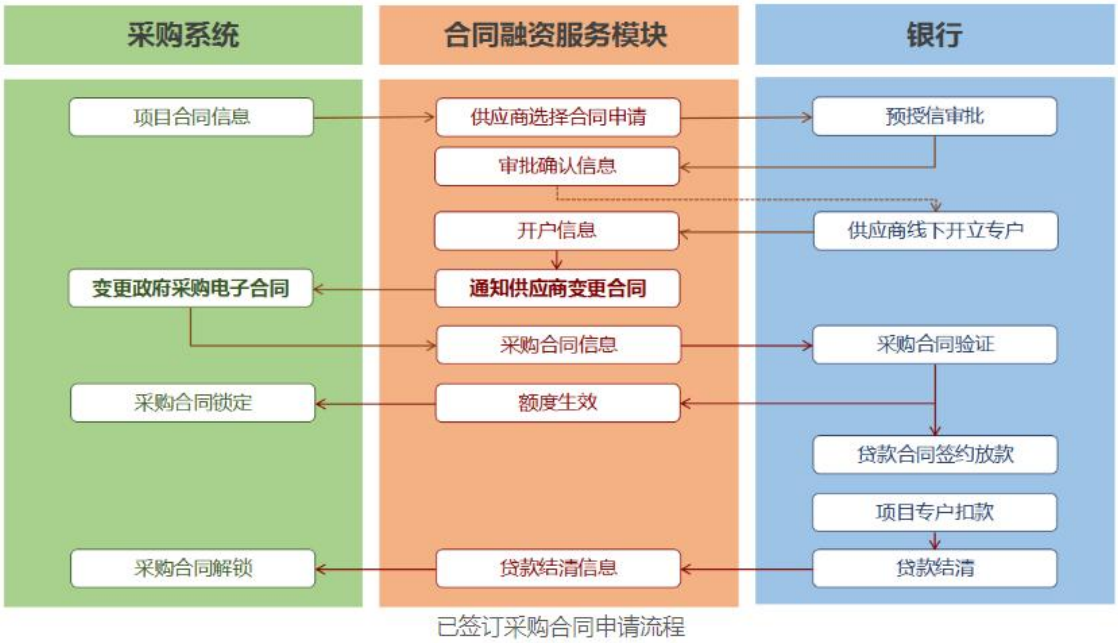

已签订采购合同申请流程

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3%	72 小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.3%	72 小时	尹皓永 18791214448
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886

5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑

投标人将依法承担不利后果。

37.3　投标人提交质疑函的要求

37.3.1　投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2　质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3　质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4　质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5　质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6　质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4　质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，　见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）：

鉴于____（下称被保证人）将于__年 月 日参加贵方招标编号为__（采购项目编号）的__（项目名称）__的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）____元（小写）___元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_____

单位地址：_____

电话：_____

日期：_____年_____月_____日

附件2：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于___年__月__日签定编号为　的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年_____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后_____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．　我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后

按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

时间：_____年_____月_____日_____

第三章　评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 未满足招标文件中商务要求或技术实质性要求、存在漏项或数量与要求不符；

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐

中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构复核评标报告。

三、评审标准中应落实的政府采购政策及应考虑因素

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，**其投标报价扣除 20% 后参与评审**。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成

本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8、异常低价审查

8.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一　资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2	财务状况报告：提供（1）或提供（2）	**（1）提供2025年度经审计的财务报告，应满足以下要求：** ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。**且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。** ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表(不要求必须是经审计的)，复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。	
		（2）提供资信证明原件或复印件，后附开户许可证或基本户信息复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3	依法缴纳税收的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	**按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。**	
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	**按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。**	
7	特定资格要求	7-1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的，不得参加投标； **（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。**	
		7-2法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 **（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；** **（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责**	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
		7-3 投标产品属于第二类医疗器械管理的投标人需提供第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于第三类医疗器械管理的投标人需提供医疗器械经营许可证（投标产品须在其经营范围内），若投标人为制造厂家须同时提供医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；	
		7-4 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；	
		7-5 所投车辆及生产厂家须在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》内并提供截图；	
		7-6-1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 **按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明**	
		7-6-2 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动 **按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。**	
		7-7 需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标	
8	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况	
审查结论		通过/不通过	

注：

1．采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二　符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	
3	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价或单价最高限价	
4	投标信用承诺书	按投标文件格式提供投标信用承诺书	
5	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
6	投标内容	投标内容满足招标文件中商务要求及技术实质性要求（★为实质性要求）、不存在漏项或数量与要求不符	
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注）	
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

附表三　评审标准

（采用综合评分法时适用）

评标要素	分值	评标标准	主观/客观
价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 （小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目不进行价格扣除。） （政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。）	客观
技术指标	45	**一、节能、环境标志产品（1分）** 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分1分。**政府强制采购产品不予加分。** **备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。** **二、投标产品技术指标评审内容（44分）**	客观

		投标产品的技术指标评审：完全响应得44分。▲技术指标参数一项不满足扣1分，非▲技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 **评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明、彩页、官网截图等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码；无技术材料支持视为负偏离。** **注：技术指标中“★”类为核心指标，如发生负偏离视为非实质性响应，其投标将被认定为无效投标。**	
产品业绩	5	提供2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。 **评审依据：**以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。	客观
实施方案	10	一、评审内容：提供完整可行有针对性的实施方案，包含：①供货方案、②安装调试方案、③技术支持方案、④质量保证措施、⑤验收方案。 二、评审标准：每项内容完整可行且有针对性得2分，缺漏项不得分，满分10分；每项内容中每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）	主观
售后服务方案	10	一、评审内容：提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含：①售后服务范围及保障措施、②应急保障方案、③培训方案、④故障处理及补救措施、⑤备品配件服务承诺。 二、评审标准：每项内容完整可行且有针对性得2分，缺漏项不得分，满分10分；每项内容中每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）	主观

第四章　拟签订的合同文本

编号：

设备购销合同

需方：靖边县卫生健康局

供方：

供需双方经过招标程序，就需方购买供方的如下设备达成一致，为确定供需双方的权利和义务关系，现依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，特订立如下协议条款供双方共同遵照执行。

一、　购销产品

详见购销清单

二、合同价款：

1、合同总价：_____元（大写：_____整 ）（为含税价）

2、合同总价包括：运杂费、装卸费、安装调试费（如需拆门洞、砸墙体、玻璃拆卸等安装要求）、培训费和税费等全部费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

4、所有配置清单详见附件。

三、知识产权：供方应保证，需方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如发生第三方权利主张，供方应无条件承担全部法律责任、赔偿需方全部损失并负责协调解决。如因知识产权纠纷导致需方无法正常使用设备，供方应无条件退货、退款并赔偿全部损失。

四、交货期：合同签订后 30 日内。

五、交货地点：采购人指定地点。

六、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。供方应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

七、运输：供方可根据交货（完工）期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外）并承担一切运输费用及风险。

供方在运输、装卸、安装过程中造成的设备、材料损失、人身安全，均由其承担一切责任和后果。

八、付款方式：

合同签订，乙方向甲方开具中标价5%履约保函后，甲方30个工作日内支付合同总金额的30%的预付款，整体供货进度达到70%起10个工作日内，支付合同总金额的40%。设备全部安装、调试完成，验收合格交付使用，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30%。

若在规定期限内供方不能提供履约保函的，需方拒付预付款，设备到货后经安装、调试、验收、试运行合格后，需方一次性付清设备货款。

付款前，供方需向需方提供合法有效的增值税☑专用/☑普通发票及需方要求的其他材料，否则，需方有权暂时拒付款项。如供方存在任何违约、质量问题、延迟交付、资料不全等情形，需方有权暂停或拒绝付款，且不承担任何违约责任。

九、技术保障：

供方应随货提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南、医疗器械注册证/备案凭证复印件、生产经营许可文件等资料），技术保障服务。合同内所购设备必须能够和医院现有设备以及信息系统相匹配相链接，科室有需求的所购设备接入医院所有网络端口费用均由供方承担。

十、质量保证：

供方应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的，且符合国家医疗器械注册证核准的适用范围及技术参数，并完全符合合同规定的质量、规格、技术、指标等要求，并在质保期内、对于产品设计、工艺的缺陷而产生的质量问题负责。

验收合格起，全套产品整机免费保修3年，负责终身软件升级、维护，提供质保证明文件，保修期内因任何非人为因素导致的损坏的设备故障，供方应免费更换整机或核心组件，终身维修并提供配件价格不高于同期市场公开报价的70%。检验科设备质保期内每年提供不少于2次预防性维护保养和设备校准服务。如供方未履行终身维修承诺，需方有权要求供方承担违约责任并赔偿因此造成的全部损失，供方停产或终止经营的，应提前3个月书面通知需方，并提供维修资料、备件清单及第三方维修承接方案，否则按违约处理。

十一、应提供的伴随服务：

1）监督所供货物的现场组装，实施所供货物的试运行；

2）提供货物组装和维修所需的工具；

3）为所供货物的每一台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护、修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

5）在项目现场就所供货物进行安装、调试及运行，对科室使用人员及维修人员不限人数和次数进行培训，直到熟练掌握为止。对科室有培训需求的设备厂家或者经销商负责培训医师__人、技师__人、护士__人，到国内顶级医院培训时间不少于__个月。

十二、验收：

设备安装调试完毕后，经试运行合格后，由需方申请靖边县发改局组织验收，检验科设备（全自动血细胞分析仪（含工作站）、全自动尿液干化学分析仪（含工作站）、全自动化学发光免疫分析仪（含工作站））进行性能验证后方可完成验收。验收合格后所有权移交需方，并交接全部相关资料，验收须以合同、国家/行业标准、规范及投标技术响应等为依据。验收不合格的，需方有权要求供方限期整改并按照合同第十七条承担违约责任。

十三、售后服务：

供方接到需方仪器故障报修后，须在 1 小时内做出回应，24 小时内到达需方医院。如供方未按上述时限响应或到场，需方有权委托第三方机构代为维修，由此发生的费用由供方承担。

十四、终止解除：

本合同因履行完毕、或出现本合同约定解除事由的、或双方协商一致而终止和解除；除本合同有约定外，任何一方无权单方解除合同。需方有权在供方违约、设备存在重大质量问题、供方资信恶化等情况下单方解除合同，并有权要求供方赔偿因此造成的全部损失。

十五、纠纷解决：

本合同履行过程中发生纠纷时，双方首先应友好协商解决，协商不成，双方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十六、不可抗力：

因不可抗力导致合同目的不能实现或持续超过 60 日的，任何一方均可解除合同；且供方必须在事件发生时尽快电告需方，解除后供方应在 30 日内退还已收货款中未对应交付货物部分。

十七、违约责任：

1、依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规

定和本合同约定，除不可抗力外，供方未足量交货、逾期交货、未按约定标准完成安装调试培训服务、未履行质保或售后服务义务、提供的技术文件不完整等任一情形，需方有权要求供方进行整改，合同继续履行。如供方交付的货物产品质量不合格，需方有权解除本合同，要求供方退还已付款，供方需要立即拆除并搬离该设备及按照本合同总标的额的30%向需方承担违约责任。

2、供方不得将合同权利义务转让、分包、委托第三方履行，除非经需方书面同意。供方在运输、装卸、安装、调试、培训等全过程中发生的任何人身、财产损失、行政处罚等均由供方全额承担，需方免责。需方有权随时对供方履约情况进行监督、检查，供方应无条件配合。

3、供方应对在履行本合同过程中知悉的需方商业秘密、患者数据、系统信息等保密信息承担保密义务，未经需方书面同意不得向第三方披露，本条款在合同终止后继续有效。 供方违反保密义务约定的，应当按照合同价款的30%承担违约责任，违约金不能弥补需方损失的，供方应当予以补足。

十八、本合同一式__份，供方执__份，需方执__份，具有相同的法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。合同任何变更、补充、解释均须双方书面签署，口头或单方变更无效。未经双方同意，任何一方不得擅自修改合同内容或撤销合同，法律法规另有规定的情形除外。如因法律法规变化导致合同履行受影响，双方应协商调整，需方有权决定是否继续履行。

十九、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同内容不一致的，以补充协议内容为准。

（以下无正文）

需方单位：

开户银行：

账号：

地址：

电话：

法人签章：

委托授权人签章：

签署日期：　　年　　月　　日

供方单位：

开户银行：

账号：

地址：

电话：

法人签章：

委托授权人签章：

签署日期：　　年　　月　　日

第五章　采购需求及参数要求

一、采购清单

序号	项目名称	单位	数量	其他
1	硬件设施-家庭病床家医随访包	套	28	医疗设备-共享中心
2	硬件设施-医护上门便携式护理包	套	28	
3	除颤仪（急救车使用）	套	10	
1	便携式彩色超声诊断系统（含工作站）	套	1	医疗设备-妇幼、乡镇医院
2	全自动血细胞分析仪（含工作站）	套	1	
3	宫腔检查镜及等离子电切镜系统	套	1	
4	利普刀治疗仪	台	1	
5	二氧化碳激光治疗仪（妇产科）	台	1	
6	麻醉机	台	1	
7	生殖道分泌物微生态分析仪（含工作站）	套	1	
8	全自动尿液干化学分析仪（含工作站）	套	1	
9	微量元素分析仪（含工作站）	套	1	
10	自动取单机	台	1	
11	全自动洗板机	台	1	
12	生物安全柜	台	1	
13	全自动化学发光免疫分析仪（含工作站）	套	1	
14	医用离心机（48 孔）	台	2	
15	液基细胞制片染片机（含工作站）	套	1	
16	B 超 （镇靖镇卫生院、天赐湾卫生院）	套	2	
17	全自动生化分析仪 （周河镇卫生院、天赐湾卫生院、 席麻湾镇卫生院、王渠则镇卫生院）	套	4	
18	呼吸机	套	10	

“两癌”筛查车				
19	“两癌”筛查专用车（核心产品）	辆	1	
20	妇科射频治疗仪	台	1	
21	身高体重测量仪（智能型）	台	1	
22	妇科检查床	张	1	
23	身份证读卡器	台	1	
24	笔记本电脑	台	2	
25	黑白打印机	台	1	
26	冷光妇科检查灯	台	1	
27	医用冷藏箱	台	1	

二、技术要求

2.1医疗设备-共享中心

1、家庭病床家医随访包参数

一、设备名称及数量

1.1 设备名称：家庭病床家医随访包

1.2 数量：28 套

二、用途

用于家庭病床服务的建床评估、定期巡诊、上门诊疗与健康管理。支持医护人员入户完成生命体征监测、心电图检查、用药指导、护理处置等操作，实现家庭病床病历、医嘱、随访记录的电子化采集与上传，支持与家庭病床管理系统、基本公共卫生服务平台、医保信息平台的数据对接。

三、技术参数要求

3.1 包体设计：便携式医用硬质箱/包，外层防水耐磨、防震抗压，内衬防渗漏易清洁；多层分区多隔袋设计，器械与耗材分类固定收纳。

3.2 外形尺寸：≤450mm×350mm×230mm；整包（含器械）重量≤8kg，配备加厚肩带与手提把手，支持手提/单肩/双肩携带。

3.3 检测功能：支持血压、脉率、血氧、体温、血糖五项基础检测，并具备十二导联（或单导联）心电采集功能；可扩展体重、尿常规、肺功能等检测。

3.4 血压测量：0～299mmHg，精度±3mmHg；脉率 40～200 次/分。

3.5 血氧测量：70%～100%，精度±2%。

3.6 体温测量：32～42℃，精度±0.2℃；支持非接触式测温。

3.7 血糖测量：1.1～33.3mmol/L，免调码，测量时间≤10 秒。

3.8 心电采集：支持 12 导联心电采集与显示，具备心律失常自动分析、导联脱落提示功能，数据可对接家庭病床管理系统。

3.9 数据终端：Android 智能终端，屏幕≥10 英寸触摸屏，支持触控与手写录入。

3.10 通讯方式：支持蓝牙、WiFi 及 4G/5G 无线通讯，检测设备与终端自动互联，支持数据实时上传与离线补传。

3.11 医保与身份识别：支持身份证/医保卡读卡识别，可快速调取患者家庭病床档案并

完成医保结算相关信息采集（按当地医保接口要求对接）。

3.12 定位与签到：内置 GPS/北斗定位，支持上门服务签到、巡诊轨迹记录，满足家庭病床服务考核要求。

3.13 打印功能：可选配便携式蓝牙打印机，支持上门即时打印处方、医嘱单及随访记录（选配）。

3.14 应急配置：含急救药品盒（含常用急救药品放置位）及简易急救器械（开口器、简易呼吸器、止血带等）。

3.15 电源续航：内置锂电池，连续工作时间≥8 小时；支持交直流两用及车载供电。

3.16 数据安全：本地存储+云端同步，具备数据加密、操作日志与权限分级管理功能。

3.17 软件功能：家庭病床建床/撤床管理、巡诊计划与提醒、随访记录、医嘱管理、健康评估、统计报表及数据上传等功能。

3.18 环境适应性：工作温度 0～40℃，相对湿度≤85%，满足上门服务使用环境。

2、医护上门便携式护理包

一、设备名称及数量

1.1 设备名称：医护上门便携式护理包

1.2 数量：28 套

二、用途

用于基层医疗机构开展"互联网+护理服务"、家庭病床护理、居家养老上门护理等场景，为护士及护理人员提供上门服务的便携装备，满足生命体征测量、基础护理操作、消毒隔离、应急处置及护理记录电子化等工作需要。

三、技术参数要求

3.1 包体设计：便携式护理包，外层采用防水、耐磨、防泼溅材料，具备防震抗压性能；内衬防渗漏处理，表面可耐常用消毒剂擦拭清洁。

3.2 结构布局：内部多层分区、多隔袋设计，护理器械与耗材分类定位收纳，配弹力固定带；包盖展开可作临时操作台面，取用便捷。

3.3 携带方式：配备宽幅加厚单肩背带及手提把手，支持手提、单肩、双肩背负多种方式，便于上下楼及入户携带。

3.4 外形尺寸：≤400mm×280mm×200mm；整包（含配置物品）重量≤4kg。

3.5 基础检测设备：配置电子血压计、指夹式血氧仪、电子体温计各 1 件，满足上门基础生命体征测量。

3.6 血压测量：测量范围 0～299mmHg，精度±3mmHg；脉率 40～200 次/分。

3.7 血氧测量：测量范围 70%～100%，精度±2%；体温测量：32～42℃，精度±0.2℃。

3.8 护理器械：配置医用剪刀、止血钳、医用镊子、压舌板、叩诊锤、医用瞳孔笔（手电筒）、体温计、砂轮、弯盘等基础护理器械，金属器械采用不锈钢材质、耐腐蚀。

3.9 护理耗材：配置一次性医用口罩、一次性手套、一次性注射器、输液器、留置针固定敷贴、无菌棉签/棉球、纱布、医用胶带、酒精棉片等基础护理耗材及定位收纳。

3.10 消毒隔离：配置速干手消毒液、酒精/碘伏消毒剂及专用收纳位；配置利器盒与医疗废物专用收集袋，实现清洁物品与污染物分区存放。

3.11 标识与管理：包体外部印制"医护上门护理包"标识及医用红十字标志，配置物品清单卡，便于清点、补充与管理。

3.12 清洁消毒：包体及内衬可耐受含氯消毒剂、75%酒精等常用消毒剂擦拭，不褪色、

不变形。

3.13 安全要求：材料无毒无异味，符合医用材料相关要求；具备防跌落、耐磨性能，适应户外及入户使用。

3.14 可扩展配置：可选配移动护理终端（平板/手机 APP）、便携式蓝牙打印机，实现上门护理记录、知情同意书及护理单据电子化（按需选配）。

四、主要配置清单

序号	配置名称
1	便携式护理包（包体）
2	电子血压计
3	指夹式血氧仪
4	电子体温计
5	基础护理器械（剪刀/止血钳/镊子/压舌板/叩诊锤/瞳孔笔/弯盘）
6	一次性护理耗材（口罩/手套/注射器/输液器/敷贴/纱布/胶带/棉签）
7	消毒用品（速干手消液/碘伏/酒精棉片）
8	利器盒及医疗废物收集袋
9	物品清单卡、说明书、合格证

3、除颤仪（急救车使用）

1.物理规格/性能

1.1 整机重量≤5.3kg

1.2 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m 跌落冲击

1.3 防尘防水级别≥IP44

1.4 环境适应能力强，工作温度范围 0℃～45℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，工作 60 分钟；存储温度范围-30～70℃；工作/存储湿度范围 10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）

1.5 除颤监护仪面板按除颤 1-2-3 步操作分区显示

1.6 提供双色报警灯

1.7 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南

1.8 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频

2.显示屏

2.1 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7 英寸；分辨率≥800×480 像素；可显示≥4 通道监护参数波形

2.2 支持中文操作界面

2.3 有高对比度显示界面，支持户外查看

3.电源及电池

3.1 内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换

3.2 电池工作时间：连续监护时间≥6 小时；≥300 次 200J 充放电；≥200 次 360J 充放电

4.手动除颤

4.1 支持成人、小儿、新生儿，提供注册证等证明文件

4.2 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

4.3 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分 20 档以上

4.4 输出能量：成人最大能量可支持 360J

4.5 开机速度快，从开机到显示除颤界面≤2s

4.6 充电至 200J≤4s

4.7 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s

4.8 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值

4.9 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量

4.10 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

4.11 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

5.半自动除颤（AED）

5.1 支持 AED 语音提示；提供 CPR 节奏音，满足 AHA/ERC 指南要求；支持 AED 录音功能，可保存≥180 分钟抢救现场录音

6.起搏

6.1 支持 4:1 降速起搏功能

7.监护

7.1 支持 3/5 导心电监护

7.2 频率响应范围 0.05-150Hz；共模抑制比最大支持≥105dB

7.3 支持 ECG 模拟输出功能

7.4 支持阻抗呼吸，呼吸频率：0-200rpm

8.记录仪

8.1 内置≥50mm 宽度热敏记录仪

8.2 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警

8.3 走纸速度：6.25，12.5，25，50mm/s

9.存储容量

9.1 可存储≥20 小时连续心电波形；可存储≥800 个事件

9.2 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据

10.设备维护与自检

10.1 设备具有用户检测和设备自检功能

10.2 支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检

10.3 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量

10.4 支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示

10.5 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态

10.6 查看自检报告方便快捷，自检报告显示的检测项支持用户自定义。

10.7 自检失败时，提供图文故障排除提示

2.2医疗设备-妇幼、乡镇医院

1.便携式彩色超声诊断系统（含工作站）

用途：适用于妇产科检查、小器官与浅表组织检查等

一、	主要规格功能及系统概述：
1.1	笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：
1.1.1	≥15 英寸高清晰度彩色液晶显示器
1.1.2	数字化二维灰阶成像单元
1.1.3	数字化彩色及能量多普勒单元
1.1.4	数字化频谱多普勒显示和分析单元
1.1.5	多角度空间复合成像技术
1.1.6	智能化斑点噪声抑制技术
1.1.7	自动优化功能
1.1.8	实时宽景成像技术
1.1.9	实时同屏教学软件
1.1.10	M 模式，具备彩色 M 模式及解剖 M 模式
1.1.11	主机上实现实时及脱机状态 M 型扫描线可以以任意点为轴心 360°旋转
1.1.12	自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)
1.1.13	谐波成像（可用于所有探头）
1.1.14	整机重量≤6Kg（含电池）
▲1.1.15	物理通道数≥128
1.1.16	可视可调系统动态范围≥90db
1.1.17	超声系统最大探查深度≥40cm
1.1.18	实时三同步成像
1.1.19	线阵探头凸型扩展技术
1.1.20	自动射血分数测量功能
1.1.21	穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时调节
1.1.22	AUTO IMT 颈动脉中内膜测量技术

1.1.23	轨迹球操作
1.1.24	中文操作界面，中文输入（包括报告、注释等）
1.1.25	支持 TVI/TVD 组织多普勒
1.2	**测量和分析：(B 型、M 型、彩色 M 型、频谱多普勒、彩色模式)**
1.2.1	一般测量
1.2.2	妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、可根据多数据比对、子宫和卵巢的测量计算并编辑报告功能）
1.2.3	多普勒血流测量与分析
1.2.4	实时多普勒自动包络、测量和计算
1.2.5	心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告
1.2.6	外周血管测量与分析
1.2.7	泌尿科测量与分析
1.3	一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元
1.4	一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像
1.5	内置固态硬盘≥256GB
1.6	DVD 驱动器
1.7	USB 接口≥1 个
二	**探头规格及其他**
2.1	探头类型：支持凸阵，线阵，相控阵，经腔内探头
2.2	二维灰阶显像主要参数：
2.2.1	电子凸阵：探头频带范围 2.0-5.0MHz
2.2.2	电子线阵：探头频带范围 6-12MHz
2.2.3	腔内微凸探头：探头频带范围 4.2-10.0MHz
▲2.2.4	凸阵探头有效阵元数≥128 阵元
2.2.5	相控阵探头最大扩展角度≥100°
2.2.6	扫描速率： B 模式凸阵探头全视野，18cm 深度时，帧速率≥50 帧/秒

2.2.7	扫描速率： B 模式相控阵探头 90 度，18cm 深度时，帧速率≥40 帧/秒
2.2.8	带扩展探头接口≥3 个
2.2.9	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
2.2.10	TGC 调节≥8 段
2.3	频谱多普勒：
2.3.1	最大测量速度：
	PWD：血流速度≥8.0 m/s
	CWD：血流速度≥14.0 m/s
	PW 最低测量速度 5mm/s
2.3.2	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D
2.3.3	取样宽度及位置范围：宽度 1mm-16mm；分级可调
三	工作站配置
3.1	CPU:i7 及以上、 内存≥16G，硬盘≥1T，独立显卡，显示器≥23 英寸，彩色喷墨打印机 1 台
3.2	配备台车 1 辆，手提包 1 个

2.全自动血细胞分析仪（含工作站）

一、仪器基本功能

1、检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110 个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100 样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100 样本/小时。

2、报告参数：血液分析报告参数≥35 个，三维散点图≥3 个；体液分析报告参数≥6 个；CRP 报告参数≥2 个；SAA 报告参数≥1 个。

3、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测 CDR+CRP 用血量≤40 μl，末梢全血检测 CDR+CRP+SAA 用血量≤40 μl，预稀释模式 CDR+CRP+SAA 用血量≤20 μl。

5、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

6、末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

7、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和 CRP、SAA 检测，有急诊插入功能。

8、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能

9、使用荧光染料和半导体激光检测 WBC 五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10、全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

13、具有低值血小板检测功能。

14、具有对 EDTA 依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能。

15、具有低值白细胞检测功能。

二、设备配置清单：

1. 全自动血液细胞分析仪主机：1 台，（包括 CRP/SAA 检测模块）。

2. 中文工作站（含软件）1 套：含电脑主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、条码扫描枪。

3. 随机试剂套装 1 套。

4. 3000WUPS1 台。

3、宫腔检查镜及等离子电切镜系统

技术参数

一、摄像主机

1、▲≥6 种手术场景选择

2、图像传感器尺寸：1/1.8 英寸级，图像传感器类型：16:9 CMOS 或 CCD

3、中心分辨率≥1600 线

4、分辨率：≥3840(H)×2160(V)

5、信噪比：≥40dB

6、照度：≥1 lux F1.2

7、白平衡可手动锁定

8、具备放大功能

9、具备图像抓拍

10、具备视频录制

11、具备 HDMI(4K)输出端口数量：≥2 个

12、具备电子放大倍率：≥6 档，包括 1.0-2.0 按键循环

13、LED 触控屏

二、LED 冷光源

1、功率：≥80W

2、具备亮度可调

3、具备主机开关，同时具备灯泡开关

4、灯泡寿命：≥10000 小时

5、显色指数：≥90

6、色温：3000K-7000K

三、摄像头

1、白平衡：可手动锁定

2、电缆长度：≥2.8m

▲3、具备调焦功能，L 型摄像头，4K 分辨率

四、监视器

1、分辨率：≥3840(H)×2160(V)

2、背光灯寿命：≥15000 小时

3、≥32 英寸

五、妇科专用 台车

1、可悬挂摄像头

2、可放置显示器、摄像主机、光源、高频电刀等设备

六、一体诊疗镜及器械

（一）、一体诊疗镜：

1.插入部外径≤5mm

2.工作长度：≥200mm

3.可通器械最大直径：1.8mm±0.1mm

4.阀体：可 360° 旋转，可拆卸

5.支持循环水

（二）活检钳直径 1.8mm±0.1mm

（三）异物钳直径 1.8mm±0.1mm

（四）鼠齿钳直径 1.8mm±0.1mm

七、膨宫泵

1.适用于：宫腔镜、电切镜、腹腔镜、膀胱镜、关节镜等内镜使用场景

2.流量：0-2200ml/min

3.正压范围：0-250mmHg

八、能量平台（低温等离子）

1.工作频率：300KHz±10KHz

2.额定功率：等离子电切模式：0-300W；　等离子电凝模式：1-200W

3.安全等级 CF 型

4.主机全触摸彩色液晶屏。

九、电切镜

1.直径：≤4.0mm

2.长度：≥300mm

3.视场角：≥60°

十、操作器

1.被动式

十一、内鞘及闭孔器配合

1.直径：≤F22

十二、外鞘

1.直径：≤F22

十三、冲吸器，含接头

1.与电切镜相匹配

十四、电切环

1.具有重复使用电切环

2.具备一次性使用电切环

十五、刨削粉碎系统

1.1 宫腔镜。

1.2 组成：由内窥镜、镜鞘及部件三部分组成。

1.3 视向角：≥6°。

1.4 视场角：≥60°。

1.5 规格：≤Φ8.5 mm，镜子可 360°旋转（镜鞘不转动），具备连续灌流功能。

1.6 工作长度：≥170mm。

1.7 器械通道：≥4.2mm

▲1.8 景深：3～50 mm。

2、手机，最大输出转矩≥140 mN.m，最高输出转速≥1000 r/min，可高温高压消毒。

3、刀具，≥Φ3.0 mm/Φ4.0 mm，工作长度≥340 mm。

4、内窥镜手术动力设备

4.1 防电击类型：I 类 CF 型。

4.2 调速范围：≥5 档可调。

4.3 内置负压吸引系统，极限负压：≥0.08MPa，瞬间抽气速率：≥15 L/min。

4.4 噪声≤65 dB。

配置单

序号	名称	规格	数量
1	摄像主机		1
2	光源		1
3	监视器	≥32 英寸	1
4	台车	妇科专用	1
5	摄像头	4K	1
6	宫腔检查一体镜	Φ4.8	2
7	活检钳	Φ1.8	2
8	异物钳	Φ1.8	2
9	鼠齿钳	Φ1.8	2
10	图文报告		1
11	膨宫泵		1
12	导光束	≥1800mm	1
13	能量平台（低温等离子）		1
14	电切镜		1
15	操作器	被动式	1
16	内鞘及闭孔器	配合外鞘	1
17	外鞘	F22	1
18	电切环	F22	1
19	宫腔镜，可 360° 旋转，通道 16 Fr		1
20	镜鞘，直径 8 mm，连续灌流		1
21	闭孔器		1
22	手机，妇科用		1
23	刀具，Φ4.0 mm，妇科用		1
24	刀具，Φ3.0 mm，妇科用		1
25	**内窥镜手术动力设备**		1
26	脚踏开关，妇科用		1
27	仪器车		1

28	齿状抓钳，Φ3.5 mm		1
29	重型抓钳，Φ3.5 mm		1
30	活检钳，Φ3.5 mm		1
31	单开尖剪，Φ3.5 mm		1
32	双开弯剪，Φ3.5 mm		1
33	弯分离钳，Φ3.5 mm		1

4.利普刀治疗仪

一、主机参数：

1、全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等外科手术和内镜手术。

2、具备≥3 种切割模式（包括至少 2 种混切模式），

具备≥2 种凝血模式（至少包括 1 种喷射凝血），

具备≥1 种双极模式。

纯切模式最大输出功率≥350W(负载 500Ω)，

混切模式最大功率≥250W(负载 500Ω)，

双极模式最大功率≥50W(负载 100Ω)。

3、具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

4、切割、凝血、双极均具有独立 LED 显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示;

5、全功能功率自动补偿，功率输出采用 CPU 双闭环控制，输出功率误差±3%。

7、具有散热功能。

8、单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各 1 个，单极既可以手控输出也可以脚控输出，双极脚控输出。

9、具有真人语音提示播报。

10、设备使用年限≥8 年。

二、烟雾处理器参数：

1.适用于所有开放手术以及妇科手术，实现近距离高效清除手术烟雾。

2.专业滤网设计，有效去除手术烟雾中的超细微颗粒、化学气体以及各种细菌、病毒等，过滤颗粒直径达≥0.2 微米，有效清除率高达≥99%。

3.多种激活方式：具有同步、脚踏、手动三种启动功能，风量输出延时停止时间可调。

4.噪音：≤35dB（A）。

5.最大真空度：≥10kPa，最大风量：≥100L/min。

6.异味去除率：≥99%

5.二氧化碳激光治疗仪（妇产科）

1、适用于产科、妇科（治疗盆底、外阴病变、阴道宫颈病变）。

2、激光类型：封离型二氧化碳激光器。

3、激光波长：10600nm。

4、激光模式：多模

5、工作模式：单次、重复、连续、多元聚焦模式

6、脉宽：110ms-900ms 可调

7、导光系统：≥7 关节非重锤式导光关节臂，导光臂可在 360 范围内转动。

8、出光方式：连续，定时出光。

9、采用水冷、风冷双重控制冷却系统。

10、半导体指引激光线与 10600nm 手术激光线同轴。

11、脚踏光电开关控制输出。

12、光斑范围：≤20*20mm。能量密度：单点能量可调。

13、单工作光斑，对于黏膜组织剥脱直径可调节剥脱直径精准可控。

14、手具功能：配置侧向、正向多元聚焦治疗手具，配置金属手具。

15、智能切割深度可调；对组织的气化，碳化，可控。

16、可动态显示激光器温度。

17、触摸屏：≥10 英寸彩色液晶屏触摸界面。

6.麻醉机

1 基本要求

1.1 后备电池使用时间：≥90 分钟

1.2 具有 RS-232 接口、HL7、USB 连接功能

1.3 机架带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

1.4 具备顶光灯

2 气源

2.1 标配氧气、空气双气源

2.2 具备机械氧笑联动装置，不受停电影响，氧气浓度不低于 25%

2.3 快速充氧范围 25 - 75 L/min

3 流量计

3.1 机械流量计

4 挥发罐

4.1 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

4.2 标配挥发罐，具备压力、流速和温度补偿

5 呼吸回路

5.1 一体化回路整体可徒手拆卸

5.2 回路部件可 134℃高温高压消毒

5.3 二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml

▲5.4 内置双流量传感器

5.5 具有回路加温功能

6 呼吸机

6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子 PEEP。

6.3 潮气量设置范围：20ml-1500ml

6.4 吸气压力设置范围： 5～60 cmH_2O

6.5 呼吸频率：4-100 次/分钟

6.6 吸呼比：4:1 到 1:8

6.7 压力限制范围：10 到 100 cmH_2O

6.8 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH_2O

6.9 吸气暂停：关闭，5%-60%吸气时间

6.10 上升式风箱

6.11 具备吸入端，呼出端双流量传感器，动态潮气量实时自动补偿功能，内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

7 数字和波形监测

7.1 具备三级声光报警功能

7.2≥10 英寸彩色触摸屏，可同屏显示 3 通道波形和选配至少一个环图

7.3 同屏幕可显示 3 通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末二氧化碳监测模块、麻醉气体分析模块为标配，）和一个环图 (P-V, F-V, P-F)。

7.4 潮气量监测范围：0 到 1500ml

7.5 分钟通气量监测范围：0L/min 到 100L/min

7.生殖道分泌物微生态分析仪（含工作站）

一、仪器基本功能

1.工作原理：有形成分检测应用人工智能机器视觉技术，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计数；干化学检测通过比色分析法自动判读检测结果。

2.检测项目：

2.1 干化学项目：包括 pH 值、过氧化氢、乳酸、氧化酶、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、凝固酶，支持 4-11 项检测，可根据临床需要选择组合。

2.2 有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。

3.在一台仪器上可同时进行白带干化学和有形成分检测

4.一机多用，可选择多种检测模式：干化学模式、有形成分分析模式、干化学+有形成分模式。

5.轨道式送样，一次性可批处理≥60 个标本。

6.图像采集：显微镜智能控制，自动更换视野，自动转换高低倍镜，快速采集有形成分图像。

7.恒温控制：电脑精准恒温控制

8.干化学检测分纸系统：自动分纸

9.报告方式：可综合报告干化学及有形成分检测结果

10.检测速度：≥120 标本/小时，并发出综合报告。

11.准确度：有形成分综合识别及计数准确度≥95%。

12.交叉污染：干化学：阴性和阳性参考品交叉测试，阴性样本不出现阳性结果；有形成分：≤1 个/μL（浓度 5000 个/μL）。

13.滴虫视频：可提供滴虫动态视频。

14.质量控制：具备通过 CFDA 认证的阴道炎十一联检及有形成分检测质控品

15.显微镜：具备 10X 及 40X 的高低倍双物镜，自动切换。

二、工作站及其他所需配置清单

1、**生殖道分泌物微生态分析仪 1 台**

2 工作站 :符合生殖道分泌物分析仪正常运行的工作站 1 套

3 报告打印机 ： 彩色喷墨打印机，支持 A4 打印 1 台

4 条码扫描器（枪） ： 支持一维/二维条码 1 个

5 操作系统及分析软件 ： 原厂分析软件及图像识别系统 1 套

8.全自动尿液干化学分析仪（含工作站）

一、仪器基本功能

1、检测系统：采用 CIS 图像传感器检测系统或光电比色法

2、检测波长数量：≥4 个波长

3、测试项目：≥14 项，至少可检测以下项目：白细胞、隐血、尿胆原、葡萄糖、酮体、胆红素、pH 值、尿比重、尿蛋白、亚硝酸盐、维生素 C、肌酐、微量白蛋白。

4、测试速度：≥260 个样本/小时

5、显示器：≥10 英寸触摸式彩色液晶显示屏

6、支持样本架扩展功能

7、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控

8、尿液比重计功能：线性范围 1.000～1.035 内，偏离范围不超过±0.005

9、加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗

10、混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作

11、采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，有报警提示

12、具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面

13、数据存储量：≥30 万个样本数据

14、试纸仓容量：≥200 条试纸

15、尿样需求量：≤2mL

16、重复性：变异系数≤0.9%

17、携带污染：检测除比重和 PH 外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性。

二、设备配置清单：

1 全自动尿液分析仪主机 1 台

2. 中文工作站（含软件）1 套：含电脑主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、条码扫描枪。

3. 随机试剂套装 1 套。

4.3000W UPS1 台。

9.微量元素分析仪（含工作站）

一、基本功能

1、标配≥12 个极谱反应位

2、标配≥12 个溶出测试位

3、多信号扩增高速芯片处理系统

4、可全自动检测锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉等微量元素

5、具有双通道且可同时测量

6、具有电极汞滴微控技术

7、多元素同测技术

8、具有汞回流控制技术

9、具有固体参比微电极技术

10、自动定标：检测过程中可及时快捷的校正仪器。

11、软件可自动寻峰,

12、具有背景自动扣除功能

13、检测采血量≤40μl。

14、需提供原厂生产的配套校准溶液

15、无需气体、火焰等辅助设施。

16、技术指标

名称	电位溶出	极谱
检测下限	≤0 .1μg/L【对 Pb（Ⅱ）】	≤5×10^{-8}mol/L
重复性误差	RSD＜3%	RSD＜1%
校准曲线的精密度	RSD＜8%	RSD＜2%
线性关系	R≥0 .9990	R≥0 .9990

三、设备配置清单：

1 微量元素分析仪 1 台

2. 中文工作站（含软件）1 套：含主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、条码扫描枪。

3. 随机试剂套装：1 套。

4. 3000WUPS 1 台。

10.自动取单机

1、整机机箱≥1.5mm 钢质、模块全部采用前维护、攻放喇叭：双声道、频响范围：80Hz-16KHz、信噪比：≥80dB,输出功率：≤10W

2、工控主机 CPU:四核四线程 3.2GHz　内存：≥8G 硬盘：固态硬盘，≥240G

3、触摸显示屏≥21 英寸电容触摸液晶显示，分辨率≥1920×1080,亮度≥250cd/m²;

4、一维码/二维码扫描模块

5、打印速度：≥35 页/min，首页输出：≤9s，纸仓容量：≥250 页，纸仓：500 张(A4+A5)

6、身份证阅读模块，公安部认证，感应距离≥50mm,感应面积为 100*120mm。阅读时间：≤0.5s，平均无故障工作时间(MTBF):≥5000 小时

7、UPS 电源 500VA,工作时间≥30 分钟，支持设定定时开关机功能，串口通讯

11.全自动洗板机

一、仪器基本功能

1、显示屏幕：≥4 英寸液晶显示屏

2、可洗板条：适用于平底、U 和 V 型底酶标板或条。

3、 冲洗头：8 或 12 针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

4、 注液精度：≤2%

5、 清洗液量：10-3000 μl/孔，1 μl 递增。

6、清洗次数：0-99 次可调。

7、清洗条数：1-12 排可调。

8、浸泡时间：0-24 小时可调。

9、振板时间：0-24 小时可调。

10、洗液通道： ≥3 个

11、存 储：≥100 组程序。

12、内置式压力泵

12.生物安全柜

一、仪器基本功能

1.气流模式：100%外排

2.流入气流平均风速≥0.50m/s，下降气流平均风速≥0.30m/s

3.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.00%

4.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护

5.洁净级别优于10级的工作环境

6.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数

7.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

8.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度

9.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长

10.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度≥1000lx

11.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃

12.前窗玻璃具有全幅可清洁功能

13.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

14.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示

15.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示

16.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

17.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

18.报警代码显示提醒设计

19.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能

20.负压风道设有过滤格栅

21.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行

22.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大

23.上柜体底部结构的可搬抬结构设计

24.柜内电源：双防水插座设计

25.具有水阀、气阀孔交错设计

26.脚轮与支架一体化设计

27.可联动控制

13.全自动化学发光免疫分析仪（含工作站）

一、仪器基本要求

1.1 检测原理

非酶促直接化学发光（ABEI 标记）。

1.2 检测方法学

应支持双抗体夹心法、竞争法、捕获法等主流免疫检测方法。

1.3 检测速度：不低于 200 测试/小时。

1.4 急诊项目首次出结果时间不超过 15 分钟。

1.5 携带污染率：不高于 1×10^{-6}。

1.6 样本装载能力：

同时装载样本数量不低于 150 个，支持原始管直接上机，具备急诊样本优先插入功能。

1.7 试剂位：

试剂位不少于 25 个，试剂舱需具备 2-8℃在线冷藏功能，并支持试剂余量实时监测。

1.8 反应杯

反应杯装载容量不低于 1000 个，支持自动连续加载，并配备自动排杯系统。

二、产前筛查专用软件与分析功能

★2.1 配备产前筛查计算软件（功能等同即可，提供注册证）

2.2 筛查模式

必须同时支持以下筛查模式：孕早期筛查（PAPP-A＋Free-β-hCG）、孕中期筛查（AFP + Free-β-hCG + uE3。

2.3 风险计算模型

系统内置或可通过 LIS 系统对接主流唐氏筛查风险评估软件，支持基于本地人群数据的中位数值参数校准。

2.4 质控功能

具备中位数值实时监测及动态调整功能，可对 MoM 值进行周期性统计分析。

2.5 报告输出

可直接打印或导出符合国家《产前筛查技术规范》要求的中文筛查报告单。

三、软件与信息系统

3.1 操作系统

全中文操作界面，预装正版 Windows 操作系统，硬件配置不低于内存 16GB、固态硬盘 512GB。

3.2 自动化功能

支持自动稀释、自动重测、自动反射检测、自动质控。

3.3 通讯能力

支持与 LIS、HIS 等系统双向通讯，负责提供接口开发包及技术支持。

四、配置要求

1. 全自动化学发光免疫分析仪主机 1 台

2、产前筛查风险计算软件，终身负责提供维护、升级服务。

2. 中文工作站（含产筛模块或适配接口）：含电脑主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、条码扫描枪。

3. 随机试剂套装包含至少以下项目：产筛二项（Free-β-hCG、AFP）、甲状腺功能五项、肿瘤标志物五项、性激素六项。用于安装调试、室内质控、仪器校准和性能验证（至少包括精密度、准确度、线性范围、携带污染率、参考范围）。

4. 3000WUPS1 台。

14.医用离心机（48孔）

一、仪器基本功能

1.≥7 英寸高清液晶触控屏

2.采用三轴陀螺仪实时监测平衡状态

3.参数设定直接数字输入

4.具有曲线显示功能

5.时显示仪器工作状态

6.可存储≥1000 个程序组，≥130000 条日志记录，支持数据导出

7.具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置权限范围，账号期限等

8.具有门盖，超速，超温，过流，过压等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案

9.可设置≥100 组多段离心程序组，每组可设置≥10 段离心参数

10.所有转子，转子盖均可高温高压灭菌

11.具备转子离心半径修正功能

12.能通过 USB 升级程序

13.双锁头，双液压撑杆，具备电子签名功能，支持中英文输入

14.具备可视化升降速档位设置功能

15.最高转速 ≥5000 r/min

16.最大离心力 4400×g

17.最大容量≥4×600ml（4000rpm）

18.转速精度≤ ±10r/min

19.定时范围 1 s~99h99 min59s/点动/连续

20.噪 声≤60dB（A）

15.液基细胞制片染片机（含工作站）

应用范围：适用于宫颈脱落细胞学检查，以及胸腹水、尿液、痰液、脑脊液、支气管冲洗液等非妇科标本的薄层细胞制片。

一、主要功能

1. 制片原理：自然沉降法

2.▲仪器自动加样、沉降、玻片打码、染色、透明、封片、制片全自动一体化。

3. 通量与速度

3.1 单次装载样本量≥36 片/批。

3.2 单批次完成制片与染色总时长≤40 分钟。

4. 支持宫颈刷样本。

5. 染色系统

5.1 支持巴氏染色 和 HE 染色 两种染色程序

5.2 采用一次性吸样管或滴染方式。

6. 操作与软件

6.1 操作界面可实时显示运行状态。

6.2 具备 LIS 系统双工通讯接口，支持扫码枪自动识别标本编号，支持病理号、一维码/二维码打印识别。

6.3 具备故障自诊断和声光报警功能。

二、设备配置清单：

1 全自动液基薄层细胞制片机 1 台

2. 中文工作站（含软件）1 套：含主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、条码扫描枪。

3. 随机试剂套装：1 套。

4. 3000WUPS 1 台。

16、B超

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1主机成像系统：

3.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境自动调节

3.1.2操作面板具备防眩光，彩色触摸屏≥13英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度。

3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥6个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

3.1.4智能多倍信号并行处理技术

3.1.5数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.6数字化二维灰阶成像及M型显像单元

▲3.1.7解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

3.1.8曲线解剖M型技术

3.1.9彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术

3.1.10数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

3.1.11智能化一键图像优化技术，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像的优化。

3.1.12空间频率复合成像技术

3.1.13具有智能斑点噪声抑制技术

▲3.1.14自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化

3.1.15穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，支持自适应校正角度，具有双屏实时对比显示

3.1.16图像放大，放大倍数≥10倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

3.1.17声功率可调，可实时显示MI/TI

3.1.18自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

3.1.19超声远程会诊系统，具备单独注册证及信息安全等级保护三级证书

3.1.20通过网络可在超声主机上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内

3.2成像技术：

3.2.1造影成像技术

1)支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

2)微血管造影增强功能

3)双计时器

4)向前、向后存储，向后存储≥6分钟电影;

5)造影、组织混合显示模式

6)造影图像和组织图像位置互换

7)左心室造影

3.2.2应变式弹性成像技术

1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3)具备定量测量映射分析

3.2.3TDI组织多普勒成像

1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

3.2.4内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1常规测量软件包

3.3.2全科测量包，自动生成报告。

3.3.3具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析。

3.3.4自动产科测量，自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

3.3.5自动NT测量

3.3.6具有心功能自动测量软件,可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

3.3.7膀胱自动测量

3.3.8自动肝肾比测量

3.3.9IMT血管内中膜自动测量。

3.3.10颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

3.4.2多种导出图像格式。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

3.4.3向后存储和向前存储功能，时间长度可预置

3.4.4支持动、静态图像冻结后原始数据处理

3.5连通性要求：

3.5.1网络连接功能，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告

3.5.2移动设备无线传输功能，一键传输图片到智能手机终端或PC端

四、系统技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。

4.2二维显像主要参数：

4.2.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时，全视野， 帧率≥39帧/秒

4.2.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

4.2.3 TGC：≥8段，LGC：≥8段

4.2.4显示深度≥38cm

4.2.5伪彩图谱：≥8种

4.2.6动态范围：≥240dB，可视可调

4.3频谱多普勒：

4.3.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.3.2 最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度：≥35m/s）

4.3.3最低测量速度：≤1cm/s

4.3.4偏转角度：≥±30°（线阵探头），并支持快速角度校正

4.3.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

4.3.6零位移动：8级

4.4彩色多普勒：

4.4.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.4.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.4.3取样框偏转：≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.4.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

4.5探头规格

4.5.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

4.5.2腹部凸阵探头1把，带宽（2.0-5.5MHz）

4.5.3线阵探头1把，带宽（3.0-13.0MHz）

4.5.4相控阵探头1把，带宽（1.5-4.5MHz）

4.6记录装置：

4.6.1内置一体化超声工作站。

4.6.2内置USB接口≥6个

4.7外设和附件

4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度可调

4.7.2腔内探头放置架

17、全自动生化分析仪

1.产品要求:全自动生化分析仪

2.技术参数

2.1 检测速度:生化比色分析恒速≥800 测试/小时

2.2 检测方法:要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等

2.3 定标方法:单点线性、两点线性、多点线性、非线性，具有≥6 种定标公式

2.4 急诊检测能力:急诊样本可以随时插入并优先检测

2.5 待机功能:具有 24 小时连续开机，自动休眠,一键启动功能

3.光学系统

3.1 光源:长寿命卤素灯，光源灯自动休眠，光源灯水冷散热

3.2 分光方式:全息凹面平像场光栅，后分光方式

3.3 波长数量及范围:波长数量≥12 个

3.4 吸光度线性范围:0-3.5Abs

3.5 杂散光:当测定波长位 340nm 时，吸光度≥4.0

4.温控系统

4.1 反应盘温控方式:非水浴免维护免保养的恒温方式

5.样本系统

5.1 进样方式:智能灵活，圆盘式进样

5.2 样本针功能:液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。

5.3 样本量:1.5 μl --50 μl，0.1μl 递增

5.4 样本位:≥180 样本（不含软件扩展位）

5.5 样本类型:血清、血浆、尿液、全血（HbAIc）等

5.6 样本携带污染率:≤0.08%

5.7 样本管:原始采血管或其他试管

6.试剂系统

6.1 试剂量:10--360 μl，0.5μl 递增

6.2 试剂位:≥160 个

6.3 试剂冷藏:24 小时独立水冷系统，冷藏温度 2℃～8℃

6.4 试剂盘:独立的试剂盘≥2 个

6.5 溯源体系:提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证

7.反应系统

7.1 反应位:≥160 个

7.2 最小反应体积:≤100μl

7.3 最长反应时间:23 分钟

8.清洗及搅拌系统

8.1 搅拌系统:可调式变频搅拌技术，两根搅拌针循环使用，加入试剂后立即混匀，试剂样本针具有内外镜面抛光技术，减少污染携带率

18、呼吸机

1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3.屏幕与机器一体化。主机可从台车上无工具拆卸。

4.采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800

5.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。

6.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

7.标配通气模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

8.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

9.标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

10.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

11.呼吸同步技术，自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间

12.具有静态P-V环图（或P-V工具）

13.具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。

14.参数设置

14.1 潮气量：20ml—2000ml。

14.2 呼吸频率：1—100/min。

14.3 吸气流速：6—180L/min。

14.4 SIMV频率：1—60/min。

14.5 吸呼比：4:1—1:10。

14.6 PEEP：0—50 cmH_2O。

14.7 吸气时间：0.1—10s 。

14.8 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH_2O，或 OFF。

14.9 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF。

14.10 呼气触发灵敏度：Auto，1—85%。

15.参数监测

15.1 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

15.2 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。

15.3 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

15.4 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

15.5 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

16.报警参数

16.1 智能化分级报警、声光报警。

16.2 分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率：过高/过低报警。

16.3 窒息报警，时间可设置（5-60s）。

16.4 气道压力：过高报警。

17.≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

18.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）

19.具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

20.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

21.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

19、“两癌”筛查专用车

序号	需求说明	
（一）	**车辆部分**	
1	车辆要求	
1.1	总长	车长≥8900mm
1.2	总宽	≥2500mm
1.3	车厢内高	≥2000mm
1.4	轴距	≥4300mm
1.5	轴荷	≥4300/7600kg
1.6	前轮距/后轮距	≥2100/1800mm
1.7	额定载客	≥9 人
1.8	整车最大总质量	≥11900kg
2	发动机	
2.1	发动机型式	六缸水冷直喷增压中冷
▲2.2	额定功率	≥190KW
2.3	排放标准	国六排放
2.4	底盘	
3	**平台标准配置**	
3.1	变速箱	1、六档变速器、两软轴操控； 2、排挡杆集成在仪表台上；
3.2	离合器	单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力
3.3	行驶系统	1、多片簧（前板簧片数≤8，后板簧片数≤9）； 2、前盘后盘(前后一体化免维护轴承单元)

3.4	外后视镜	电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜，主镜片≥200mm*380mm（镜片最宽*最长），曲率半径 R≥1300mm。
3.5	遮阳帘	前风挡双半幅遮阳帘
3.6	智能节油系统	具有智能节油系统
3.7	ABS	具有 ABS
3.8	行车空调	顶置空调（≥24000Kcal/h）
3.9	燃料箱	≥260L 油箱，高密度聚乙烯材质
3.10	安全带未系报警	具有司机安全带未系报警功能
3.11	倒车监视系统	单探头彩色监视器（倒车）
3.12	轮胎	无子午线真空内胎，255／70R22．5
3.13	顶风窗	1 个换气扇顶风窗
3.14	安全锤	3 把防盗警报豪华车用安全锤
3.15	灭火弹	装 2 个灯笼型自动灭火弹+1 个筒状自动灭火弹(发动机舱)
3.16	热管理	智能控制冷却系统
3.17	取电器	有取电器
3.18	**蓄电池**	≥150Ah 免维护蓄电池 2 个
3.19	车联网系统配置参数	1、车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾评管理、售后服务管理，车辆粘贴有车联网注册二维码。 2、车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录。 3、车联网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运营里程、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检和外观巡检功能，外观巡检可以手动维护

		提交结果，智能巡检包含仪表、发动机、电子风扇、胎压、集中润滑、ABS 等。 4、车联网系统支持驾评管理 5、车联网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理姓名电话、查看服务网点、进行预约维保。
4	**平台选配置**	
4.1	电子钟	具有电子钟
4.2	驻车雷达	具有倒车雷达
4.3	司机椅	三点式安全带减震司机椅(带安全带报警)
4.4	导游椅	具有导游椅
4.5	行驶记录仪	具有行车记录仪
4.6	司机窗	白色单层后活动内嵌式司机窗
4.7	通风抑菌装置	具有顶风窗通风换气联动功能。
4.8	活动踏步	前、中门活动踏步
4.9	侧窗配置	深灰色：全封闭普通玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗）
4.10	车身保温系统	独立水暖除霜，水暖驻车可用
4.11	底盘保暖模块	具有制动冷凝器，具有发动机进气预热，具有发动机燃油加热系统
4.12	侧舱门	全铝上翻门，大角度上翻门，中段行李舱舱门开启后上沿距离地面≥1800mm。
4.13	车身内饰	原车客车风道，窗帘、围帘为米色系，隔断、家具为白色系（台面为防火板），座椅为米黄拼色，窗帘为布艺窗帘
4.14	工作台台面	工作台台面使用仿石材花纹贴面板，台面贴面板满足以下要求：进行表面耐龟裂、表面耐干热检测，表面耐龟裂可以达≥5 级，表面耐干热可以达到≥5 级。
4.15	内饰地板革	选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。 1、环保性能：气味等级（40° C 气味等级 3.0；80° C 气

		味等级 3.5）；甲醛≤10mg/kg；TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g。 2、耐磨性能：参照 GB/T 18102,使用 P180 粒度砂布粘在砂轮上，负载 4.9N，60r/min,可以达到循环≥20000 次，不漏底。 3、防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到 R10。 4、阻燃性能：阻燃性能可以达到 GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。
4.16	车内隔断结构	车内所有隔断主体采用钢骨架+装饰面板结构，隔断骨架与整车骨架焊接为一体,整体电泳防腐,隔断厚度≥38mm,隔断无外漏固定点。
5	工作设施	1、双人座椅 2 件
		2、检查床 2 张（下为木质床，上有床垫）；木质折叠工作台 2 件；可升降工作圆凳 2 件；检查室 2 套；围帘 2 套；
		3、工作台 3 件，可升降工作圆凳 3 件
		4、手动妇科检查床 1 件，木质储物工作台 1 件，可移动方凳 1 件，检查室 1 套，中间为手动折叠门结构；
6	灯光设施	紫外光灯 4 盏，两侧长条灯，曝光指示牌 2 件。
7	服务设施	衣帽钩 3 个，垃圾桶 3 件，铅房内羊角形挂衣钩 1 件
8	市电空调设施	1. ≥1.5P 空调 2 台；
9	市电配电及网络设施	1、配电箱 1 个（包含漏电保护器、电压电流实时监测），外接 220V 电源插座，榔头 1 个，十字型接地钎 1 个（采用 6 平方软铜线，线长≥10 米，铜线与接地钎一体化防脱设计），2 个电缆盘，充电逆变一体机 1 个。 2、局域网；交换机 1 件，网线网口若干；电器舱有网口及插座； 3、市电转接装置 1 套（含≤16A 漏电保护断路器、≤16A 防护型工业插座、≤16A 插头、线长≥2.5 米，具备过载

		自动断电功能）。
10	防腐要求	1、投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，≥16道工序，防腐涂层的覆盖率100%。 2、≥10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25μm，电泳涂层耐盐雾性≥1000小时。
11	其他配置	洗手装置、UPS、饮水机

20、妇科射频治疗仪

1、主机技术参数

1.阻抗百分比：100～999%;

2.输出功率：15-50W 可调，步进 1W;

3.治疗时间：1 秒-99 分 59 秒连续可调;

4.整机功率：≤1000W;

5.温度控制：35～100℃;

6.测温范围：15～100℃;

7.工作频率：100KHz～600KHz;

8.主机组成：由射频发射器及相关附件组成，相关附件通常包括手术电极、电极连接线、中性电极连接线和中性电极等。

9. 配套治疗电极具备独立的注册证。

10.治疗计时显示：能自动识别治疗过程，连续累计显示治疗时间;

11.具有人体阻抗实时显示和温度监测功能。

12.仪器具有电路短路保护功能;

13.操作手柄中的电路和开头处具有防水功能;

14.达到预定温度后自动报警;

15.电极电缆或其连接发生中断时，停止射频输出并发出声音报警。

21、身高体重测量仪（智能型）

1、身高测量方式：超声波测量

2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

3、测量范围：身高：30~205cm 体重：5~300kg

4、允许误差：身高：±0.5cm 体重：±0.1kg

5、体型：国际通用体格指数（BMI）

6、数据输出格式：RS-232C 数据传输接口

7、整机重量：≤25kg

22、妇科检查床

1、长：1450±50mm

2、宽：600±20mm

3、背板上折：≥85°

4、背板下折：≥30°

5、台面最高：1000±20mm

6、台面最低：570±20mm

7、臀板上折：≥35°

23、身份证读卡器

1、支持 VC/DELPHI/VB/PB 等开发平台,居民身份证阅读距离≥5cm, 无盲区

2、从读卡到显示信息的时间≤3 秒

3、读卡后自动蜂鸣提示

4、USB,RS232C 两种通讯方式

5、USB 接口取电

6、支持 WINDOWS7 以上版本的操作系统

24、笔记本电脑

1.CPU：≥Intel i5-1235U 十二代处理器；

2.内存：≥16G DDR4-3200

3.硬盘：≥1T 硬盘

4.显卡：独立显卡

5.网络设备：主板集成 1000M 自适应以太网卡，支持 Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) +BT5.2 无线网卡；

6.电池：内置电池，支持 USB 快充技术

7.键鼠配件：悬浮式防溅键盘

8.外部端口：≥1 个 USB Type-A 3.2 Gen1，≥1 个 USB Type-C 3.2 Gen1，≥1 个耳机/麦克风组合插孔，≥1 个交流电源接口，≥1 个 RJ-45 网络接口，≥1 个 HDMI 接口；

9.显示器：≥14 英寸全高清（1920x1080）IPS 窄边框防眩光屏幕，可延长显示器使用时间

25、黑白打印机

1、最大打印幅面：A4

2、最高分辨率：≥600×600dpi

3、黑白打印速度：≥18ppm

4、内存：≥32MB

5、双面打印：手动

6、预热时间： ≤10 秒

7、首页打印时间： ≤8 秒

8、打印语言： UFR II

9、月打印负荷 ：≥5000 页

10、接口类型 ：USB2.0

26、冷光妇科检查灯

1.灯泡类型：LED灯

2.使用寿命≥50000h

3.两种色温相近的灯珠，色温：5000±1000K

4.无紫外线辐射，无频闪。

5.无影灯效果，深度照明：照明深度1000mm±10%

27、医用冷藏箱

1.容积：≥50L

2.箱内温度:2-8℃

3.电压：220V

4.外形尺寸：480mm×460mm×585mm±10mm

5.功率：≥85W

6.净重：≤18kg

第六章 投标文件格式

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

投 标 人：_____

时　　间：_____

目 录

第一部分　身份证明文件

第二部分　资格证明文件

第三部分　商务及技术文件

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》【如适用】（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》【如适用】（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》【如适用】（见投标文件格式八）

7、符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件【如适用】、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】。（见投标文件格式九）

8、符合评分标准要求的技术、商务文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表及评审所需的其他文件

12、投标信用承诺书

第一部分　身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（或单位负责人）身份证复印件 （正反面）

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码 ：_____

电　　话：_____

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月___日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职　　务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____　　电话：_____

法定代表人（或单位负责人）及授权代表身份证复印件

法定代表人（或单位负责人）身份证复印件 （正反面）	授权代表身份证复印件 （正反面）

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

第二部分　资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）提供2025年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。**且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码**。）或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（**并后附开户许可证或基本户信息**）（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

（9）如该采购项目专门面向中小企业，供应商的资格证明文件中应提供中小企业声明函。

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 经审计的财务报告

提供2025年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。**且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。**）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（后附开户许可证或基本户信息）

（注：供应商提供资信证明的，并提供基本账户信息）

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

注：按采购清单顺序提供设备医疗器械注册证（非医疗器械管理的写文字说明）等；

第三部分　商务及技术文件

（投标文件格式一）

投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（　名称　）提交电子投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　元（¥：　　元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　元（¥：　　元），占投标总价的　　%。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：_____

地址：_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　　采购项目编号：

投标报价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	采购标的（设备名称）	规格型号	制造厂家	数量（套）	单价	小计	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
合计金额：　　元							

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

配置清单

采购标的 （设备名称）	配置内容	规格型号	数量
	……	……	……
	……	……	……
	……	……	……
	……	……	……
	……	……	……
……			
	……	……	……

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

专机专用耗材、易损件、零配件清单

采购标的（设备名称）	专机专用耗材、易损件、零配件	规格型号	单价（元）
	……	……	……
	……	……	……
	……	……	……
	……	……	……
	……	……	……
……			
	……	……	……

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
（1）强制采购类								
（2）优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

（投标文件格式四）

技术偏离表-（序号）采购标的（设备名称）

按采购清单内容逐个列表

项目编号：

项目名称：

序号	采购标的（设备名称）	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：

1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确偏离情况，且偏离情况与实际相符，在说明栏中注明证明材料页码。

3.本表后按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明、彩页、官网截图等）

（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	交货地点			
	付款方式			
	质量保证			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

投标产品质保承诺书

（采购人）：

我公司（投标人名称） 郑重作出如下承诺：

在本项目投标过程中，我公司所提供的全部投标产品，均严格执行质保服务标准，满足招标文件质保期要求，为设备提供终身软件升级服务，无任何虚假承诺或违规隐瞒。本承诺具备法律效力，若违反上述承诺，我公司自愿承担由此产生的全部责任及相关损失。

序号	采购标的 （设备名称）	自设备验收合格之日起，各设备全套产品整机保修（年）
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
...		

特此声明。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

（投标文件格式六）（如适用）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）（如适用）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《本国产品说明》

序号	采购标的（设备名称）	规格型号	数量	本国产品	主要产品/技术成本在产品总成本中占比（%）
1				*是/否*	
2				*是/否*	
3				*是/否*	
4				*是/否*	
5				*是/否*	
6				*是/否*	
7				*是/否*	
本国产品在产品总成本中占比合计					

供应商名称（盖章）：_____

日期：　年　月　日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

符合评分标准要求的技术、商务文件

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
…				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2、提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：

投标人须知前附表及评审所需的其他文件

投标信用承诺书

附件 1：榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：　　法人代表：

件类型：统一社会信用代码　　证件号码：

承诺有效期限：_____

承诺内容：为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。

若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位：（盖章）_____

法定代表人（负责人）签字或盖章：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：　　年　月　日

注：此承诺书除附在响应文件中还需上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为递交响应文件截止之日）。法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

附件 2：投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：　　投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

附件 3：投标信用(保证金）承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：　　法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：　　投标人（盖章）：

承诺时间：　　年　　月　　日

说明：本承诺书效力和作用等同于投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

附件 4：投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日 —_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心
关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联 系 人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日


信用中国（陕西榆林）
CREDIT.YL.GOV.CN
信用查询
站内文章
请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码...
搜索
我要查
双公示、承诺、代码
我要看
动态、法规、奖惩
我要办
修复、申报、承诺
• 信用查询
• 信用修复
• 异议申请
• 自主申报
• 信用承诺
首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
信用承诺
信易+
互动交流
头条
新闻
◆ 习近平在参加首都义务植树活动时强调：汇聚共建美丽中国磅礴力量 让祖国大地更加绿意盎然生机勃发
◆ 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》
榆林动态 | 陕西动态 | 国家动态
更多
榆林市冯泽伟候选2025年第一季度“中国好人榜”
在中央文明办举办的“我推荐、我评议身边好人”活动中，2025年第一季度“中国好人榜”候选人事... 查看详细
· 榆林多措并举推进法治政府建设
04-08


信用中国（陕西榆林）
CREDIT.YL.GOV.CN
信用查询
站内文章
请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码...
搜索
我要查
双公示、承诺、代码
我要看
动态、法规、奖惩
我要办
修复、申报、承诺
首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
信用承诺
信易+
互动交流
当前位置：信用中国（陕西榆林）>>信用承诺（法人）
法人
自然人
主动型承诺
审批替代型承诺
行业自律型承诺
信用修复型承诺
容缺受理型承诺
证明事项型承诺
其他类型承诺
我要承诺（通用型）
我要承诺（工程建设领域）
适用于榆林市公共资源智慧交易平台
起始时间
结束时间
请输入名称或统一社会信用代码...
查询
清空

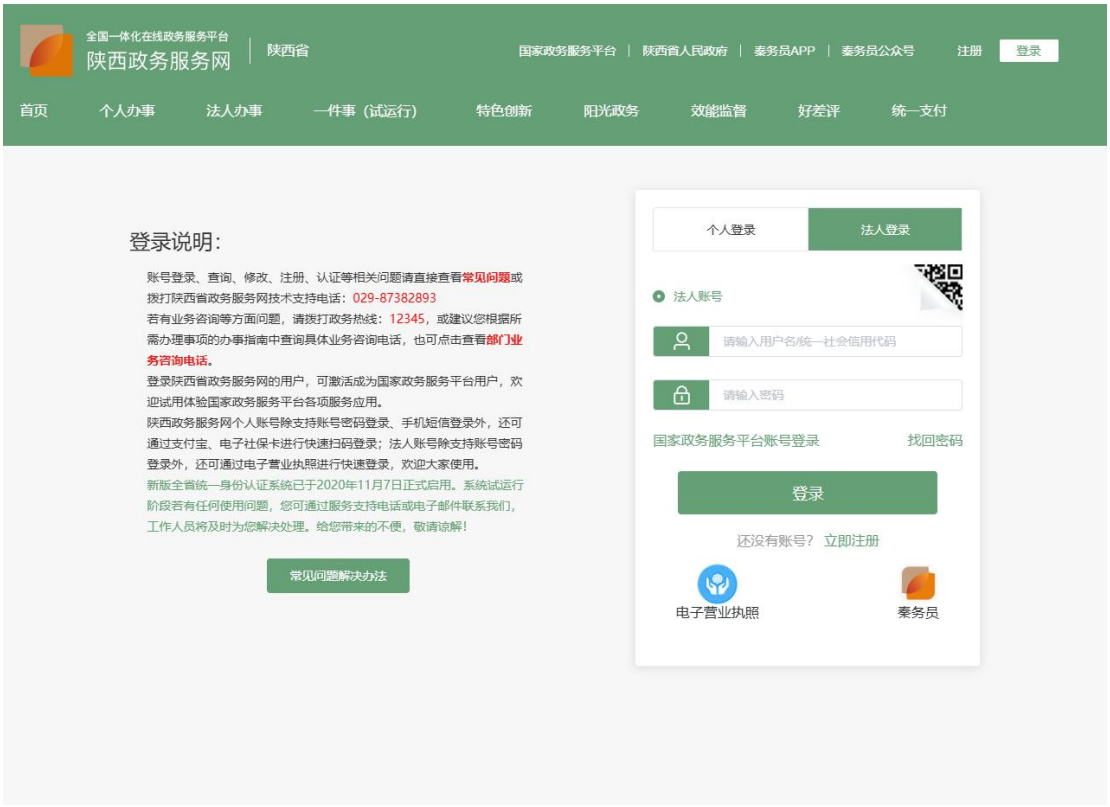
全国一体化在线政务服务平台
陕西政务服务网
陕西省
国家政务服务平台 | 陕西省人民政府 | 秦务员APP | 秦务员公众号
注册
登录
首页
个人办事
法人办事
一件事（试运行）
特色创新
阳光政务
效能监督
好差评
统一支付
登录说明：
账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看常见问题或拨打陕西省政务服务网技术支持电话：029-87382893
若有业务咨询等方面问题，请拨打政务热线：12345，或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话，也可点击查看部门业务咨询电话。
登录陕西省政务服务网的用户，可激活成为国家政务服务平台用户，欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。
陕西政务服务网个人账号除支持账号密码登录、手机短信登录外，还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录；法人账号除支持账号密码登录外，还可通过电子营业执照进行快速登录，欢迎大家使用。
新版全省统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题，您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们，工作人员将及时为您解决处理。给您带来的不便，敬请谅解！
常见问题解决办法
个人登录
法人登录
法人账号
请输入用户名/统一社会信用代码
请输入密码
国家政务服务平台账号登录
找回密码
登录
还没有账号？ 立即注册
电子营业执照
秦务员


信用承诺申请
*承诺主体:
*身份证号码
*承诺人类别:
--请选择--
*承诺事项:
--请选择--
*承诺书内容:
*违诺责任内容:
*承诺做出日期:
20250410
承诺有效期:
请选择承诺有效期
*承诺事由:
承诺事由
*承诺受理单位:
承诺受理单位
*承诺受理单位代码:
承诺受理单位代码
备注:
*承诺书:
未选择文件
附件支持上传jpg,pdf文件,大小在2M以内。
根据项目要求，自主填报
提交

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 https://sfrz.shaanxi.gov.cn
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接







数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

