

关于《府谷县人民医院医疗办公设备采购项目》

技术参数调整委托函

府谷县政府投资和采购服务中心：

因前期需求调研、市场产品实际情况、业务实际使用需要，为避免参数存在排他性、保障项目采购充分竞争，确保采购到符合业务实际需要的设备，现正式委托贵单位对本项目部分技术参数予以调整，并按政府采购流程发布更正公告。调整内容如下：

一、台式电脑：

将“★14、显示器”里的“亮度 $\geq 300\text{nits}$ ”调整为“亮度 $\geq 250\text{nits}$ ”



二、针式票据打印机：

2.1、将“★5、进纸方式：支持前进纸和后进纸”调整为“★5、进纸方式：支持单页前进纸、链式拖纸器后进连续纸；可在单页纸与连续纸之间便捷切换。”

2.2、将“★8、纸张处理能力”里的“连续纸宽度：0 - 268 mm”调整为“连续纸（链式拖纸）进纸宽度：56 - 268 mm。”

2.3、将“9、平均无故障时间：12000 小时”调整为“平均无故障时间： ≥ 12000 小时。”

特此委托

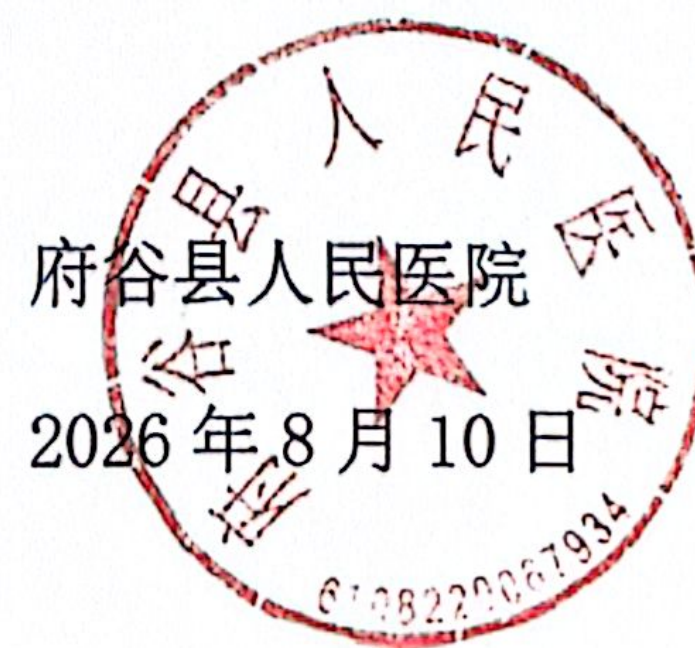

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App